



Bioness Inc.

25103 Rye Canyon Loop

Valencia, CA 91355 EE.UU.

Teléfono: +1 800 211 9136 o +1 661 362 4850

Correo electrónico: info@bioness.com

Sitio web: www.bioness.com



Bioness Europe B.V.

Stationsweg 41

3331 LR Zwijndrecht, Países Bajos

Teléfono: +31.78.625.6088

Correo electrónico: international@nl.bioness.com

Sitio web: www.bioness.com



©2018 Bioness Inc.

612-00868-001 Rev. B























02/2018



Sistema de estimulación eléctrica funcional

GUÍA DEL ESPECIALISTA

Lista de símbolos

	Atención
	Advertencia
	Doble aislamiento (equivalente a clase II según IEC 536)
	Partes aplicadas tipo BF
	Radiación no ionizante
	Fecha de fabricación
	Fabricante
	Este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos
	Consulte el manual o el folleto de instrucciones
	Número de nuevo pedido
	Número de lote
	Número de serie
	Para uso por un único paciente (para evitar la contaminación entre pacientes)
	Para uso por un único paciente (para evitar la contaminación entre pacientes)
	Temperatura de almacenamiento
	Limitación de humedad
	Limitación de presión atmosférica
	Mantener seco
IP22	Grado de protección de ingreso (para la unidad de control)
IP42	Grado de protección de ingreso (para sistema EPG)
IP52	Grado de protección de ingreso (para sensor de pie)
	Izquierda
	Derecha
	Underwriters Laboratories (UL) es un organismo independiente, reconocido en todo el mundo, que certifica, valida, realiza pruebas, inspecciona y audita corporaciones y productos.
	Representante autorizado en Europa

Copyright de la Guía del especialista del sistema L300 Go

© 2018, Bioness Inc.

Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita ni almacenada en ningún sistema de recuperación, ni ser traducida a ningún idioma o lenguaje informático, en forma alguna ni por terceros, sin el previo consentimiento por escrito de Bioness Inc.

Marcas comerciales

L300 Go®, Bioness y el logotipo de Bioness® son marcas comerciales de Bioness Inc. | www.bioness.com

Patentes de Bioness

Este producto está cubierto por una o varias patentes de Estados Unidos y otros países. Hay otras patentes pendientes. Para obtener más información sobre las patentes, visite el sitio web de Bioness: <http://www.bioness.com/Patents.php>

Exención de responsabilidad

Bioness Inc. y sus afiliadas no se responsabilizan de ninguna lesión o daño que pudiese sufrir una persona, directa o indirectamente, como resultado del uso o reparación no autorizados de los productos de Bioness Inc. Bioness Inc. no acepta ninguna responsabilidad por daños causados a sus productos, ya sea directa o indirectamente, como consecuencia del uso y/o reparación por parte de personal no autorizado.

Política medioambiental



Se informa al personal de asistencia técnica que debe prestar atención para desechar las piezas sustituidas del sistema L300 Go de manera correcta y, cuando corresponda, dichas piezas deberán ser recicladas. Para obtener más información sobre los procedimientos recomendados, póngase en contacto con Bioness Inc. Bioness Inc. está comprometida a seguir procurando e implementando los mejores procedimientos de fabricación y rutinas de servicio.



Bioness Inc

25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355, EE. UU.
Teléfono: 800.211.9136
Correo electrónico: info@bioness.com
Sitio web: www.bioness.com



Bioness Europe B.V.

Stationsweg 41
3331 LR Zwijndrecht, Países Bajos
Teléfono: +31.78.625.6088
Correo electrónico: international@nl.bioness.com
Sitio web: www.bioness.com



Tabla de contenido

Capítulo 1: Introducción	1
Capítulo 2: Información de seguridad	3
Indicaciones de uso	3
Contraindicaciones	3
Advertencias	3
Precauciones	4
Reacciones adversas	6
Guía para el cuidado de la piel	6
Capítulo 3: Condiciones ambientales que afectan al uso	7
Información de comunicación por radiofrecuencia (RF)	7
Certificación de conformidad	7
Seguridad en viajes y aeropuertos	7
Emisiones electromagnéticas	8
Advertencias	8
Capítulo 4: El sistema L300 Go	9
Banda de EF de la parte inferior de la pierna	9
Banda de EF del muslo	9
EPG de la parte inferior de la pierna y EPG del muslo	10
Unidad de control	12
Sensor de pie	14
Carga del sistema L300 Go	15
Encendido y apagado del sistema L300 Go	16
Selección de un modo de funcionamiento con la unidad de control	16
Ajuste de la intensidad de la estimulación	18
Avisos sonoros y vibraciones durante la estimulación	18
Desactivación de la estimulación mediante la unidad de control y el EPG	19
Capítulo 5: Kit del especialista y programador médico del sistema L300 Go	21
Kit del especialista del sistema L300 Go	21
Programador médico del sistema L300 Go	22
Capítulo 6: Descripción del ajuste y la prueba de los accesorios	25
Correas de la banda de EF de la parte inferior de la pierna	25
Cubierta de correa personal (banda de EF de la parte inferior de la pierna)	26
Paneles personales (banda de EF de la parte inferior de la pierna)	27

Bases de electrodos	28
Electrodos.....	29
Ocultadores de cables	31
Cubiertas de broche	31
Cable conector	32
Cubiertas de correa personal (banda de EF del muslo)	32
Electrodos Thigh	33
Almohadillas del sensor de pie.....	33
Dispositivo de prueba	34
Capítulo 7: Navegación por el software de la aplicación del especialista	35
Pantalla Iniciar sesión	35
Pantalla Base de datos de pacientes.....	35
Barra de navegación.....	36
Pantalla de configuración de la programación.....	37
Pantalla de consola del paciente.....	40
Pantalla de informes.....	40
Pantalla de cierre de sesión.....	41
Pantalla de configuración de la aplicación	41
Restablecimiento de los valores de fábrica del EPG	42
Pantalla de información	42
Capítulo 8: Preparación del paciente	43
Preparación de la piel.....	43
Adhesión de los Electrodos Hydrogel a las bases de los electrodos	43
Conexión del cable conector	44
Configuración lista para usar	45
Ajuste de la posición de los electrodos al estimular: paciente sentado.....	45
Prueba de los efectos de un cambio de posición.....	45
Ajuste la posición de los electrodos al estimular: paciente de pie	45
Transferencia de los electrodos a la banda de EF de la parte inferior de la pierna	46
Colocación de la banda de EF de la parte inferior de la pierna	47
Nueva prueba de la colocación de los electrodos: paciente sentado y de pie	48
Ajuste de los Electrodos Small Cloth	48
Ajuste de los Electrodos Cloth	49
Ajuste de los Electrodos Quick Fit.....	50
Ajuste del Electrodo Steering.....	52

Ajuste del sensor de pie	52
Retirada de la banda de EF de la parte inferior de la pierna	54
Ajuste de los Electrodo Thigh Cloth	54
Colocación de la banda de EF del muslo	55
Prueba de la posición de la banda de EF del muslo: paciente sentado y de pie.....	56
Emparejamiento del EPG del muslo	56
Retirada de la banda de EF del muslo	57
Capítulo 9: Programación del paciente	59
Emparejamiento de la aplicación del especialista del sistema L300 Go con el sistema L300 Go.....	59
Creación de un perfil de un paciente nuevo	60
Carga de un perfil de paciente en el sistema L300 Go	61
Cómo programar los parámetros de estimulación.....	61
Programación de los parámetros de marcha	64
Programación de los parámetros de entrenamiento.....	65
Configuración de los avisos sonoros y por vibración	66
Capítulo 10: Entrenamiento del paciente	67
Capítulo 11: Mantenimiento y limpieza	69
Carga	69
Sustitución de la batería del EPG.....	69
Sustitución de la batería del sensor de pie	69
Sustitución de la batería de la unidad de control.....	70
Sustitución de los Electrodo Quick Fit.....	71
Sustitución de los Electrodo Steering	72
Sustitución de los Electrodo Round Cloth	73
Sustitución de los Electrodo Hydrogel.....	74
Sustitución de las bases de los electrodo	74
Sustitución de los Electrodo Thigh Cloth.....	76
Retirada del EPG	77
Retirada de las correas de la banda de EF del muslo.....	77
Limpieza de los componentes del sistema L300 Go	78
Desinfección de los componentes del sistema L300 Go	79
Capítulo 12: Emparejamiento de los componentes de repuesto	81
Configuración del emparejamiento	81
Emparejamiento de un EPG de la parte inferior de la pierna con un EPG del muslo ...	81

Emparejamiento de una unidad de control nueva con el EPG	81
Emparejamiento de una unidad de control existente con un EPG distinto.....	82
Emparejamiento de un sensor de pie nuevo con el EPG.....	82
Capítulo 13: Solución de problemas.....	83
Uso del dispositivo de prueba	83
Preguntas frecuentes.....	86
Capítulo 14: Especificaciones técnicas.....	89
Capítulo 15: Información de conexión inalámbrica	97
Características del sistema	97
Información sobre compatibilidad electromagnética (EMC).....	98

Introducción

Las lesiones o enfermedades del sistema nervioso central causan a menudo un trastorno en la marcha denominado pie péndulo. Las personas con pie péndulo no pueden levantar el pie al caminar. A menudo lo arrastran, lo que provoca inestabilidad y un mayor esfuerzo durante la marcha. Muchas personas con lesiones o enfermedades del sistema nervioso central también sufren debilidad muscular en el muslo, que puede presentarse con o sin pie péndulo. Esta dolencia puede producir importantes dificultades a la hora de flexionar o extender la rodilla al caminar.

El sistema L300 Go se ha diseñado para mejorar la marcha de las personas que sufren de pie péndulo y facilitar la flexión o extensión de la rodilla en personas con debilidad muscular en el muslo. El sistema L300 Go se comunica de forma inalámbrica para transmitir impulsos eléctricos a través del nervio peroneo común al punto motor del músculo tibial anterior, provocando la dorsiflexión del tobillo en la fase de balanceo de la marcha para evitar la caída del pie. El sistema L300 Go también puede proporcionar estimulación al cuádriceps o los femorales a fin de facilitar la flexión o extensión de la rodilla durante la marcha. También puede proporcionar estimulación a los músculos de la parte superior e inferior de la pierna para facilitar la rehabilitación del músculo, evitar o retardar la atrofia por falta de uso, mantener o aumentar el ángulo de movilidad de la articulación y aumentar el flujo sanguíneo local.

El sistema L300 Go consta de una banda de estimulación funcional (EF) para la parte inferior de la pierna (disponible en tamaño normal y pequeño) con un generador de pulso electrónico (EPG), una banda de estimulación funcional para el muslo con un EPG, una unidad de control opcional y un sensor de pie opcional. Las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y del muslo se pueden emplear de forma conjunta o independiente.

El sistema L300 Go está diseñado para usarse en hospitales o instalaciones sanitarias profesionales, además de en entornos residenciales o de atención sanitaria a domicilio.

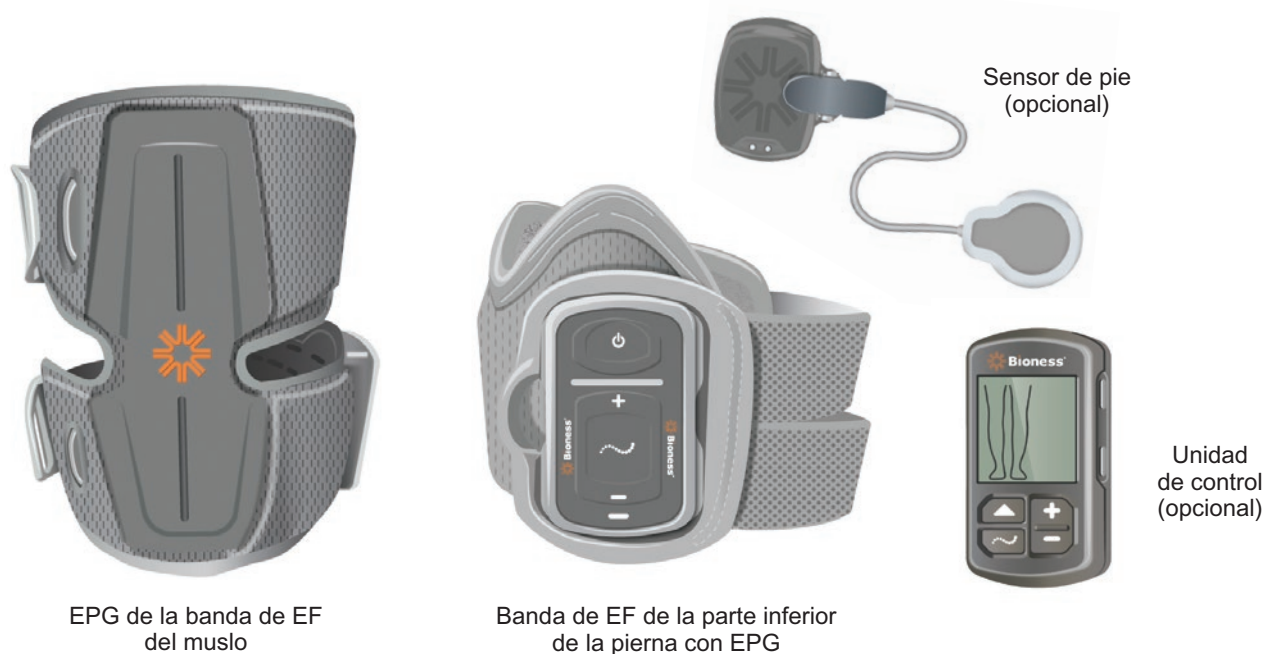


Ilustración: Sistema L300 Go

En esta Guía del especialista del sistema L300 Go se describe lo siguiente:

- Información de seguridad importante sobre el sistema L300 Go.
- Los componentes del sistema L300 Go.
- Cómo instalar, hacer funcionar y realizar el mantenimiento del sistema L300 Go.
- El software de la aplicación del especialista del sistema L300 Go.
- Cómo ajustar el sistema L300 Go.
- Cómo programar el sistema L300 Go.
- Información para solucionar problemas.

El kit del especialista y el programador médico del sistema L300 Go incluyen los componentes y accesorios necesarios para ajustar y programar el sistema L300 Go. Esta Guía del especialista describe el contenido y las instrucciones de uso de este kit. Se proporciona una breve descripción de los componentes del sistema L300 Go como referencia. Consulte la Guía del usuario del sistema L300 Go para obtener información completa sobre el contenido y las instrucciones de uso del kit del sistema L300 Go.

Asegúrese de revisar la Guía del usuario, incluida toda la información de seguridad, junto a los pacientes antes de que estos usen el sistema L300 Go. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con el Departamento de relaciones con el cliente de Bioness en el teléfono +1 800 211 9136, opción 3, o visite el sitio web de Bioness en: www.bioness.com.

Información de seguridad

Indicaciones de uso

La función del sistema L300 Go es facilitar la dorsiflexión del tobillo en pacientes adultos y pediátricos con pie péndulo, así como ayudar con la flexión y extensión de la rodilla en adultos aquejados de debilidad muscular provocada por una lesión o enfermedad neuronal motora superior (como apoplejía, daño en las vías nerviosas de la médula espinal). El sistema L300 Go estimula eléctricamente los músculos de la pierna afectada para facilitar la dorsiflexión del tobillo y flexión o extensión de la rodilla; por lo tanto, también puede mejorar la marcha del paciente.

El sistema L300 Go también:

- Facilita la rehabilitación del músculo.
- Evita o retarda la atrofia por falta de uso.
- Mantiene o aumenta el ángulo de movilidad de la articulación.
- Aumenta el flujo sanguíneo local.

Contraindicaciones

- Los pacientes con marcapasos a demanda, desfibriladores u otros implantes eléctricos no deben utilizar el sistema L300 Go.
- El sistema L300 Go no se debe utilizar en piernas con implantes metálicos directamente bajo los electrodos.
- El sistema L300 Go no se debe utilizar si hay, o si se sospecha que pueda haber, una lesión cancerosa en la pierna.
- El sistema L300 Go no se debe utilizar en piernas con trastornos localizados, como fracturas o dislocaciones, que se verían adversamente afectadas por el movimiento de la estimulación.

Advertencias

- Se desconocen los efectos a largo plazo de la estimulación eléctrica prolongada.
- Las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y el muslo no deben aplicarse sobre áreas hinchadas, infectadas o inflamadas ni sobre erupciones de la piel, como en el caso de flebitis, tromboflebitis y varices.
- La conexión simultánea del sistema L300 Go al paciente y al equipamiento quirúrgico de alta frecuencia puede ocasionar quemaduras en la zona de los electrodos del estimulador y posibles daños en el EPG.
- No utilice el sistema L300 Go a menos de un metro (tres pies) de distancia de un equipo de tratamiento de onda corta o microondas. Dicho equipo puede producir inestabilidad en la salida del EPG.
- La configuración del sistema L300 Go solo la debe realizar un especialista autorizado.

- En caso de incomodidad, desactive la estimulación y retire la banda de EF de la parte inferior de la pierna o la banda de EF del muslo. Si no es posible desactivar la estimulación, retire la banda de EF para detenerla.

Precauciones

- La inflamación en la zona de la banda de EF de la parte inferior de la pierna o el muslo puede agravarse con el movimiento, la actividad muscular o la presión de las propias bandas. Recomiende a los pacientes que dejen de usar el sistema L300 Go hasta que desaparezca la inflamación por completo.
- Actúe con precaución al tratar a pacientes que padezcan problemas cardíacos o que se sospeche que puedan padecerlos.
- Recomiende a los pacientes que utilicen la banda de EF con precaución:
 - Si el paciente tiene tendencia a padecer hemorragias tras sufrir fracturas o traumas graves.
 - Tras intervenciones quirúrgicas recientes, si la contracción muscular puede alterar el proceso de curación.
 - Sobre áreas de la piel que no tengan una sensibilidad normal.
 - Actúe con precaución con aquellos pacientes que sufran epilepsia o que se sospeche que puedan padecerla.
- Algunos pacientes pueden experimentar irritación de la piel, reacciones alérgicas o hipersensibilidad debido a la estimulación eléctrica o al medio de conducción eléctrica. Para evitar la irritación, cambie los parámetros de estimulación, el tipo de electrodos o la ubicación de estos.
- No utilice el sistema L300 Go sin los electrodos.
- Tras quitar la banda de EF de la parte inferior de la pierna o el muslo, es normal que las zonas donde estaban los electrodos presenten enrojecimiento y hundimiento. El enrojecimiento debería desaparecer en aproximadamente una hora. El enrojecimiento crónico y la aparición de lesiones o ampollas son signos de irritación. Recomiende a los pacientes que dejen de usar el sistema L300 Go hasta que desaparezca la inflamación por completo y que informen a su especialista.
- Recomiende a los pacientes que, si la estimulación no comienza en el momento correcto durante la marcha, interrumpan el uso del sistema L300 Go y consulten a su especialista.
- Recomiende a los pacientes que apaguen el sistema L300 Go cuando se encuentren en una estación de servicio. No utilice el sistema L300 Go cerca de combustible inflamable, gases o productos químicos.
- El especialista a cargo del tratamiento tendrá la responsabilidad exclusiva de determinar el lugar de colocación de los electrodos y la configuración de la estimulación.
- Utilice únicamente electrodos del sistema L300 Go proporcionados por Bioness.
- Apague el sistema L300 Go antes de retirar o sustituir los electrodos.
- Se debe obtener la autorización específica del médico antes de utilizar el sistema L300 Go en pacientes que presenten una alteración del flujo arterial o venoso normal en la zona de la banda de EF por insuficiencia u oclusión localizadas, fístula arteriovenosa para hemodiálisis o trastorno primario de la vasculatura.
- Se debe obtener la autorización específica del médico antes de usar el sistema L300 Go en aquellos casos en que los pacientes presenten una deformidad estructural en la zona que va a ser objeto de estimulación.

- No se ha comprobado la seguridad del uso del sistema L300 Go durante el embarazo.
- El uso del sistema L300 Go podría agravar los problemas cutáneos previos presentes en la pierna en la que se coloquen las bandas de EF de la parte inferior de la pierna o el muslo.
- Se debe proporcionar supervisión y asistencia por parte de un adulto a cualquier usuario que necesite ayuda al usar el sistema L300 Go.
- La intención es que sea el paciente quien haga funcionar el sistema L300 Go.
- La correa para el cuello de la unidad de control sirve para colocarse en el cuello y, si no se usa correctamente, podría producir lesiones.
- Evite todo contacto de los componentes electrónicos con el agua (por ejemplo, el agua proveniente de la lluvia, la nieve, los fregaderos, las bañeras, las duchas, etc.).
- No guarde el sistema L300 Go en lugares con temperaturas que puedan superar la temperatura de almacenamiento recomendada: de -25 °C a 55 °C (de -13 °F a 131 °F). Las temperaturas extremas pueden ocasionar daños en el dispositivo.
- No intente reparar el sistema L300 Go. Si se produce algún problema técnico que no esté incluido en esta guía, póngase en contacto con Bioness.
- Las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y del muslo solo se deben llevar en la pierna del paciente para el que se han ajustado. No debe ser usada por otra persona ni en otra parte del cuerpo.
- Apague el sistema L300 Go antes de colocar las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y el muslo. No encienda el sistema L300 Go hasta que las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y el muslo estén ajustadas en su lugar.
- Recomiende a los pacientes que apaguen el sistema L300 Go si van a conducir, a manejar maquinaria o a realizar cualquier actividad en la que las contracciones musculares involuntarias puedan suponer un riesgo de lesión.
- Proteja los componentes electrónicos del sistema L300 Go de la condensación. Al pasar de temperaturas altas a bajas o viceversa, coloque los componentes en una bolsa de plástico hermética y permita que se ajusten lentamente a los cambios de temperatura (al menos dos horas) antes de utilizar el sistema.
- El equipo médico eléctrico requiere precauciones especiales respecto a la compatibilidad electromagnética.
- Recomiende a los pacientes que retiren el sistema L300 Go antes de realizar cualquier procedimiento médico terapéutico o de diagnóstico, como exploraciones radiológicas, ecografías, resonancia magnética (IRM), etc.
- Si bien el sistema L300 Go (banda inferior pequeña) está diseñado para su ajuste y colocación tanto en pacientes pediátricos como en personas pequeñas, su gestión y mantenimiento debe llevarse a cabo exclusivamente por usuarios adultos, cuidadores adultos o profesionales sanitarios.

Reacciones adversas

En el improbable caso de que se produzca alguna de las siguientes reacciones, recomiende a los pacientes que dejen de utilizar de inmediato el sistema L300 Go y que consulten a su especialista:

- Signos de irritación significativa de la piel o úlceras por presión en áreas de contacto con la banda de EF.
- Aumento significativo de la espasticidad muscular.
- Sensación de estrés cardíaco durante la estimulación.
- Hinchazón de la pierna, la rodilla, el tobillo o el pie.

Se han dado casos de irritaciones de la piel y quemaduras con el uso de estimuladores musculares eléctricos en la zona de contacto de los electrodos.

Guía para el cuidado de la piel

Ante la falta de un cuidado adecuado de la piel, el uso prolongado de la estimulación eléctrica puede provocar irritación de la piel o una reacción de la piel a los electrodos o las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y del muslo. La irritación en la piel tiende a producirse después de aproximadamente tres meses de uso. Para proteger la salud de la piel al usar el sistema L300 Go por un tiempo prolongado, es importante seguir una rutina diaria para el cuidado cutáneo:

- Limpie la piel donde se adhieren los electrodos con un paño húmedo. Si se han aplicado aceites o lociones a la piel, límpiela con agua y jabón. Enjuague bien.
- Compruebe siempre que no haya enrojecimiento o sarpullidos en la piel cuando se coloquen o se quiten las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y del muslo.
- Sustituya los electrodos cada dos semanas, o con más frecuencia, aunque parezcan estar en buenas condiciones.
- Si el paciente usa los Electrodos Cloth, para conseguir un rendimiento óptimo, recomíéndeles humedecerlos antes del uso y cada tres o cuatro horas.
- Después de quitar la banda de EF de la parte inferior de la pierna o del muslo, vuelva a tapar siempre que sea aplicable los Electrodos Hydrogel con sus cubiertas protectoras de plástico.
- El vello corporal excesivo donde se adhieren los electrodos puede reducir el contacto de estos con la piel. Si es necesario, elimine el vello corporal excesivo en el lugar donde se adhieren los electrodos con una afeitadora eléctrica o con tijeras. No utilice hojas de afeitar. Las hojas de afeitar pueden irritar la piel.
- Cuando coloque las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y del muslo, asegúrese de que los electrodos hacen contacto con la piel de manera uniforme.
- Airee la piel al menos 15 minutos cada tres o cuatro horas retirando las bandas de EF de la parte inferior de la pierna y del muslo.

Si se produce irritación o una reacción cutánea, los pacientes deben suspender el uso del sistema L300 Go de inmediato y ponerse en contacto con su especialista o su dermatólogo. También pueden ponerse en contacto con el servicio técnico de Bioness en el teléfono +1 800 211 9136, opción 3. Podrán reanudar su uso solo cuando la piel esté completamente recuperada y, luego, seguir el protocolo de acondicionamiento de la piel de acuerdo con las recomendaciones de su especialista en atención médica.

Condiciones ambientales que afectan al uso

Información de comunicación por radiofrecuencia (RF)

Varios componentes del sistema L300 Go se comunican por radio. Se han realizado pruebas en estos componentes y se ha comprobado que cumplen con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 (Dispositivos de RF) de las normativas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de RF y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no vayan a producirse interferencias en ninguna instalación en particular. Si este equipo causa una interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a tratar de corregir dicha interferencia por medio de una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte al vendedor del equipo o a un técnico especialista en radio y televisión para obtener asistencia.

La antena respectiva de cada transmisor no debe estar ubicada en el mismo lugar ni operando en conjunción con ninguna otra antena o transmisor.

Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles podrían afectar al sistema L300 Go.

Certificación de conformidad

El sistema L300 Go cumple la Sección 15 de las normativas de FCC. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple los límites de exposición a radiofrecuencias establecidos por la FCC para entornos sin control.

Seguridad en viajes y aeropuertos

El cargador con enchufes intercambiables del sistema L300 Go es compatible con las tensiones de Australia, Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos: 100-240 V, 50/60 Hz.

Recomiende a los pacientes que apaguen el sistema L300 Go antes de ingresar al control de seguridad en los aeropuertos y que utilicen ropas sueltas de modo que puedan mostrar fácilmente el sistema a la persona encargada de controlar la seguridad. Es probable que el sistema L300 Go active la alarma de seguridad. Los pacientes deben estar preparados para retirar el sistema L300 Go para que el personal de seguridad pueda examinarlo o para pedir que se escanee el sistema si no quieren retirarlo. Se recomienda que los pacientes lleven consigo una copia de la receta médica para usar el sistema L300 Go.

Para solicitar una copia de la receta, los pacientes pueden ponerse en contacto con Bioness o con su médico.

Nota: El sistema L300 Go contiene radiotransmisores. Las normativas de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. indican que todos los dispositivos radiotransmisores se deben apagar durante el vuelo. Consulte a su aerolínea sobre el uso de Bluetooth de baja energía antes de encender el sistema L300 Go durante el vuelo.

Emisiones electromagnéticas

El sistema L300 Go presenta medidas de seguridad especiales relativas a la compatibilidad electromagnética (EMC). El sistema se debe instalar y poner en servicio de acuerdo a la información sobre EMC proporcionada en este manual. Consulte el capítulo 15.

El sistema L300 Go se ha probado y certificado para usar los siguientes elementos:

- Adaptador de CA con enchufes intercambiables, modelo LG4-7200, proporcionado por Bioness Inc. y fabricado por Kuantech (Veihai) Co., Ltd.
- Cable de carga magnético, modelo LG4-7100, proporcionado por Bioness Inc. y fabricado por Onanon, Inc.

Advertencias

- No utilice el sistema L300 Go a menos de 1 metro (tres pies) de equipos terapéuticos de onda corta o de microondas. Estos equipos podrían producir inestabilidad en el resultado del EPG.
- Retire el sistema L300 Go antes de realizar cualquier procedimiento médico terapéutico o de diagnóstico, como exploraciones radiológicas, ecografías, resonancia magnética (IRM), etc.
- No se debe usar el sistema L300 Go sujeto a otro equipo ni apilado. Si es necesario usarlo sujeto a otro equipo o apilado, hay que comprobar que el equipo o el sistema funcionan correctamente en la configuración que se empleará.
- El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados, con la excepción de los transductores y cables vendidos por el fabricante del sistema L300 Go como piezas de repuesto de los componentes internos, pueden producir un aumento de las emisiones o una disminución del aislamiento del sistema L300 Go.
- El sistema L300 Go puede sufrir interferencias de otros equipos, aunque esos equipos cumplan las normativas sobre emisiones del CISPR (Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas, Comisión electrotécnica Internacional).
- Si el volumen de la alerta sonora es inferior al sonido ambiente, este puede impedir que el usuario reconozca la condición de alerta.

El sistema L300 Go

El sistema L300 Go consta de una banda de estimulación funcional (EF) para la parte inferior de la pierna con un generador de pulso electrónico (EPG), una banda de estimulación funcional para el muslo con un EPG, una unidad de control y un sensor de pie opcional.

El sistema L300 Go tiene dos tipos de kits del sistema: Parte inferior de la pierna y muslo. Los componentes del kit del sistema de la parte inferior de la pierna se comunican de forma inalámbrica para estimular el nervio peroneo común (que normalmente se encuentra en la parte posterior y levemente distal con respecto a la cabeza del peroné) a fin de contraer los músculos tibial anterior y peroneo, lo que provoca una dorsiflexión equilibrada (sin supinación ni pronación excesivas). Los componentes del kit del sistema de muslo se comunican de forma inalámbrica para estimular el cuádriceps o los femorales a fin de facilitar la flexión o extensión de la rodilla.

Banda de EF de la parte inferior de la pierna

La banda de EF de la parte inferior de la pierna es una órtesis que se ajusta a la pierna directamente bajo la rótula y está diseñada para facilitar el movimiento ascendente del pie y los dedos. Consulte la ilustración 4-1. La banda de EF de la parte inferior de la pierna está disponible en dos configuraciones (para la parte inferior de la pierna izquierda y para la derecha) y en dos tamaños (normal y pequeña). La banda de EF de la parte inferior de la pierna incluye un estuche para el EPG, el EPG de la parte inferior de la pierna y electrodos integrados. También incluye un localizador diseñado anatómicamente para conseguir una posición correcta en la pierna y una correa que se puede apretar con una mano.

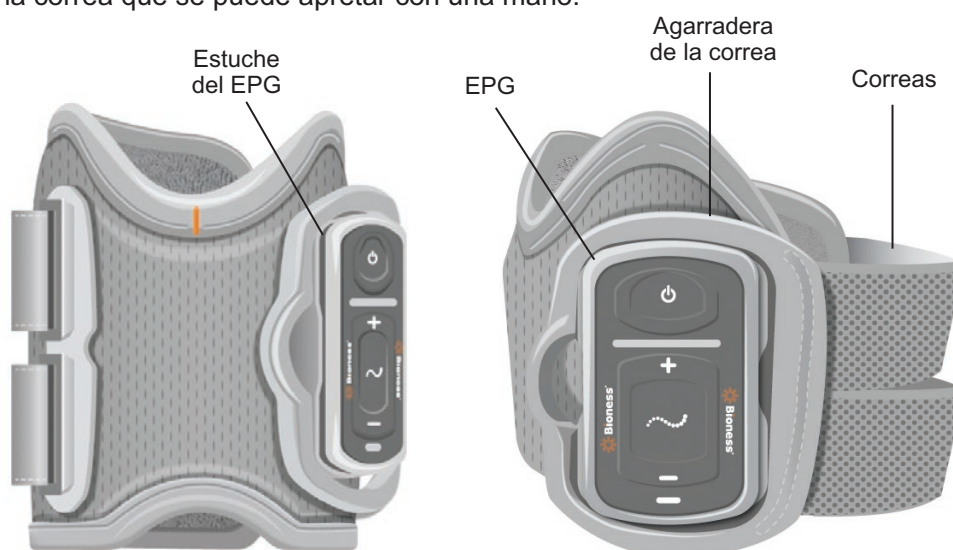


Ilustración 4-1: Banda de EF de la parte inferior de la pierna

Banda de EF del muslo

La banda de EF del muslo es una órtesis liviana que se coloca por encima de la rodilla, centrada en la parte trasera o delantera del muslo. Está diseñada para ayudar con la flexión o la extensión de la rodilla. Consulte la ilustración 4-2. La banda de EF del muslo está disponible en configuración izquierda y derecha.

La banda de EF del muslo incluye un estuche para el EPG, el EPG del muslo y electrodos integrados. También un localizador que se usa para colocar con precisión la banda de EF del muslo en la pierna y para garantizar el contacto repetido del electrodo. La banda de EF del muslo cuenta con correas ajustables para sujetarla

correctamente al muslo. La banda de EF del muslo se puede usar de forma independiente o junto con la banda de EF de la parte inferior de la pierna.

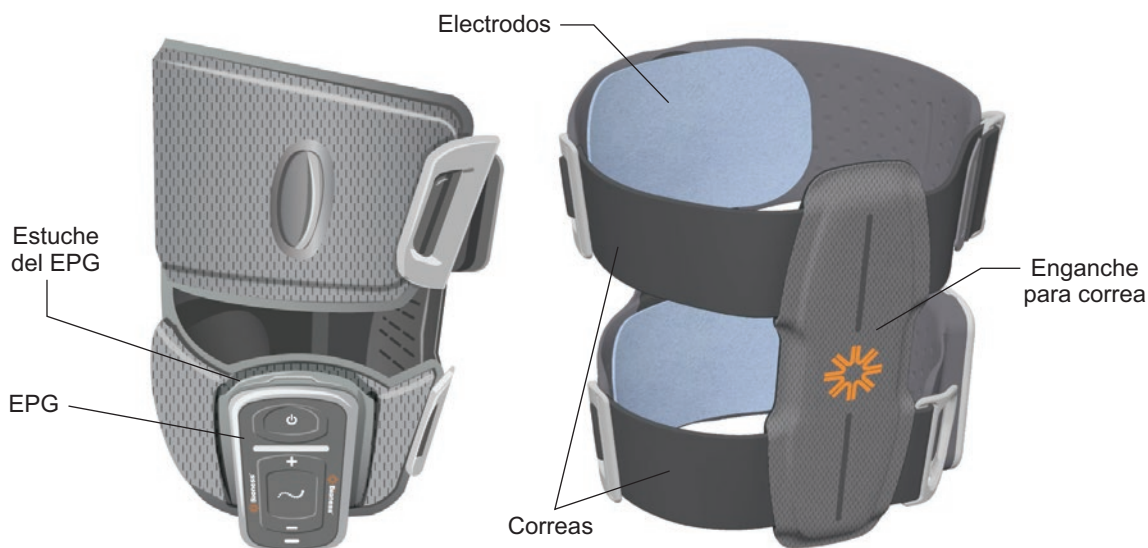


Ilustración 4-2: Banda de EF del muslo

La eficacia del estímulo de contracción muscular de la banda de EF del muslo depende de la amplitud, la duración, la frecuencia y la forma de la onda de la señal de estimulación eléctrica. El especialista puede ajustar los parámetros de estimulación para repercutir en la fuerza, la eficacia y la sincronización de la contracción muscular a fin de proporcionar flexión o extensión de la rodilla al caminar.

EPG de la parte inferior de la pierna y EPG del muslo

El EPG de la parte inferior de la pierna genera la estimulación eléctrica usada para contraer los músculos de la pierna que permiten alzar el pie y los dedos. El EPG incluye un sensor de movimiento integrado y un algoritmo de detección de la marcha para sincronizar la estimulación eléctrica con los eventos de marcha (detecta cuándo se eleva el talón y cuándo se apoya). El EPG de la parte inferior de la pierna también responde a las señales inalámbricas Bluetooth® de baja energía (BLE) de la unidad de control y del sensor de pie opcional. Si un paciente lleva puesta la banda de EF de la parte inferior de la pierna y la banda de EF del muslo, el EPG de la parte inferior de la pierna también envía señales inalámbricas al EPG del muslo.

El EPG del muslo genera la estimulación eléctrica usada para flexionar o extender la rodilla. El EPG del muslo responde a las señales inalámbricas provenientes de la unidad de control, del EPG de la parte inferior de la pierna (en pacientes que usan ambas bandas) y del sensor de pie para activar o desactivar la estimulación.

La eficacia de la provocación de la fuerza de contracción muscular depende de la amplitud, la duración, la frecuencia y la forma de la onda de la señal de estimulación eléctrica. El especialista puede ajustar la estimulación y los parámetros de la marcha para repercutir en la fuerza, la eficacia y la sincronización de la contracción muscular. El EPG puede activar uno o dos canales de estimulación, según el tipo de banda y el electrodo establecido previamente. Consulte el capítulo “Programación del paciente” de esta guía para obtener más información.

Los pacientes también pueden controlar la estimulación eléctrica mediante los botones del EPG o de forma inalámbrica con la unidad de control. El EPG incluye cuatro botones, dos indicadores luminosos y una batería recargable (de ion-litio de 1000 mAh). Consulte la ilustración 4-3, la tabla 4-1 y la tabla 4-2. Emite una alerta sonora cuando falla la comunicación inalámbrica o cuando el componente no funciona correctamente.

El EPG se engancha en el estuche de la banda y solo se debe sacar de este estuche para realizar labores de mantenimiento y para limpiar las bandas. El puerto de carga de la batería está situado en la parte inferior del EPG, bajo una cubierta flexible.

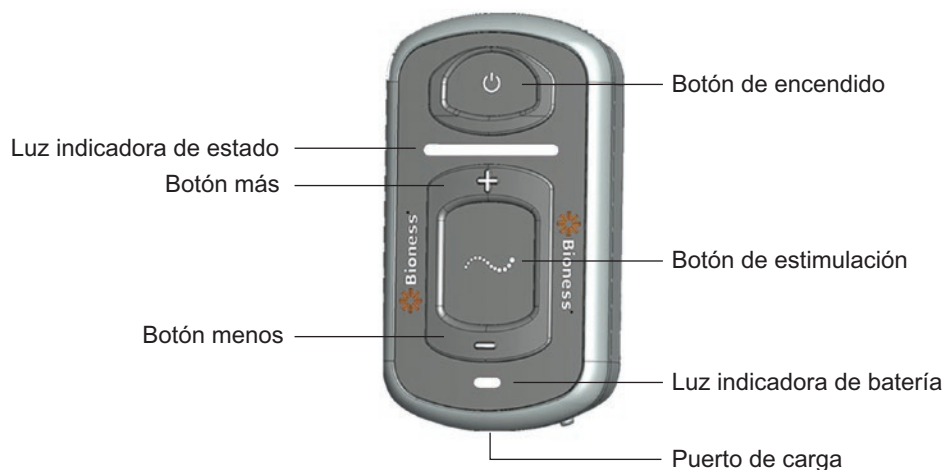


Ilustración 4-3: EPG

El EPG emite una señal visual (consulte la tabla 4-1) o sonora en estas circunstancias: cuando se pulsa un botón del EPG, cuando se proporciona estimulación, cuando se detecta un error o cuando el nivel de la batería está bajo. El EPG vibra en estas circunstancias: cuando se pulsa un botón del EPG, cuando se proporciona estimulación o cuando se detecta un error.

EPG	Indicador	Descripción	Definición
Luz indicadora de estado	(intermitente)	Luz verde intermitente	El EPG está encendido. No hay estimulación.
	(intermitente)	Luz amarilla intermitente	El EPG está encendido y proporciona estimulación.
	(fija)	Luz amarilla fija	El EPG está encendido y proporciona estimulación manual.
	(alternativamente)	Luz verde, amarilla y roja alternativamente	Modo de emparejamiento.
	(intermitente)	Luz roja intermitente	Error activo, error de funcionamiento del EPG o batería vacía.
Luz indicadora de batería	(intermitente)	Luz verde intermitente	La batería del EPG se está cargando.
	(fija)	Luz verde fija breve durante el encendido	La carga del EPG está completa.
	(fija)	Luz amarilla fija	La carga de la batería del EPG está baja.

Tabla 4-1: Indicadores del EPG

Botón del EPG	Descripción	Función
	Botón de encendido	Permite encender y apagar el sistema.
	Botón de estimulación	Activa o desactiva la estimulación en el modo seleccionado actual.
	Botón más	Aumenta la intensidad de la estimulación.
	Botón menos	Disminuye la intensidad de la estimulación.

Tabla 4-2: Funciones de los botones del EPG

Unidad de control

La unidad de control es un dispositivo de mano opcional que se comunica de forma inalámbrica con el sistema L300 Go. Envía y recibe señales inalámbricas de los EPG y del sensor de pie. Se usa para seleccionar un modo de funcionamiento, activar o desactivar la estimulación, ajustar detalladamente la intensidad de la estimulación, ajustar el volumen de la señal sonora del EPG y supervisar el rendimiento del sistema.

La unidad de control presenta seis botones y una pantalla LCD. Consulte la ilustración 4-4, la tabla 4-3 y la tabla 4-4. Se alimenta mediante una sola batería de botón de litio (CR2032). La pantalla LCD de la unidad de control muestra el rendimiento del sistema L300 Go. Indica el nivel de intensidad de la estimulación, el modo de funcionamiento, el estado de carga de la batería, el estado de registro electrónico y los mensajes de error. Consulte la tabla 4-4.

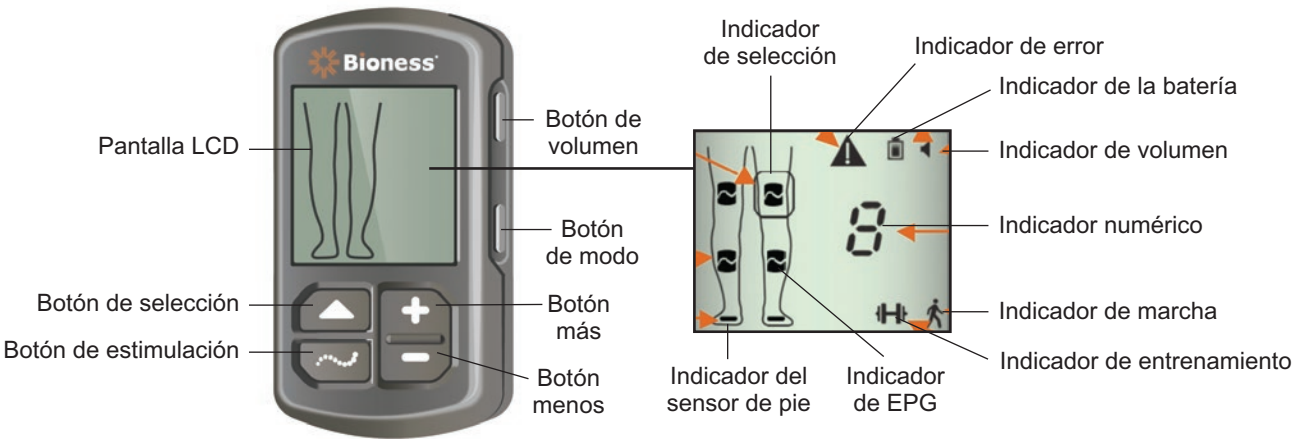


Ilustración 4-4: Unidad de control








Botón de la unidad de control	Descripción	Función
	Botón de selección	Selecciona un EPG.
	Botón de estimulación	Activa o desactiva la estimulación en el modo seleccionado actual.
	Botón más	Aumenta la intensidad de la estimulación.
	Botón menos	Disminuye la intensidad de la estimulación.
	Botón de volumen	Activa o desactiva las señales sonoras del EPG.
	Botón de modo	Permite seleccionar el modo de marcha o de entrenamiento.

Tabla 4-3: Funciones de los botones de la unidad de control

Iconos de la pantalla LCD	Descripción	Función
	EPG: icono de estado preparado	El sistema se está comunicando con el EPG, pero no proporciona estimulación.
	EPG: icono de estado de estimulación	El sistema se está comunicando con el EPG y este proporciona estimulación.
 (intermitente)	EPG: icono de estado de error	Se ha detectado un error con el EPG que emite luz intermitente.

Iconos de la pantalla LCD	Descripción	Función
	Icono de selección	Indica el EPG seleccionado.
	Icono del sensor de pie	El sistema se está comunicando con el sensor de pie.
 (intermitente)	Icono de error del sensor de pie	Se ha detectado un error con el sensor de pie.
	Icono del modo de marcha	El sistema se encuentra en modo de marcha.
	Icono del modo de entrenamiento	El sistema se encuentra en modo de entrenamiento.
	Icono de nivel de batería (normal)	La batería del EPG seleccionado está cargada.
 (intermitente)	Icono de nivel de batería (baja)	El nivel de la batería del EPG seleccionado es bajo y debe recargarse.
 (intermitente)	Icono de error	El sistema ha detectado un error.
	Icono de volumen	Indica que las señales sonoras o táctiles están activas.
	Indicador numérico: nivel de intensidad de la estimulación	Muestra el nivel actual de intensidad de la estimulación.
	Indicador numérico: error	Cambia entre "E" y el número de error.
	Indicador numérico: emparejamiento	Aparece una "P" que indica que la unidad de control se encuentra en modo de emparejamiento.

Tabla 4-4: Descripción de los iconos de la pantalla LCD de la unidad de control

Modos de funcionamiento del sistema L300 Go

El sistema L300 Go tiene tres modos de funcionamiento: marcha, entrenamiento y clínico.

Modo de marcha

El modo de marcha se utiliza al caminar. En él, la estimulación se sincroniza con los eventos de la marcha, ya sea mediante el sensor de movimiento integrado en el EPG o con el sensor de pie, para lograr la dorsiflexión y la extensión o flexión de la rodilla cuando el talón o el antepié se separan del suelo y la relajación cuando toman contacto con de nuevo con la superficie.

Durante la marcha, la estimulación de los EPG de la parte inferior de la pierna o el muslo se controla con el mismo detector de eventos de marcha: el sensor de movimiento del EPG de la parte inferior de la pierna o el sensor de pie, según la fase concreta de la marcha.

Modo de entrenamiento

El modo de entrenamiento se utiliza para entrenar los músculos mientras el paciente no camina (por ejemplo, cuando está sentado o recostado). Funciona de forma independiente del sensor de pie y de los sensores de movimiento del EPG de la parte inferior de la pierna. La estimulación se proporciona en ciclos preestablecidos.

En el caso de los pacientes que usan la banda de EF de la parte inferior de la pierna, el modo de entrenamiento está diseñado para facilitar la rehabilitación de los músculos, prevenir o retardar la atrofia por falta de uso de los músculos de la parte inferior de la pierna, mantener o mejorar el rango de movimiento de la articulación del tobillo y mejorar la circulación sanguínea local. En el caso de los pacientes que usan la banda de EF del muslo, el modo de entrenamiento está diseñado para facilitar la rehabilitación de los músculos, prevenir o retardar la atrofia por falta de uso de los músculos del muslo, mantener o mejorar el rango de movimiento de la articulación de la rodilla y mejorar la circulación sanguínea local.

Modo clínico

El modo clínico permite al especialista aplicar un entrenamiento mejorado. Se usa para iniciar o pausar la estimulación en la banda de EF de la parte inferior de la pierna y en la banda de EF del muslo de forma independiente o simultánea. El especialista puede seleccionar el modo clínico para mejorar el entrenamiento, de manera que abarque, por ejemplo, el entrenamiento del equilibrio en pacientes agudos y subagudos. El modo clínico utiliza los parámetros de estimulación establecidos para el modo de marcha. Para activar el modo clínico, el especialista debe mantener presionados durante cinco segundos los botones de estimulación y menos en la unidad de control. Al presionar el botón de estimulación, se proporciona estimulación manual a las bandas seleccionadas. Para salir del modo clínico, presione el botón de modo.

Sensor de pie

El sensor de pie es un componente opcional del sistema L300 Go. El sensor de pie usa un algoritmo de seguimiento de la marcha dinámico para detectar si el pie se encuentra en el suelo o en el aire y transmite señales inalámbricas a los EPG para sincronizar la estimulación según el patrón de la marcha.

Nota: El sensor de pie es necesario en el sistema L300 Go Thigh Stand-Alone. Envía la señal inalámbrica al EPG del muslo para activar o desactivar la estimulación.

El sensor de pie incluye un sensor de presión, un transmisor y un enganche. Consulte la ilustración 4-5. El sensor de presión está ubicado debajo de la plantilla del calzado del paciente. El transmisor se sujeta mediante una pinza al borde interno del zapato. El sensor de pie también presenta dos indicadores luminosos y se alimenta mediante una sola batería de botón de litio (CR2032). Consulte la ilustración 4-5 y la tabla 4-5.

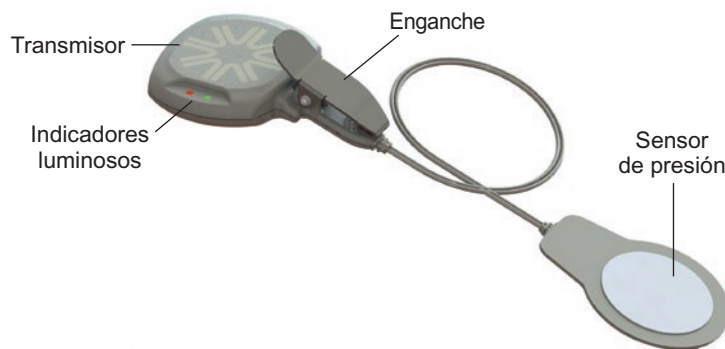


Ilustración 4-5: Sensor de pie

⚠ Atención: El uso del sensor de pie no ha sido homologado para individuos cuyo peso sea superior a los 136 kilogramos (300 libras).

⚠ Atención: No utilice el sensor de pie con una plantilla rígida, como las órtesis rígidas hechas a medida o las órtesis de tobillo y pie.





Sensor de pie	Indicador	Descripción	Definición
Luz indicadora	 (intermitente dos veces)	Luz verde intermitente dos veces	El sensor de pie está activo.
	 (intermitente)	Luz verde intermitente lenta	Modo de emparejamiento.
	 (intermitente durante 5 segundos)	Luz roja intermitente durante 5 segundos	La batería está baja.
	 (fija)	Luz roja fija	Error

Tabla 4-5: Indicadores del sensor de pie

Carga del sistema L300 Go

El EPG de la parte inferior de la pierna y el del muslo son los únicos componentes del sistema L300 Go que se pueden cargar. Los EPG se deben cargar a diario y Bioness recomienda cargarlos mientras están conectados a las bandas de EF.

Los EPG se deben cargar con el juego de cargador del sistema incluido en los kits del sistema L300 Go. El juego de cargador del sistema incluye un adaptador de CA USB 3.1A dual de 15 w, adaptadores de carga para enchufes de EE. UU. e internacionales y un cable cargador USB magnético.

Para cargar el sistema L300 Go:

1. Saque el juego de cargador del sistema del embalaje y seleccione el adaptador adecuado a su país o región.
2. Inserte el extremo USB del cable de carga magnético en cualquiera de los dos puertos USB disponibles en el adaptador de CA. Si va a cargar tanto la banda de EF de la parte inferior de la pierna como la banda de EF del muslo, conecte un cable de carga USB adicional al adaptador de CA. Consulte la ilustración 4-6.

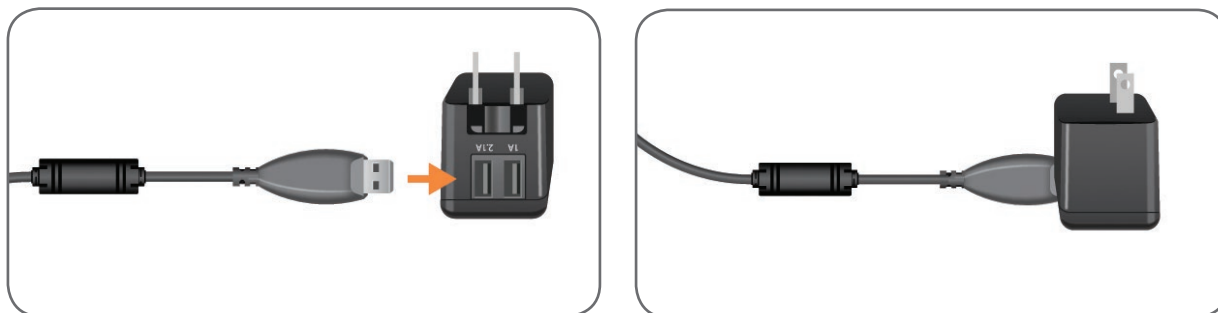


Ilustración 4-6: Inserción del cable de carga USB en el adaptador de CA

3. Conecte el extremo magnético del cable de carga con el puerto de carga del EPG de la parte inferior de la pierna o del EPG del muslo. El puerto de carga está situado en la parte inferior del EPG, bajo la cubierta flexible. Consulte la ilustración 4-7.
4. Enchufe el adaptador de CA mediante los cables de carga USB magnéticos conectados a una toma de corriente.
5. El indicador luminoso de la batería de los EPG emitirá luz intermitente verde para indicar el proceso de carga.
6. El indicador luminoso de la batería de los EPG se volverá de color verde fijo cuando el sistema esté completamente cargado.



Ilustración 4-7: Configuración del juego de cargador del sistema L300 Go
(ejemplo de configuración con una banda de EF de la parte inferior de la pierna y una banda del muslo)

⚠ Atención: Use únicamente el cargador incluido en el kit del sistema L300 Go. Si usa cualquier otro cargador, podría dañar el sistema.

⚠ Atención: Para desconectar por completo la entrada de alimentación, el adaptador de CA del juego de cargador del sistema debe desconectarse de la toma eléctrica principal.

Encendido y apagado del sistema L300 Go

Para encender el sistema L300 Go, presione el botón de encendido una vez en el EPG de la parte inferior de la pierna o en el EPG del muslo. El sistema pasará a estar en estado preparado. Todos los indicadores luminosos se encenderán durante unos segundos mientras el sistema realiza una prueba de autoevaluación. El indicador luminoso de estado de los EPG emitirá luz verde intermitente para indicar que el sistema está encendido.

Para apagar el sistema L300 Go, mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos en el EPG de la parte inferior de la pierna o en el EPG del muslo. El EPG vibra cuando se apaga.

Selección de un modo de funcionamiento con la unidad de control

Es posible seleccionar dos modos de funcionamiento en la unidad de control: el modo de marcha y el modo de entrenamiento.

Para seleccionar un modo de funcionamiento con la unidad de control:

1. Para encender el EPG de la parte inferior de la pierna y el EPG del muslo, presione el botón de encendido de los EPG.
2. Para encender la unidad de control, presione cualquier botón.
3. Los EPG emparejados se muestran en la pantalla digital de la unidad de control con el icono del indicador de selección alrededor de los iconos de los EPG. Consulte la ilustración 7-1.
4. En el caso de los pacientes que usen tanto la banda de EF de la parte inferior de la pierna como la banda de EF del muslo, el botón de selección de la unidad de control se puede usar para alternar entre el EPG de la parte inferior de la pierna, el EPG del muslo o seleccionar ambos EPG. Consulte la ilustración 4-8.

5. Para seleccionar el modo de marcha, seleccione el botón de modo en la unidad de control hasta que aparezca el icono indicador de marcha en la esquina inferior derecha de la pantalla. Consulte la ilustración 4-8.
6. Para seleccionar el modo de entrenamiento, seleccione el botón de modo en la unidad de control hasta que aparezca el icono indicador de entrenamiento en la esquina inferior derecha de la pantalla. Consulte la ilustración 4-8.

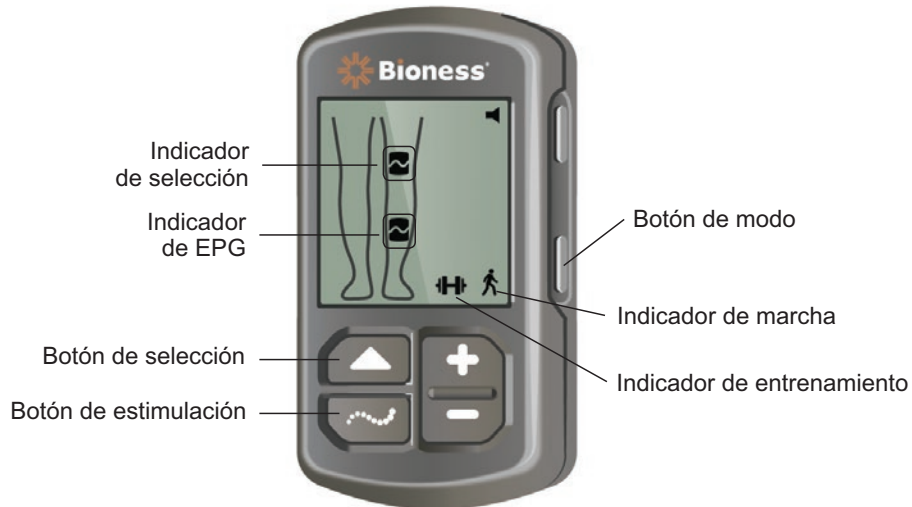


Ilustración 4-8: Selección de un modo de funcionamiento en la unidad de control

7. Para activar el modo de marcha o el de entrenamiento, presione el botón de estimulación en la unidad de control.
8. El indicador luminoso de estado de los EPG cambiará a una luz amarilla intermitente.
9. Para desvincular la unidad de control de un EPG, presione de forma simultánea el botón de modo y el botón de estimulación durante cinco segundos. Los indicadores de selección se mostrarán sin los iconos de EPG para confirmar que la desvinculación se ha realizado correctamente.

Para activar un modo de funcionamiento con el EPG:

10. Para encender el EPG de la parte inferior de la pierna y el EPG del muslo, presione el botón de encendido de los EPG.
11. Presione el botón de estimulación de uno de los EPG para activar el modo de marcha.
12. Mantenga presionado el botón de estimulación en el EPG durante tres segundos para activar el modo de entrenamiento. Presione el botón de estimulación más de tres segundos para volver al modo de marcha.

Cuando se enciende el EPG por primera vez y se presiona el botón de estimulación, se activa siempre el modo de marcha, a no ser que anteriormente se encontrara en modo de entrenamiento y no se haya apagado. La unidad de control también se puede usar para cambiar al modo de entrenamiento. Después de seleccionar el modo de entrenamiento en la unidad de control, el botón de estimulación del EPG se puede usar para activar el modo de funcionamiento seleccionado.

Ajuste de la intensidad de la estimulación

Cuando se activa por primera vez el modo de marcha o de entrenamiento, el nivel de intensidad de la estimulación es siempre el “5”. Este nivel lo establece el especialista. Normalmente, no será necesario ajustar la intensidad de la estimulación, salvo cuando camine en superficies distintas o cuando use zapatos diferentes.

Nota: Un nivel de intensidad de “0” equivale a ausencia de estimulación.

Para ajustar la intensidad de la estimulación (para pacientes que usen la banda de EF de la parte inferior de la pierna o la banda de EF Thigh Stand-Alone):

1. Presione los botones más o menos de la unidad de control o del EPG para aumentar o reducir la intensidad de la estimulación. Consulte la ilustración 4-9.
2. El nuevo número de nivel aparecerá en la pantalla digital de la unidad de control.



Ilustración 4-9: Ajuste de la intensidad de la estimulación

Para ajustar la intensidad de la estimulación (para pacientes que usen tanto la banda de EF de la parte inferior de la pierna como la banda de EF del muslo):

1. La intensidad de la estimulación debe ajustarse por separado para cada EPG que se conecte. Presione el botón de selección de la unidad de control para seleccionar el EPG de la parte inferior de la pierna o el EPG del muslo. Consulte la ilustración 4-9.
2. Presione los botones más o menos de la unidad de control para aumentar o reducir la intensidad de la estimulación. Consulte la ilustración 4-9.
3. El nuevo número de nivel aparecerá en la pantalla digital de la unidad de control.
4. Repita los pasos del uno al tres para el otro EPG conectado.

Nota: La intensidad de la estimulación también se puede ajustar sin usar la unidad de control presionando los botones más o menos en cada EPG.

Avisos sonoros y vibraciones durante la estimulación

El EPG tiene la capacidad de proporcionar avisos sonoros y vibraciones durante la estimulación. Los ajustes de los avisos sonoros y la vibración se controlan mediante la aplicación del especialista del sistema L300 Go. Si los avisos sonoros durante la estimulación están activados, el paciente los puede desactivar mediante la unidad de control.



Ilustración 4-10: Botón de volumen en la unidad de control

Para desactivar los avisos sonoros durante la estimulación:

1. Presione el botón de volumen de la unidad de control. Consulte la ilustración 4-10. El icono del indicador de volumen de la esquina superior derecha de la pantalla digital desaparecerá.

Para activar los avisos sonoros durante la estimulación:

1. Presione el botón de volumen de la unidad de control. Consulte la ilustración 4-10. El icono del indicador de volumen de la esquina superior derecha de la pantalla digital aparecerá.

Desactivación de la estimulación mediante la unidad de control y el EPG

Para desactivar la estimulación mediante la unidad de control:

1. Para encender la unidad de control, presione cualquier botón.
2. Los EPG que proporcionan estimulación se muestran en la pantalla de la unidad de control como un icono de estado de estimulación del EPG.
3. Para detener la estimulación, presione el botón de estimulación en la unidad de control. Consulte la ilustración 4-8.

Para desactivar la estimulación mediante el EPG:

1. Presione el botón de estimulación en los EPG para detener la estimulación.
2. El indicador luminoso de estado de los EPG cambiará a una luz verde intermitente.

Nota: Cuando se presiona el botón de estimulación, los EPG pasan al estado preparado en el último modo de funcionamiento seleccionado. Si se vuelve a presionar el botón de estimulación, el EPG activará la estimulación en el último modo de funcionamiento seleccionado antes de que se desactivara la estimulación.

Kit del especialista y programador médico del sistema L300 Go

El kit del especialista y el programador médico del sistema L300 Go incluyen los componentes y accesorios empleados para ajustar y programar el sistema L300 Go.


Kit del especialista del sistema L300 Go

Consulte las cantidades en la lista de contenido proporcionada con el kit del especialista del sistema L300 Go.




Programador médico del sistema L300 Go

- Programador médico, tableta con software y lápiz óptico
- Dispositivo Bluetooth®
- Cargador del programador médico




Electrodo Quick Fit
(se muestra el derecho)




Electrodo Steering Cloth
(se muestra el derecho)



Electrodo Small Quick Fit (A)




Electrodo Small Quick Fit (B)

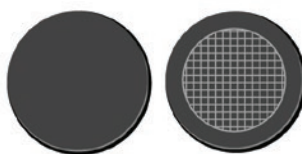

Electrodos Hydrogel




Juego de bases de electrodos
de hidrogel, 45 mm

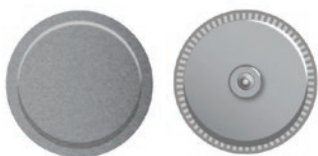


Electrodo Round Cloth, 45 mm



Juego de bases de electrodos
de tela, 45 mm




Electrodos Small Hydrogel



Electrodo Small Round Cloth,
36 mm




Juego de bases de electrodos
pequeños, 36 mm

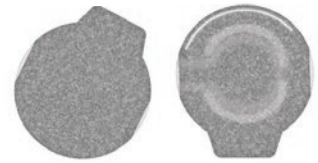

Cubiertas de broche de
banda de EF de la parte
inferior de la pierna




Programador médico

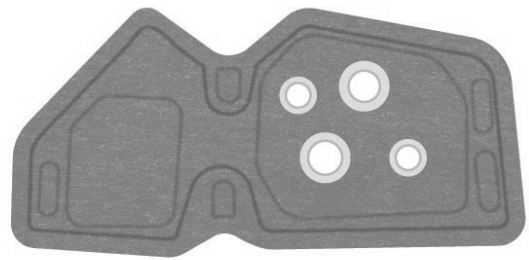

Paneles personales (se muestra el normal)




Electrodos Thigh

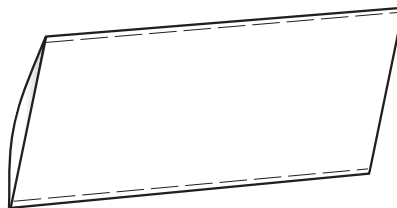

Cubiertas de correas




Correas de la banda de EF de la parte
inferior de la pierna



Almohadillas del sensor de pie



Dispositivo de prueba

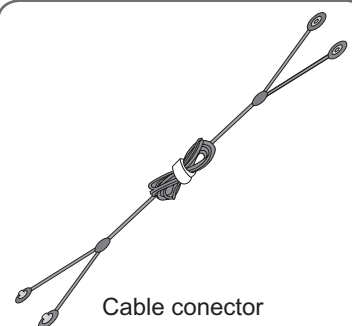

Cable conector

Descripción del ajuste y la prueba de los accesorios

Correas de la banda de EF de la parte inferior de la pierna

La correa para la banda de EF de la parte inferior de la pierna se utiliza para sujetar esta banda en el lugar correspondiente de la pierna. La correa es elástica y se ajusta alrededor de la pierna y el estuche del EF. Consulte la ilustración 6-1. La correa para la banda de EF de la parte inferior de la pierna normal se ofrece en cuatro tamaños: pequeña (S), mediana (M), grande (L) y universal. La correa para la banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña se ofrece en dos tamaños: extra pequeña (XS) y extra extra pequeña (XXS).

Para escoger una correa para la banda de EF de la parte inferior de la pierna:

- Mida la circunferencia de la pierna del paciente en el lugar más ancho (el vientre muscular del gastrocnemio) y consulte la tabla 6-1.

Para sujetar la correa para la banda de la parte inferior de la pierna a la banda de EF de la parte inferior de la pierna:

- Deslice la correa por las presillas y las hebillas de la correa de la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Compruebe que el cierre de gancho y lazo esté orientado en dirección contraria a la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Presione el cierre de gancho y lazo para asegurar la correa. Consulte la ilustración 6-2.



Ilustración 6-1: Banda de EF de la parte inferior de la pierna normal abrochada en la pierna derecha

Banda de EF de la parte inferior de la pierna normal	
Tamaño de la correa de la banda de EF	Circunferencia de la pierna
Pequeña (S)	29 a 36 cm (11 a 14 pulg.)
Mediana (M)	36 a 42 cm (14 a 16 pulg.)
Grande (L)	42 a 51 cm (16 a 20 pulg.)
Universal	29 a 51 cm (11 a 20 pulg.)

Banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña	
Tamaño de la correa de la banda de EF	Circunferencia de la pierna
Extra extra pequeña (XXS)	21 a 26 cm (8 a 10 pulg.)
Extra pequeña (XS)	25 a 31 cm (9 a 12,2 pulg.)

Tabla 6-1: Cuadro de ajuste de la correa para la banda de EF de la parte inferior de la pierna

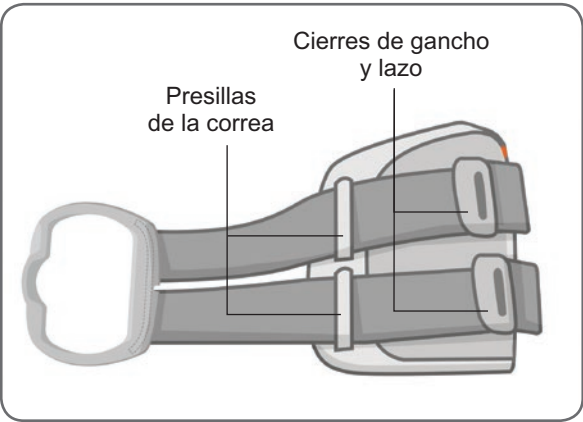


Ilustración 6-2: Correa para la banda de EF de la parte inferior de la pierna sujeta a la banda de EF de la parte inferior de la pierna normal

Cubierta de correa personal (banda de EF de la parte inferior de la pierna)

La cubierta de correa personal se desliza sobre la correa de la banda de EF de la parte inferior de la pierna y se utiliza como una cubierta higiénica cuando varios pacientes usan la misma banda de EF.

⚠ Atención: Cada cubierta de correa personal debe usarse solo con un paciente para evitar la contaminación cruzada.

Para sujetar la cubierta de correa personal:

1. Deslice la cubierta de correa personal sobre la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Consulte la ilustración 6-3.
2. Si la cubierta de correa personal es demasiado larga, córtela al tamaño adecuado.

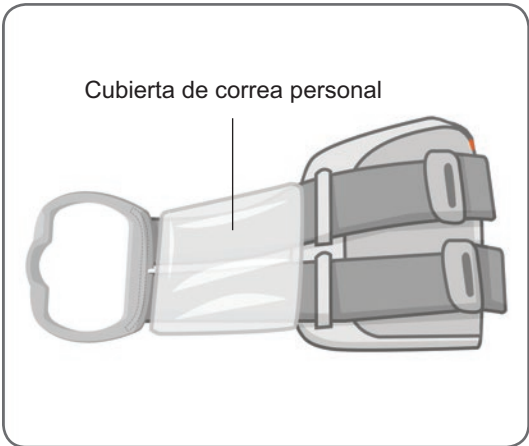



Ilustración 6-3: Cubierta de correa personal en la banda de EF de la parte inferior de la pierna

Paneles personales (banda de EF de la parte inferior de la pierna)

El panel personal es un revestimiento interno de la banda de EF de la parte inferior de la pierna que se usa en las clínicas cuando varios pacientes usan la misma banda de EF. Está disponible en tamaño pequeño y normal, así como en configuración para la pierna derecha y la pierna izquierda. El panel personal normal se usa con la banda de EF de la parte inferior de la pierna normal y presenta cuatro ojales. El panel personal pequeño se usa con la banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña y presenta dos ojales.

 **Atención:** Cada panel personal debe usarse solo con un paciente para evitar la contaminación cruzada.

Para sujetar el panel personal a la banda de EF de la parte inferior de la pierna para colocarla por primera vez:

1. Para el panel personal normal, enganche los cuatro ojales a los orificios correspondientes de la banda de EF de la parte inferior de la pierna normal. Consulte la ilustración 6-4.
2. Para el panel personal pequeño, alinee el panel con la banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña y presione para sujetar el velcro con el revestimiento interior de la banda.

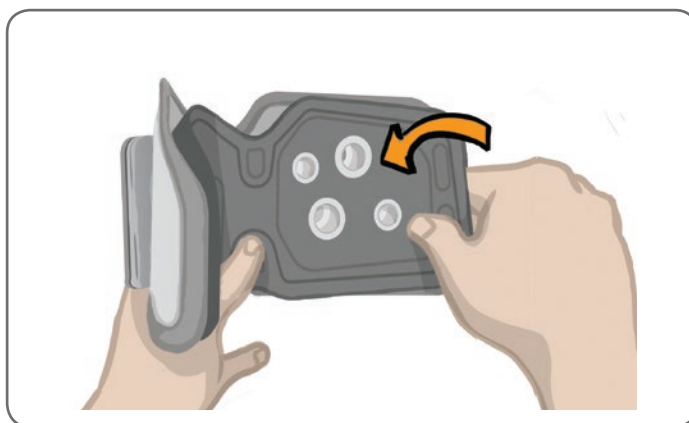


Ilustración 6-4: Sujeción del panel personal

Para retirar el panel personal de la banda de EF de la parte inferior de la pierna:

1. Saque el panel personal de la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Consulte la ilustración 6-5.

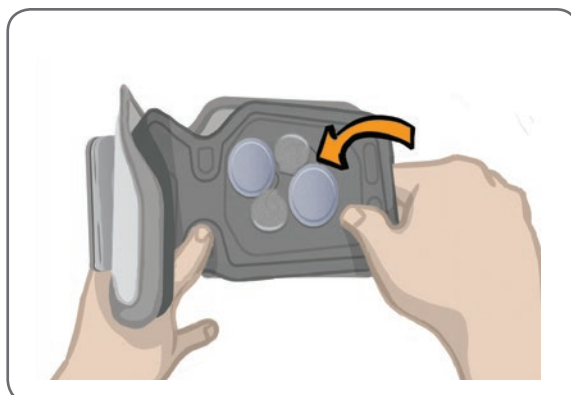


Ilustración 6-5: Retirada del panel personal

2. Escriba el nombre del paciente y el tamaño de la correa en la etiqueta del panel personal. Si se usan Electrodo Hydrogel, vuelva a adherir las cubiertas de los electrodos. Si se usan Electrodo Cloth, deje que se sequen al aire.

3. Guarde el panel personal y los electrodos para la próxima sesión con este paciente.

Nota: Cuando el paciente vuelva a la clínica para una consulta de seguimiento, sujete el panel personal (con las bases de los electrodos y los electrodos conectados) al revestimiento interior de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.

Bases de electrodos

Las bases de los electrodos se utilizan para:

- Elevar los electrodos del revestimiento interno de la banda de EF de la parte inferior de la pierna para lograr un contacto óptimo de los electrodos.
- Garantizar una colocación correcta de los electrodos en cada aplicación.

Las bases de los electrodos tienen un broche para abrocharlas a los orificios de enganche de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.

Es posible usar las siguientes bases de electrodos con la banda de EF de la parte inferior de la pierna normal: (consulte la ilustración 6-6)

- Bases de electrodos de tela L300 normales (usadas con los Electrodos Regular L300 Cloth)
- Bases de electrodos de hidrogel (usadas con los Electrodos Hydrogel)



Ilustración 6-6: Opciones para las bases de electrodos de la banda de EF de la parte inferior de la pierna normal

Es posible usar las siguientes bases de electrodos con la banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña: (consulte la ilustración 6-7)

- Bases de electrodos pequeñas (usada tanto con los Electrodos Small Hydrogel como con los Electrodos Small Cloth)

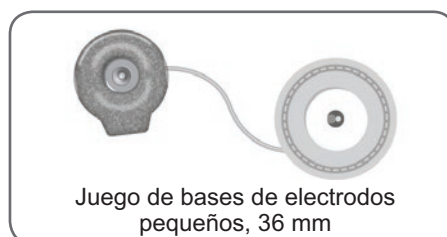


Ilustración 6-7: Opciones para las bases de electrodos de la banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña

Nota: Las bases de los electrodos son reutilizables. Limpie las bases de los electrodos con agua fría para quitar los restos de hidrogel, si corresponde. Desinfecte las bases de los electrodos con alcohol. Consulte el capítulo “Mantenimiento y limpieza” de esta guía para obtener más información.

⚠ Atención: Solo un especialista debería sustituir o reubicar las bases de los electrodos.

Electrodos

Los electrodos transmiten la señal eléctrica del EPG al nervio de destino. Se pueden usar cuatro tipos de electrodos con la banda de EF de la parte inferior de la pierna.

⚠ Atención: Los electrodos no deben usarse por más de un paciente. Los electrodos L300 Go solo deben usarse en un paciente para evitar la contaminación cruzada. Solo los Electrodos Hydrogel tienen fecha de caducidad. Antes de usarlos, compruebe que no vencen antes de dos semanas. Para solicitar todos los electrodos, póngase en contacto con su representante local o visite www.bioness.com

⚠ Atención: Utilice únicamente electrodos proporcionados por Bioness.

⚠ Atención: No utilice el sistema L300 Go sin los electrodos conectados a la banda de EF.

Es posible usar los electrodos siguientes con la banda de EF de la parte inferior de la pierna: (consulte la ilustración 6-8)

- Electrodo Quick Fit, izquierdo o derecho
- Electrodo Round Cloth, 45 mm
- Electrodo Steering, izquierdo o derecho
- Electrodos Hydrogel

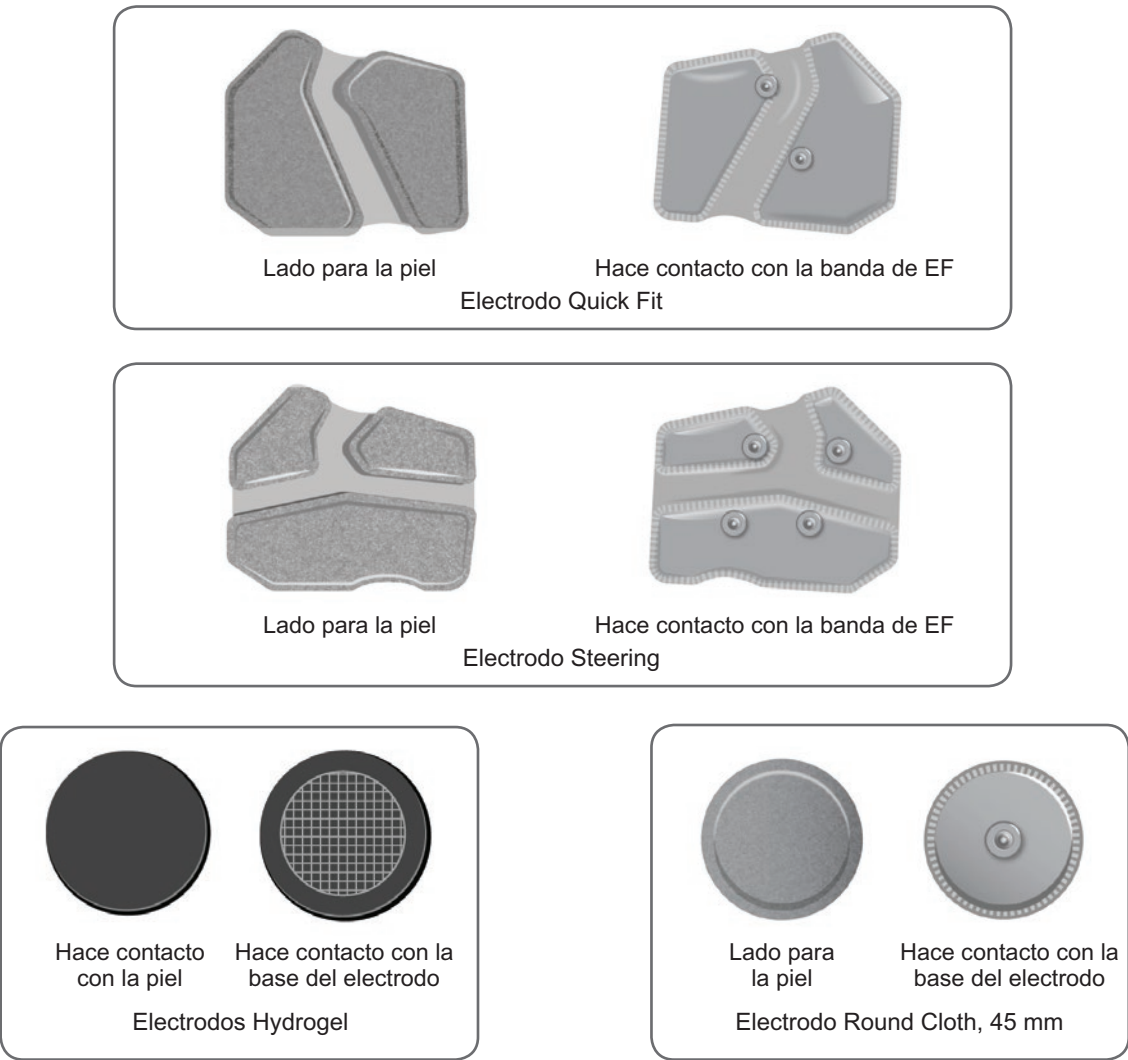


Ilustración 6-8: Opciones de electrodos de la banda de EF de la parte inferior de la pierna

Es posible usar los electrodos siguientes con la banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña:
(consulte la ilustración 6-9)

- Electrodo Small Quick Fit (A)
- Electrodo Small Quick Fit (B)
- Electrodo Small Round Cloth, 36 mm
- Small Electrodos L300 Hydrogel (solo se usan para el proceso de ajuste)

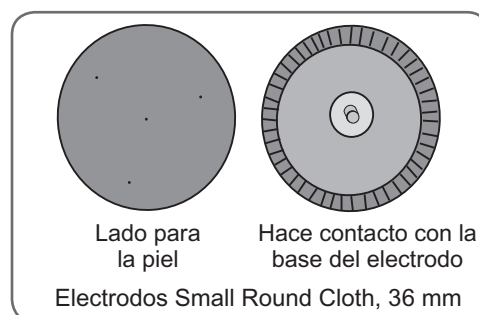
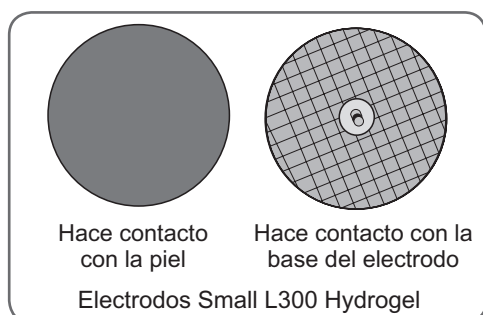
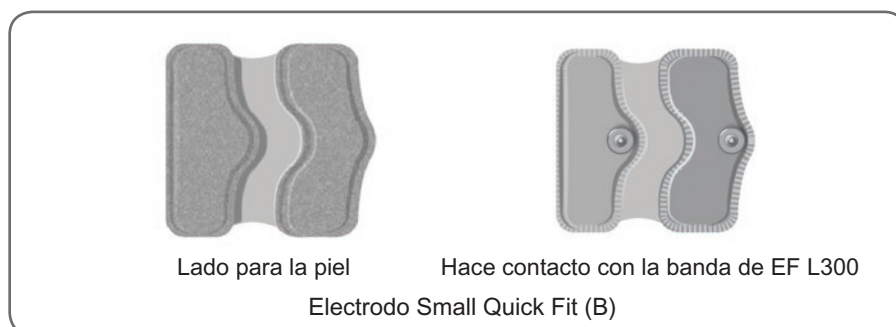
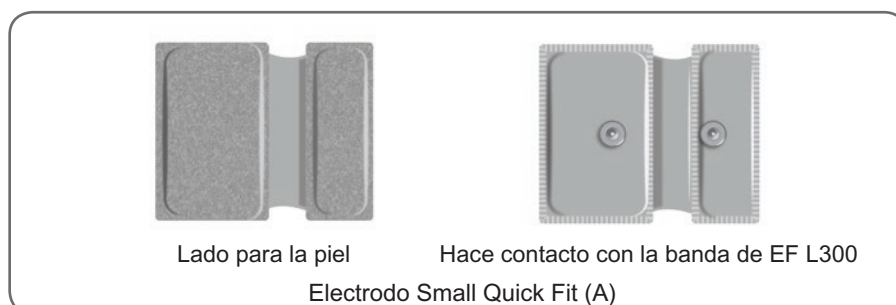


Ilustración 6-9: Opciones de electrodos de la banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña

Ocultadores de cables

Los ocultadores de cables se utilizan para cubrir los cables y los broches de las bases de los electrodos cuando están abrochados a la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Los ocultadores de cables se usan con pacientes que emplean los Electrodo Hydrogel o los Electrodo Cloth. Consulte la ilustración 6-10.

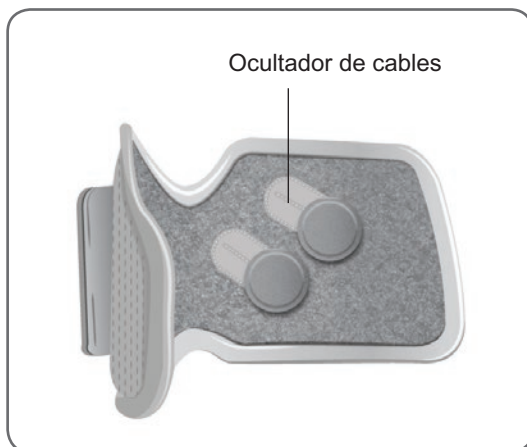


Ilustración 6-10: Banda de EF de la parte inferior de la pierna con ocultadores de cables

Cubiertas de broche

Las cubiertas de broche se usan para cerrar dos de los orificios de enganche normales de la banda de EF de la parte inferior de la pierna cuando se usa el Electrodo Quick Fit, los Electrodo Hydrogel o los Electrodo Round Cloth. Consulte la ilustración 6-11.

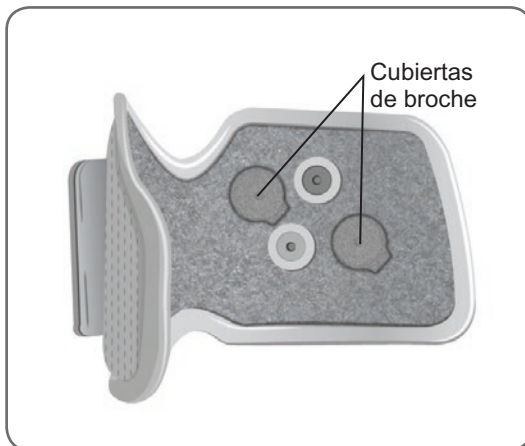


Ilustración 6-11: Cubiertas de broche sujetas a la banda de EF de la parte inferior de la pierna

Cable conector

El cable conector se utiliza para conectar eléctricamente los broches de las bases de los electrodos con los orificios de enganche de la banda de EF de la parte inferior de la pierna durante la colocación del dispositivo. Consulte la ilustración 6-12. El cable conector se usa con los Electrodo Hydrogel o Round Cloth durante la sesión de ajuste inicial.

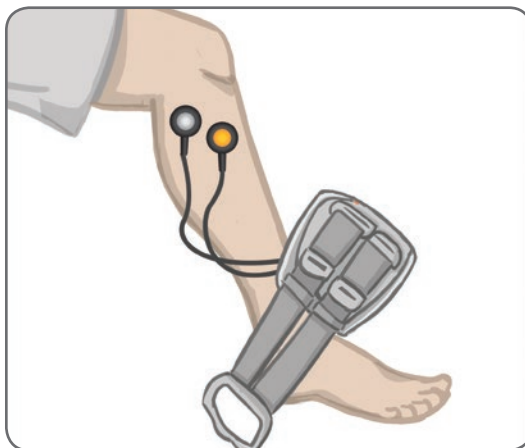


Ilustración 6-12: Cable conector sujeto a la banda de EF de la parte inferior de la pierna y las bases de los electrodos

Cubiertas de correa personal (banda de EF del muslo)

Las cubiertas de correa personal se deslizan sobre las dos correas de la banda de EF del muslo y se utilizan como una cubierta higiénica cuando varios pacientes usan la misma banda de EF del muslo.

⚠ Atención: Las cubiertas de correa personal deben usarse solo con un paciente para evitar la contaminación cruzada.

Para sujetar las cubiertas de correa personal:

1. Deslice una cubierta de correa personal sobre cada correa de la banda de EF del muslo. Consulte la ilustración 6-13.
2. Si la cubierta de correa personal es demasiado larga, córtela al tamaño adecuado.



Ilustración 6-13: Cubiertas de correa personal en la banda de EF del muslo

Electrodos Thigh

La banda de EF del muslo usa dos Electrodo Cloth para proporcionar estimulación eléctrica a los músculos de la parte superior de la pierna. Consulte la ilustración 6-14. Los Electrodo Thigh se enganchan en los paneles proximal y distal de la banda de EF del muslo.

⚠ **Atención:** Utilice únicamente electrodos proporcionados por Bioness.

⚠ **Atención:** No utilice el sistema L300 Go sin los electrodos conectados a la banda de EF del muslo.

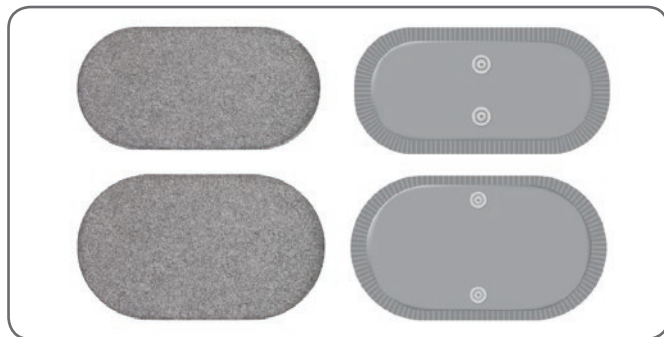


Ilustración 6-14: Electrodo Thigh

Almohadillas del sensor de pie

La almohadilla del sensor de pie se utiliza para sujetar el sensor de presión del sensor de pie al interior del zapato del paciente. La almohadilla del sensor de pie se coloca bajo la plantilla y el sensor de presión del sensor de pie se coloca encima de la almohadilla del sensor de pie. Consulte la ilustración 6-15.

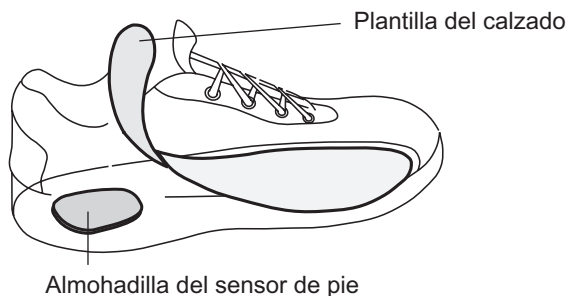


Ilustración 6-15: Colocación de la almohadilla del sensor de pie

Dispositivo de prueba

El dispositivo de prueba se usa para solucionar problemas a fin de confirmar que se está proporcionando la estimulación. Compruebe si la banda de EF de la parte inferior de la pierna, la banda de EF del muslo o el EPG se han desconectado. El dispositivo de prueba proporciona avisos de audio si está conectado a la banda de EF de la parte inferior de la pierna, la banda de EF del muslo o el EPG y se aplica estimulación. Para obtener más información sobre el dispositivo de prueba, consulte el capítulo “Solución de problemas” de esta guía.

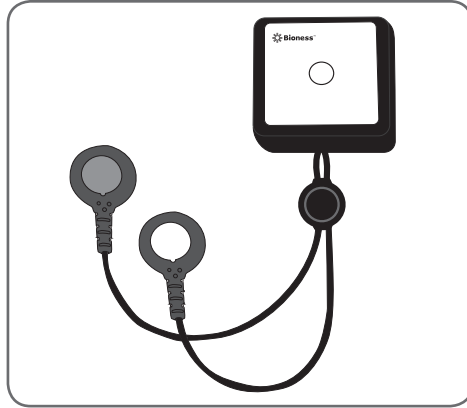


Ilustración 6-16: Dispositivo de prueba

Navegación por el software de la aplicación del especialista

La aplicación del especialista del sistema L300 emplea software registrado que permite al especialista configurar los parámetros de estimulación y los programas para el paciente. Esta aplicación usa una plataforma Tablet PC basada en Windows® y señales inalámbricas Bluetooth® de baja energía (BLE) estándar para comunicarse con el sistema L300 Go. Se usa en la clínica para la programación del paciente y también permite al especialista recuperar los registros de actividad del paciente.

La aplicación del especialista del sistema L300 incluye seis pantallas principales: la de inicio de sesión, la base de datos de pacientes, la consola del paciente, la de configuración de programación, la de informes y la de cierre de sesión.

Pantalla Iniciar sesión

La pantalla Iniciar sesión se utiliza para entrar en el software de la aplicación del especialista del sistema L300 Go. Aparece tras iniciar el software y en ella, el usuario puede introducir su nombre de usuario y su contraseña y presionar el botón Iniciar sesión. Consulte la ilustración 7-1.

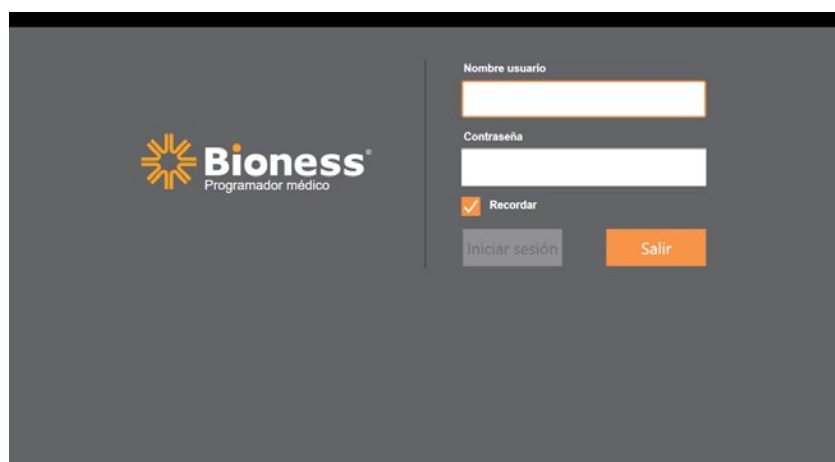


Ilustración 7-1: Pantalla Iniciar sesión


Pantalla Base de datos de pacientes

Tras la pantalla de inicio de sesión, la aplicación del especialista del sistema L300 Go muestra siempre la pantalla Base de datos de pacientes. En ella, se muestra una lista de todos los expedientes de los pacientes almacenados en la aplicación. En esta pantalla, el especialista puede buscar el expediente de un paciente, además de mover este expediente a una red para usarlo o editarlo. También se emplea para crear expedientes para pacientes nuevos.

La pantalla Base de datos de pacientes muestra cuatro iconos y un cuadro de texto de búsqueda. Consulte la ilustración 7-2.

- Icono para añadir un paciente nuevo: se usa para añadir un expediente para un nuevo paciente en la aplicación del especialista del sistema L300 Go.

- Icono para cargar pacientes: se usa para cargar el expediente de un paciente a la red de este y al EPG.
- Icono para exportar pacientes: se usa para exportar el expediente de un paciente y cargarlo en una aplicación del especialista del sistema L300 distinta.
- Icono para importar pacientes: se usa para importar el expediente de un paciente de una aplicación del especialista del sistema L300 distinta.

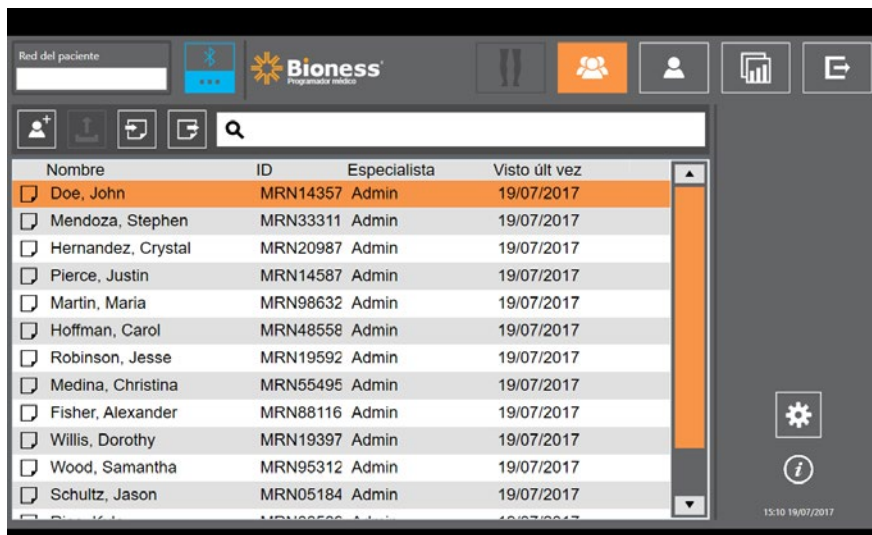

Nombre	ID	Especialista	Visto últ vez
<input checked="" type="checkbox"/> Doe, John	MRN14357	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Mendoza, Stephen	MRN33311	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Hernandez, Crystal	MRN20987	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Pierce, Justin	MRN14587	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Martin, Maria	MRN98632	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Hoffman, Carol	MRN48558	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Robinson, Jesse	MRN19592	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Medina, Christina	MRN55495	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Fisher, Alexander	MRN88116	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Willis, Dorothy	MRN19397	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Wood, Samantha	MRN95312	Admin	19/07/2017
<input type="checkbox"/> Schultz, Jason	MRN05184	Admin	19/07/2017

Ilustración 7-2: Pantalla Base de datos de pacientes

Barra de navegación

La barra de navegación se muestra en la parte superior de todas las pantallas de la aplicación del especialista del sistema L300 Go. Presenta cinco iconos de menú, el campo Red del paciente y un botón de estado del emparejamiento. Consulte la ilustración 7-3.

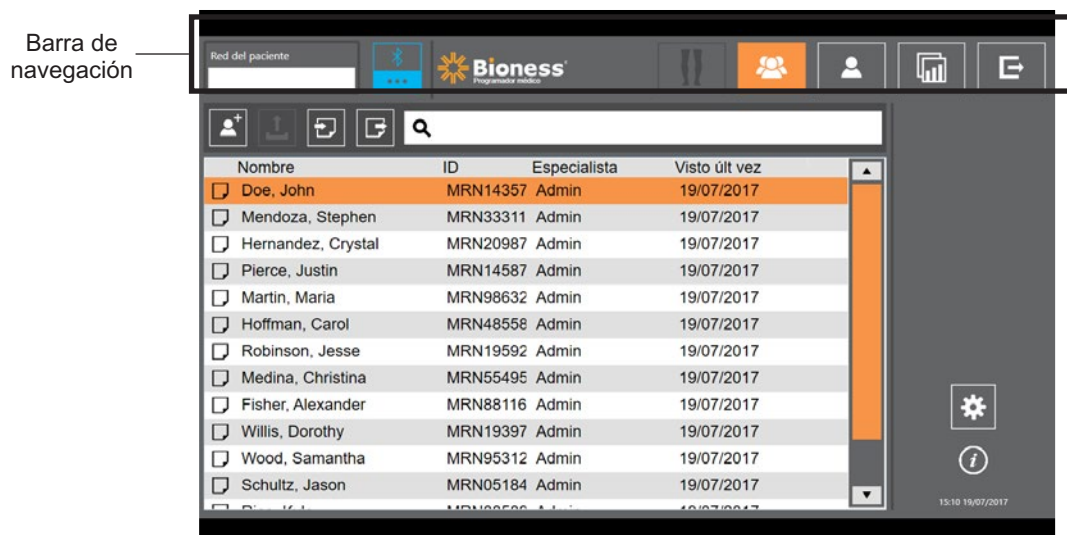


Ilustración 7-3: Barra de navegación en la pantalla de programación

Cuando la aplicación del especialista del sistema L300 Go se empareja con el sistema L300 Go de un paciente, el nombre de este se muestra en el campo Red del paciente con un contorno naranja. El icono de la pantalla activa también se muestra de color naranja. Consulte la ilustración 7-4.

Si la aplicación del especialista del sistema L300 Go no está emparejada con el sistema L300 Go de ningún paciente, el campo Red del paciente aparece vacío con un contorno azul y el icono de la pantalla activa también se muestra en azul.

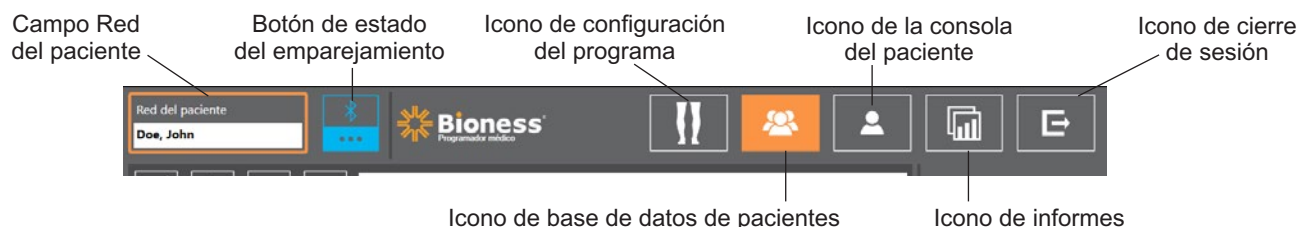


Ilustración 7-4: Barra de navegación: aplicación emparejada con el sistema de un paciente

Pantalla de configuración de la programación

A la pantalla de configuración de la programación solo se puede acceder si la aplicación del especialista del sistema L300 Go está emparejada con un sistema L300 Go y se ha cargado el expediente de un paciente en la red del paciente. El especialista usa esta pantalla para programar los parámetros de estimulación, los programas y los ajustes avanzados del sistema L300 Go de un paciente. La pantalla de configuración de la programación incluye tres pantallas de submenús: las pantallas de estimulación, marcha y entrenamiento. Consulte la ilustración 7-5.



Ilustración 7-5: Pantalla de configuración de la programación (con la pantalla de submenú de estimulación mostrada)

Pantalla de estimulación

La pantalla de estimulación se usa para programar los ajustes de estimulación del EPG seleccionado. Presione el icono de configuración avanzada (consulte la ilustración 7-6) para abrir la ventana correspondiente. Consulte la ilustración 7-6.

Si el paciente usa el Electrodo Steering, asegúrese de que el menú desplegable Electrodo muestra la opción Dirección para activar el icono de parámetros avanzados. Presione el icono de parámetro avanzado para abrir la ventana correspondiente. El especialista podrá entonces ajustar la intensidad de la estimulación central y lateral. Consulte la ilustración 7-7.



Ilustración 7-6: Pantalla de estimulación con la configuración avanzada mostrada

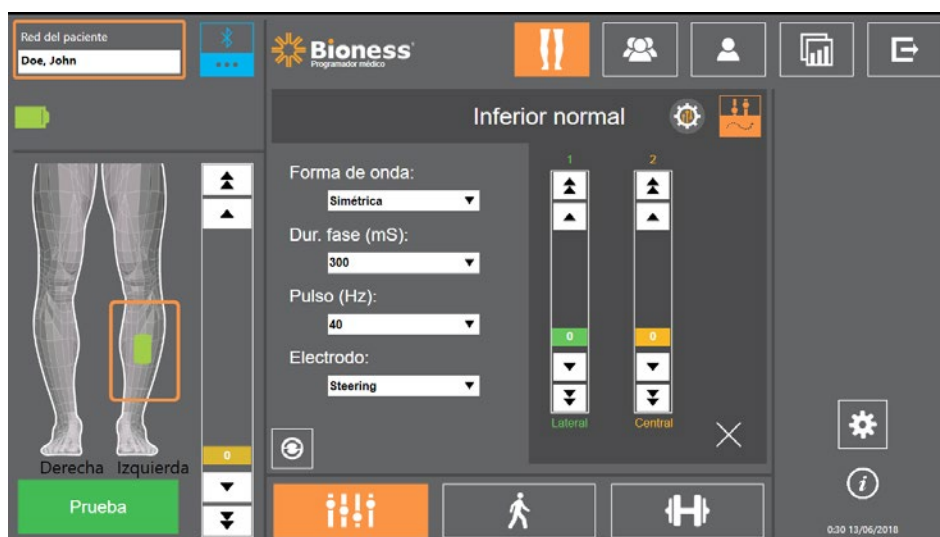


Ilustración 7-7: Pantalla de estimulación con los parámetros avanzados mostrados

Pantalla de marcha

La pantalla de marcha (consulte la ilustración 7-8) se usa para programar los ajustes del modo de marcha. También permite controlar los avisos sonoros y por vibración durante los ajustes de estimulación. Para acceder a esta pantalla, presione el icono de la pantalla de marcha, consulte la ilustración 7-5.

Pantalla de entrenamiento

La pantalla de entrenamiento (consulte la ilustración 7-9) se usa para programar los ajustes que se emplean en el modo de entrenamiento. Para acceder a esta pantalla, presione el icono de la pantalla de entrenamiento, consulte la ilustración 7-5.

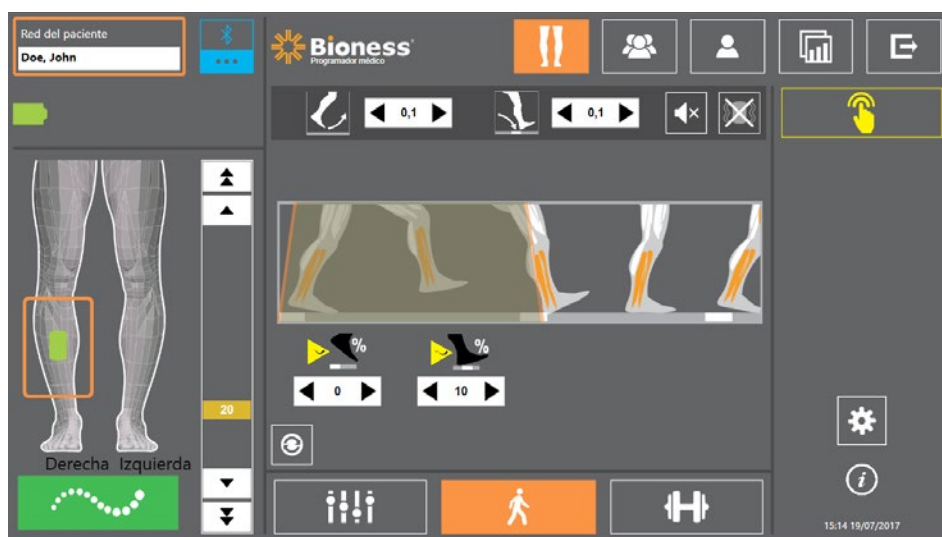


Ilustración 7-8: Pantalla de marcha



Ilustración 7-9: Pantalla de entrenamiento

Pantalla de consola del paciente

La pantalla de consola del paciente permite al especialista ver toda la información relevante sobre un paciente concreto, incluido el historial de los ajustes de la sesión, los registros de datos y las notas. Consulte la ilustración 7-10. Para acceder a esta pantalla, presione el icono de la consola del paciente situado en la barra de navegación. Consulte la ilustración 7-4.

Es posible revisar y cargar ajustes de una sesión anterior para usarlos en la actual. Presione el icono de carga para cargar los ajustes de la sesión anterior en la red del paciente.

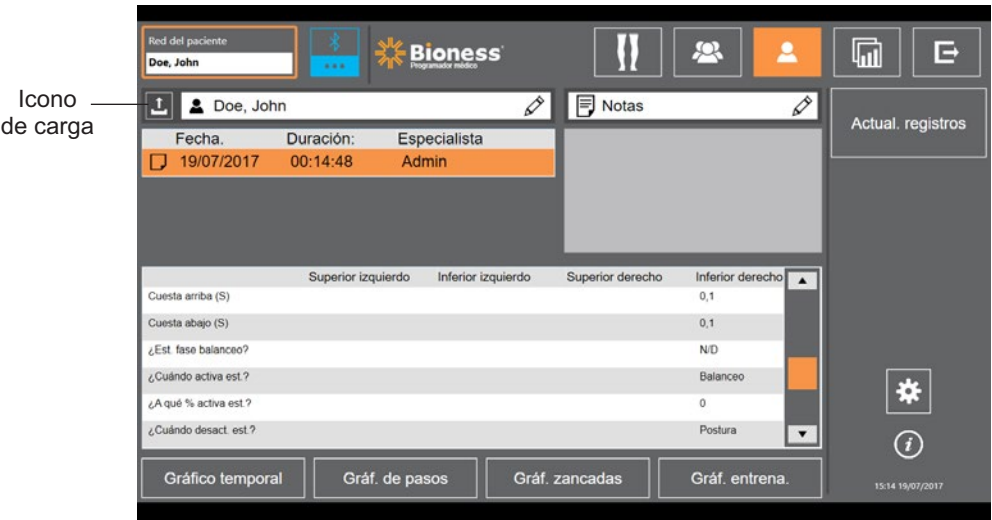


Ilustración 7-10: Pantalla de consola del paciente

Pantalla de informes

El especialista puede acceder a la pantalla de informes para ver datos anteriores y generar nuevos informes de pruebas. Consulte la ilustración 7-11. Para acceder a esta pantalla, presione el icono de informes situado en la barra de navegación. Consulte la ilustración 7-4.

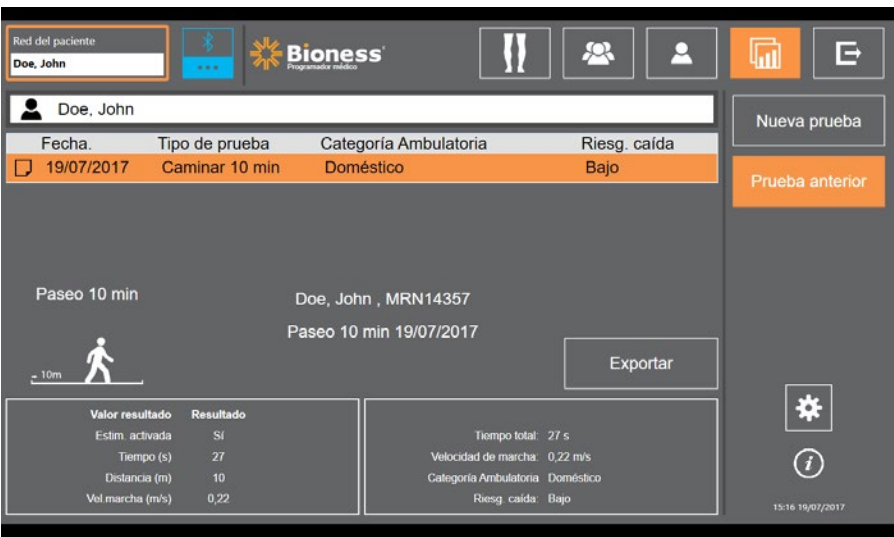


Ilustración 7-11: Pantalla de informes

Pantalla de cierre de sesión

La pantalla de cierre de sesión se usa para salir de la sesión del software de la aplicación del especialista del sistema L300 Go y cerrar esta aplicación.

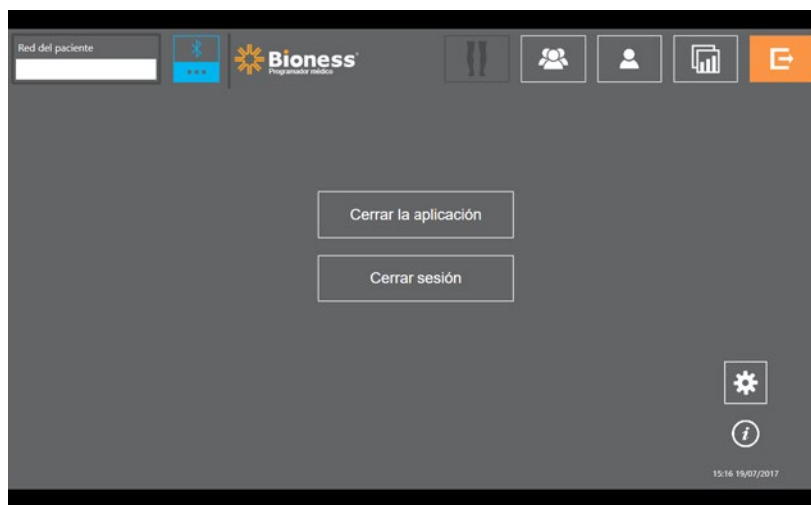


Ilustración 7-12: Pantalla de cierre de sesión

Pantalla de configuración de la aplicación

La pantalla de configuración de la aplicación, a la que se accede desde el icono disponible en el extremo derecho de todas las pantallas, se usa para ajustar la configuración, gestionar los perfiles del usuario y administrar los datos. Incluye tres pantallas de submenús. Consulte la ilustración 7-13.

- Configuración del programador: se usa para seleccionar un idioma, mostrar las versiones del software y restablecer los valores de fábrica de los EPG.
- Configuración del usuario: se usa para gestionar los perfiles de usuario (especialista), incluida la adición de nuevas cuentas de usuario, la edición de perfiles, la desactivación de cuentas de usuario y el restablecimiento de contraseñas.
- Administrar datos: se usa para cargar los datos del sistema y exportar registros del sistema del EPG.




Ilustración 7-13: Pantalla de configuración de la aplicación


Restablecimiento de los valores de fábrica del EPG

Para restablecer los valores de fábrica de un EPG, acceda a la pantalla de configuración de la aplicación y haga clic en Versiones de software para ver los botones necesarios. Siga los pasos descritos a continuación para restablecer los valores de fábrica de un EPG de una banda distinta.

Para restablecer los valores de fábrica del EPG:

1. Retire el EPG central de la banda anterior (es decir, la banda de EF de la pierna normal izquierda) y colóquela en la banda que desee (es decir, en la banda de EF de la pierna pequeña derecha).
2. Empareje la banda de EF pequeña derecha con la aplicación del especialista como si fuera una banda de la pierna izquierda y deje que se produzca la secuencia de sincronización.
3. Haga clic en el icono de ajustes de la aplicación  y seleccione Versiones de software para ver las opciones de restablecimiento de valores de fábrica. Consulte la ilustración 7-13.
4. En la sección de valores de restablecimiento de fábrica, seleccione la ubicación en la que se encontraba el EPG anteriormente. De esta forma se iniciará el restablecimiento de fábrica y la barra de estado emitirá luz intermitente roja en el EPG. Cuando termine, apague el EPG y vuelva a encenderlo. Reconocerá su nueva ubicación.

Pantalla de información

A la pantalla de información se accede mediante el icono correspondiente , disponible en el extremo derecho de todas las pantallas, justo debajo del icono de configuración de la aplicación. Proporciona datos sobre las características disponibles en las pantallas de la aplicación del especialista del sistema L300 Go. Esta pantalla es dinámica, ya que la información mostrada depende de la pantalla desde la que se acceda.

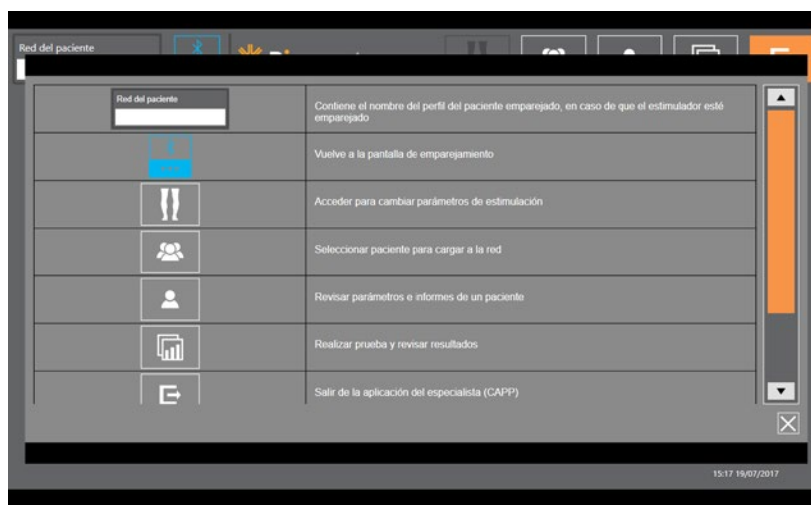


Ilustración 7-14: Pantalla de información

Preparación del paciente

Preparación de la piel

Antes de ajustar la banda de EF de la parte inferior de la pierna o la banda de EF del muslo en un paciente, compruebe siempre que no haya signos de irritación en la piel. Si hay irritación, espere a que la piel se recupere por completo antes de usar el sistema L300 Go. Para recibir una estimulación óptima, la piel bajo la banda de EF debe estar limpia y sana.

Para preparar la piel:

1. Use un paño húmedo para limpiar la piel en la zona donde se vayan a colocar los electrodos. Si hay aceites o lociones en la piel, límpiela con agua y jabón. Enjuague bien.
2. Si fuera necesario, recorte el vello corporal excesivo de esta zona con unas tijeras. No utilice hojas de afeitar. Las hojas de afeitar pueden irritar la piel.

Adhesión de los Electroodos Hydrogel a las bases de los electrodos

Para los primeros ajustes, use siempre Electroodos Hydrogel antes de preparar los Electroodos Cloth.

⚠ Atención: Los Electroodos Hydrogel no deben usarse por más de un paciente. Los electrodos solo deben usarse en un paciente para evitar la contaminación cruzada.

Para adherir los Electroodos Hydrogel a la pierna:

1. Asegúrese de que el EPG de la parte inferior de la pierna está apagado.
2. Separe los dos Electroodos Hydrogel nuevos por la línea perforada. Consulte la ilustración 8-1.
3. Desprenda las cubiertas de dos piezas en cada electrodo y deséchelas. Consulte la ilustración 8-1.

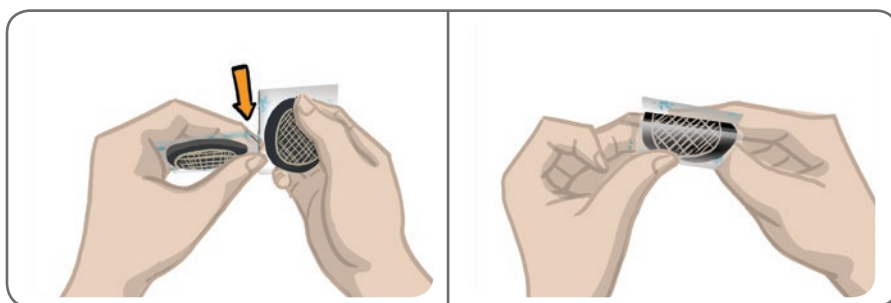


Ilustración 8-1: Separación de los Electroodos Hydrogel y división de las cubiertas de dos partes

4. En el caso de los pacientes que usen la banda de EF de la parte inferior de la pierna, sujete el lado de la rejilla de los electrodos a las bases de los electrodos de hidrogel y presione con firmeza.
5. En el caso de los pacientes que usen la banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña, sujete el lado del broche de los electrodos en las bases de los electrodos pequeños.
6. Extraiga las cubiertas más grandes (las que tienen el logotipo de Bioness) de los electrodos y guárdelas. (Entre uno y otro uso, cubra siempre los Electroodos Hydrogel. Asegúrese de que el logotipo de Bioness de la cubierta esté orientado hacia arriba).

7. Haga que el paciente se sienta y extienda la pierna a un ángulo de entre 15 y 20 grados de la flexión de la pierna al sentarse. (El paciente deberá mantener esta postura durante todo el proceso de preparación). De ser posible, el talón debería permanecer elevado.
8. Coloque un electrodo (el electrodo del nervio) sobre el nervio peroneo común, en una posición distal y levemente posterior con respecto a la cabeza del peroné. Consulte la ilustración 8-2.
9. Coloque el otro electrodo (el electrodo del músculo) en una posición anterior con respecto al electrodo del nervio y a aproximadamente 5 cm (2 pulg.) de distancia del mismo, sobre el vientre muscular del músculo tibial anterior.

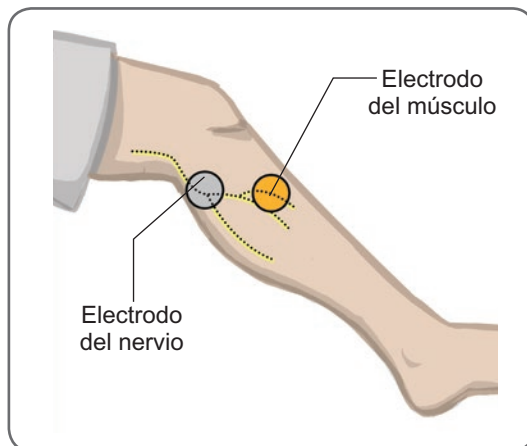


Ilustración 8-2: Colocación de los electrodos en la pierna.

Nota: Los Electrodos Hydrogel pequeños sirven exclusivamente para la preparación, no para el uso doméstico del paciente.

Conexión del cable conector

Para conectar el cable conector:

1. Asegúrese de que el EPG esté sujeto al estuche del EPG en la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
2. Conecte el cable conector a las bases de los electrodos y a los orificios de enganche de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
3. Conecte los extremos naranjas del cable conector a la base del electrodo del músculo y el orificio de enganche naranja de la banda de EF. Consulte la ilustración 8-4.

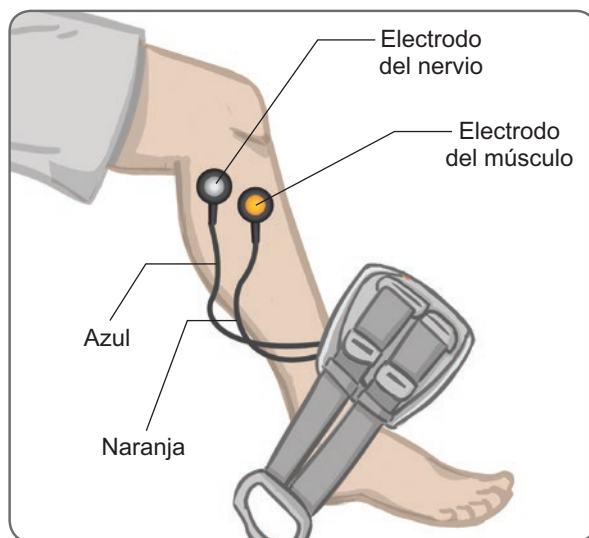


Ilustración 8-4: Cable conector conectado

4. Conecte los extremos azules del cable conector a la base del electrodo del nervio y al orificio de enganche azul de la banda de EF. Consulte la ilustración 8-4.
5. Coloque la banda de EF de la parte inferior de la pierna junto al pie del paciente. Consulte la ilustración 8-4.

Configuración lista para usar

La configuración lista para usar son parámetros predeterminados que se han programado en el EPG para la preparación del paciente. En el caso de pacientes nuevos, el especialista puede activar la configuración lista para usar manteniendo presionados durante cinco segundos los botones de estimulación y modo en la unidad de control. Si se desea, estos parámetros predeterminados se pueden usar como ajustes para el sistema L300 Go del paciente. Para salir del modo listo para usar, presione el botón de selección. Si se prefieren usar parámetros distintos, el especialista deberá acceder al software de la aplicación del especialista del sistema L300 Go para programarlos.

Nota: El nivel de intensidad de la estimulación predeterminado es 0.

Ajuste de la posición de los electrodos al estimular: paciente sentado

Para comprobar la posición de los electrodos:

1. En el caso de los pacientes nuevos, mantenga presionados durante cinco segundos los botones de estimulación y modo del EPG para activar los parámetros predeterminados.
2. El nivel de intensidad de la estimulación predeterminado es 0. Presione el botón de estimulación del EPG para activar la estimulación.

Nota: Al aplicar la estimulación, observe el pie del paciente para comprobar que se produce una dorsiflexión apropiada.

1. Presione el botón más del EPG para aumentar gradualmente la intensidad de la estimulación a fin de lograr la dorsiflexión con una pequeña cantidad de pronación.
2. **Si se produce una supinación excesiva:** Mueva el electrodo del nervio lateralmente hacia la parte posterior para aumentar la pronación.
3. **Si se produce una pronación excesiva:** Mueva el electrodo del nervio levemente hacia la parte anterior para reducir la pronación.

El electrodo del músculo también se puede mover para equilibrar la dorsiflexión. Desplace el electrodo del músculo hacia la parte anterior para reducir la pronación del pie o lateralmente hacia la parte posterior para aumentar la pronación. Evite estimular la zona que se encuentra directamente encima del cuerpo de la tibia, ya que puede resultar incómodo y menos eficaz.

Prueba de los efectos de un cambio de posición

1. Para probar el efecto del cambio de posición, mueva suavemente el electrodo y la piel juntos sobre la zona del nervio peroneo común. (No deje la estimulación encendida mucho tiempo, ya que puede provocar fatiga).

Nota: Durante la prueba, presione suavemente las bases de los electrodos para simular la presión de la banda de EF.

Ajuste la posición de los electrodos al estimular: paciente de pie

De ser posible, una vez que logre producir una dorsiflexión apropiada con el paciente sentado, vuelva a probar con el paciente de pie, con la rodilla extendida y el pie en el aire. En caso necesario, ajuste la estimulación o la posición de los electrodos para lograr una dorsiflexión apropiada en esta posición.

Transferencia de los electrodos a la banda de EF de la parte inferior de la pierna

Para transferir los electrodos a la banda de EF de la parte inferior de la pierna:

1. Presione el botón de estimulación en los EPG para detener la estimulación.
2. Utilice un rotulador para dibujar cuatro marcas de referencia pequeñas equidistantes en la pierna del paciente, alrededor de las bases de los electrodos.
3. Desconecte el cable conector de las bases de los electrodos y de la banda de EF de la parte inferior de la pierna, asegurándose de no mover los electrodos.
4. Para los pacientes hospitalizados, adhiera el panel personal y la cubierta de la correa de la banda de EF a la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
5. Sujete los dos lados de la banda de EF de la parte inferior de la pierna para mantener la órtesis ligeramente abierta. Después incline la parte inferior de la banda de EF separándola de la pierna unos 30 grados.
6. Coloque el localizador de la banda de EF de la parte inferior de la pierna debajo de la rótula, sobre la meseta tibial. Consulte la ilustración 8-5. Asegúrese de que la banda de EF no toca las bases de los electrodos. El localizador debería quedar cómodamente ajustado bajo el polo inferior de la rótula.

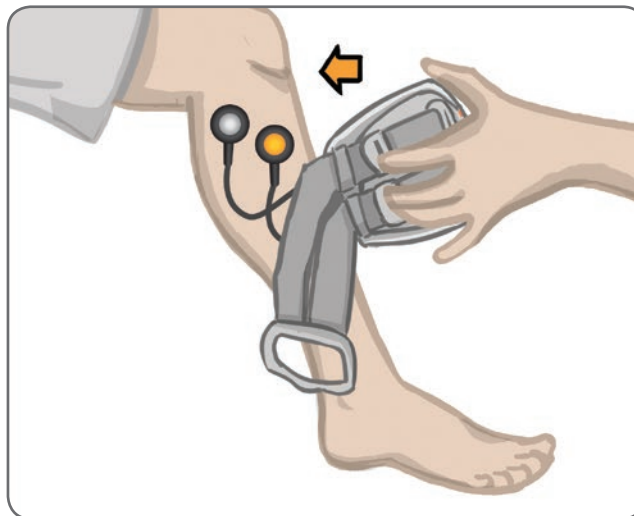


Ilustración 8-5: Colocación del localizador debajo de la rótula

7. Mientras mantiene abierta la banda de EF de la parte inferior de la pierna, haga descender la parte inferior de la banda de EF de manera que solo el frente de la banda de EF haga contacto con la superficie anterior de la tibia. Después, envuelva la pierna con la banda de EF de la parte inferior de la pierna para “capturar” las bases de los electrodos. Consulte la ilustración 8-6.
8. Retire con cuidado la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Consulte la ilustración 8-7.
9. Presione firmemente las bases de los electrodos para sujetarlas bien a la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Enganche los broches de las bases de los electrodos en los orificios de enganche de la banda de EF.

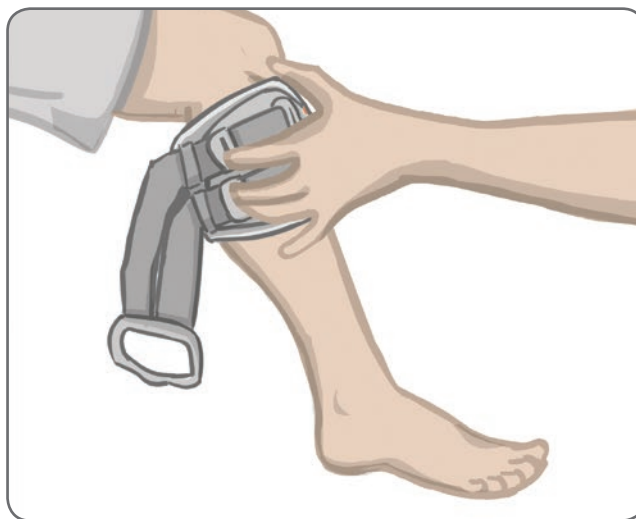


Ilustración 8-6: Captura de las bases de los electrodos

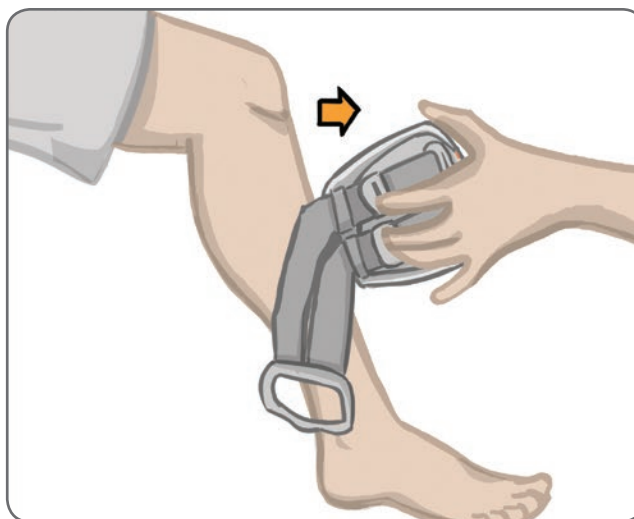


Ilustración 8-7: Retirada de la banda de EF de la parte inferior de la pierna con las bases de los electrodos enganchadas

Colocación de la banda de EF de la parte inferior de la pierna

Para colocar la banda de EF de la parte inferior de la pierna

1. Limpie la pierna con agua tibia.
2. Haga que el paciente se sienta y extienda la rodilla de manera que la rótula pueda verse claramente definida. De ser necesario, use un apoyo para el pie.
3. Inclíne la parte superior de la banda de EF de la parte inferior de la pierna en dirección a esta. Deslice el localizador suavemente hacia arriba hasta la base de la rótula. Haga descender la parte inferior de la banda de EF hasta que quede apoyada sobre la pierna de manera nivelada. La banda de EF de la parte inferior de la pierna debe apretar suavemente esta.
4. Tire de la agarradera de la correa alrededor de la pierna y del estuche de la banda de EF de la parte inferior de la pierna para que la banda quede bien sujeta.
5. Asegúrese de que, una vez sujeta, la banda de EF queda cómodamente colocada con el localizador bajo la rótula y la agarradera de la correa alrededor del estuche, como muestra la ilustración 8-8.



Ilustración 8-8: Banda de EF de la parte inferior de la pierna en la pierna derecha

Nueva prueba de la colocación de los electrodos: paciente sentado y de pie

Para volver a probar la colocación de los electrodos:

1. Presione el botón de encendido del EPG de la parte inferior de la pierna. El EPG vibra y emite un aviso sonoro cuando está encendido.
2. Mantenga presionado el botón de estimulación del EPG de la parte inferior de la pierna al menos durante cinco segundos. El EPG proporciona estimulación hasta que se suelta el botón de estimulación.
3. Si la respuesta del paciente no es adecuada o no coincide con la respuesta original, recoloque la banda de EF de la parte inferior de la pierna y evalúe la respuesta a la estimulación.

Ajuste de los Electrodo Small Round Cloth

Nota: Los Electrodo Hydrogel pequeños se usan únicamente en el proceso de preparación inicial. Después de determinar la posición de los electrodos, los Electrodo Small Hydrogel se deben retirar y sustituirse por los Electrodo Small Round Cloth.

Para ajustar los Electrodo Small Round Cloth: (consulte la ilustración 8-9).

1. Asegúrese de que el EPG está apagado y retire la banda de EF pequeña de la pierna del paciente.
2. Separe con cuidado los Electrodo Small Hydrogel de las bases de los electrodos pequeñas. Tenga cuidado de no desconectar las bases de los electrodos de la banda de EF pequeña.
3. Saque los Electrodo Small Round Cloth del paquete.
4. Humedezca los nuevos Electrodo Small Round Cloth con agua hasta que estén empapados.
5. Utilice un paño suave y limpie o seque con cuidado el exceso de agua del reverso (lado del broche) de los electrodos.
6. Abroche los Electrodo Small Round Cloth a las bases de los electrodos pequeñas.
7. Coloque la banda de EF de la parte inferior de la pierna y compruebe que se produce la respuesta de dorsiflexión deseada. En caso necesario, ajuste los parámetros de estimulación y la posición de los Electrodo Cloth.

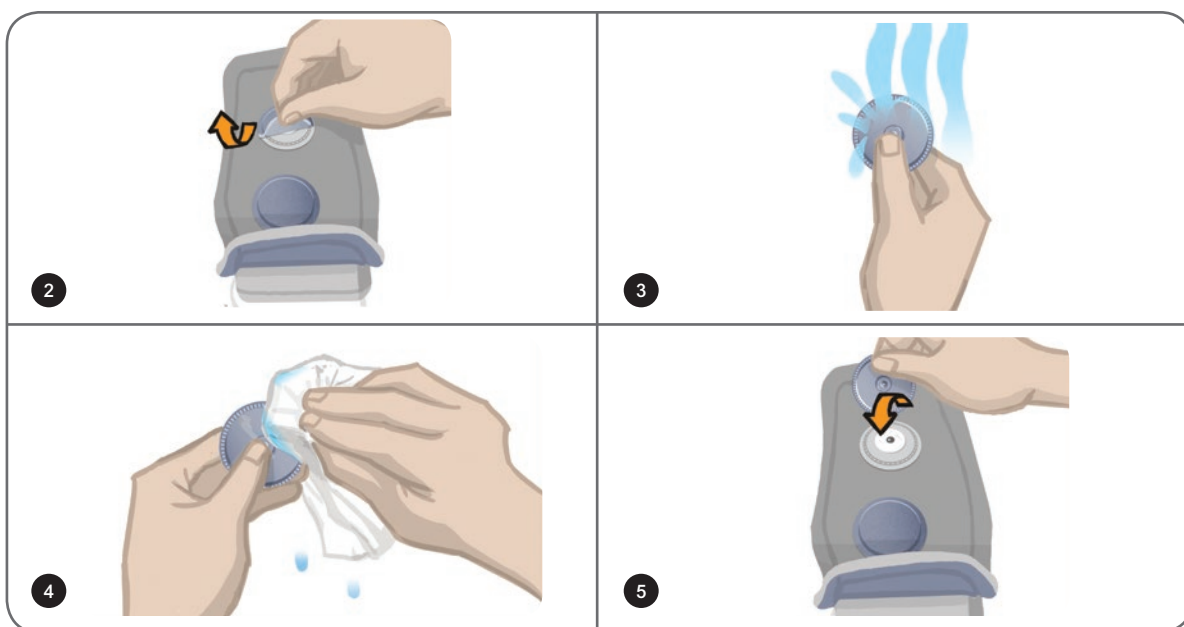


Ilustración 8-9: Ajuste de los Electrodos Small Round Cloth

Ajuste de los Electrodos Round Cloth

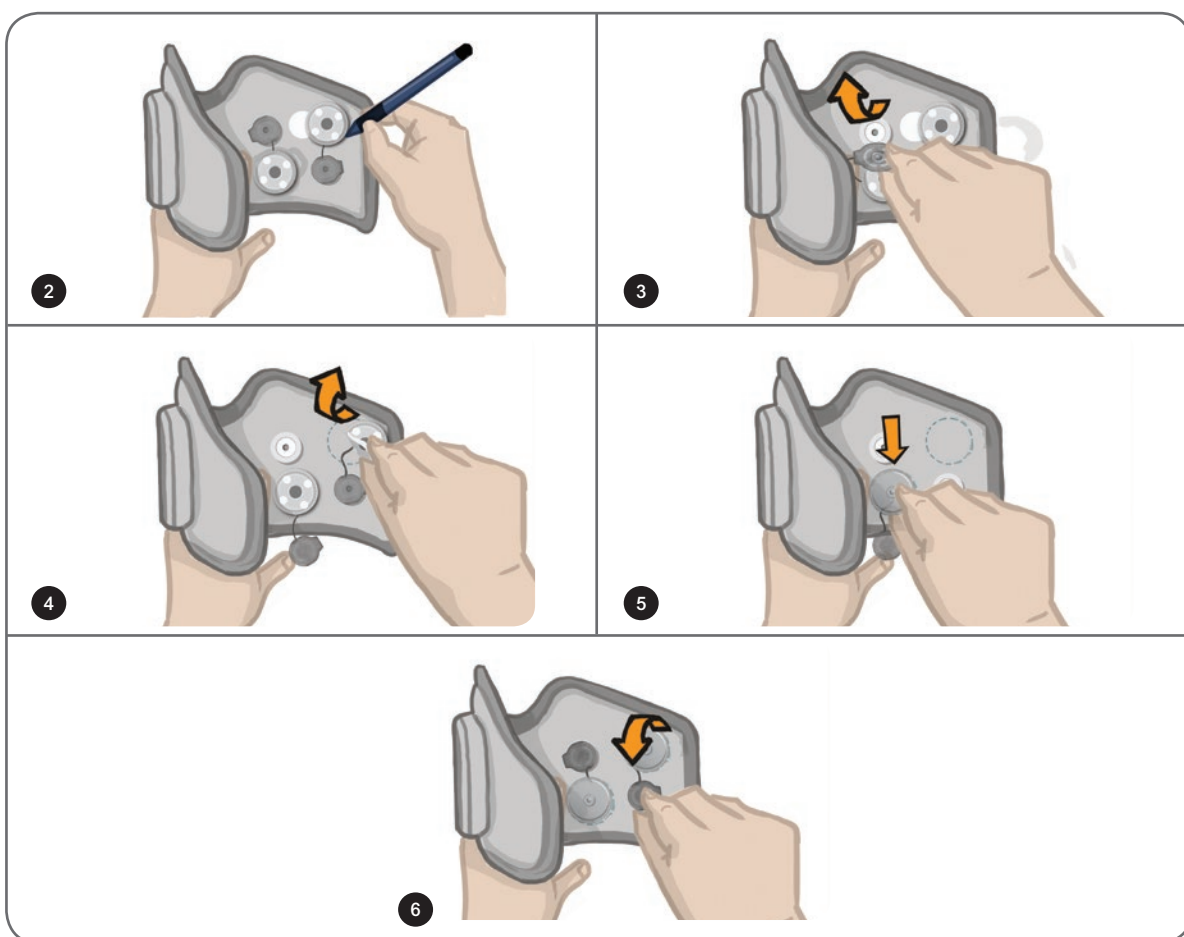


Ilustración 8-10: Ajuste de las bases de los electrodos de tela redondos

Para ajustar las bases de los electrodos de tela redondos: (consulte la ilustración 8-10).

1. Asegúrese de que el EPG está apagado y retire la banda de EF de la parte inferior de la pierna de la extremidad del paciente.
2. Marque la posición de las bases de los electrodos de hidrogel en el revestimiento de la banda de EF.
3. Desconecte el broche de las bases de los electrodos de hidrogel de los orificios de enganche de la banda de EF.
4. Extraiga las bases de los electrodos de hidrogel.
5. Adhiera las bases de los electrodos de tela donde estaban adheridas las bases de los electrodos de hidrogel.

Nota: La base de un electrodo de tela es 2 mm más pequeña en altura que la base de un electrodo de hidrogel.

6. Conecte los broches de las bases de los electrodos de tela a los orificios de enganche de la banda de EF.

Para ajustar los Electrodo Round Cloth: (consulte la ilustración 8-11).

1. Humedezca los nuevos Electrodo Round Cloth con agua hasta que estén empapados.
2. Utilice un paño suave y limpie o seque con cuidado el exceso de agua del reverso (lado del broche) de los Electrodo Cloth.
3. Sujete los Electrodo Cloth a las bases de los electrodos de tela en la banda de EF normal.
4. Coloque la banda de EF de la parte inferior de la pierna y compruebe que se produce la respuesta de dorsiflexión deseada. En caso necesario, mejore al máximo los parámetros de estimulación y la posición de los Electrodo Cloth.

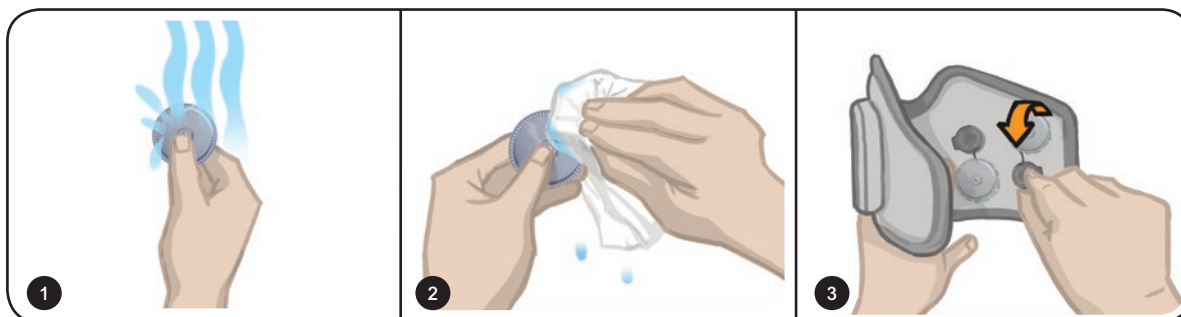


Ilustración 8-11: Ajuste de los Electrodo Round Cloth

Ajuste de los Electrodo Quick Fit

La banda de EF de la parte inferior de la pierna puede usar un tipo de Electrodo Quick Fit, que está disponible en distintas configuraciones para la parte inferior de la pierna izquierda y la derecha. La banda de EF de la parte inferior de la pierna pequeña puede usar dos tipos de Electrodo Quick Fit: el Electrodo Small Quick Fit (A) o el Electrodo Small Quick Fit (B).

Para seleccionar un Electrodo Small L300 Quick Fit:

1. Mida la circunferencia de la pierna del paciente en el lugar más ancho (el vientre muscular del gastrocnemio) y consulte la tabla 8-1.

Nota: Los pacientes con una circunferencia de pantorrilla mediana (24 a 25 cm) pueden utilizar ambos tipos de Electrodo Small L300 Quick Fit.

Electrodo Small Quick Fit	Circunferencia de la pantorrilla
Electrodo Small Quick Fit (A)	24 a 31 cm
Electrodo Small Quick Fit (B)	22 a 25 cm

Tabla 8-1: Gráfico de ajuste del Electrodo Small L300 Quick Fit

Para ajustar el Electrodo Quick Fit: **(consulte la ilustración 8-12)**

1. Asegúrese de que el EPG está apagado y retire la banda de EF de la parte inferior de la pierna de la extremidad del paciente.
2. Empape con agua el nuevo Electrodo Quick Fit su totalidad.
3. Escurra el agua sobrante del Electrodo Quick Fit con un trapo.
4. Alinee los broches naranja y azul del Electrodo Quick Fit con los orificios naranja y azul de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
5. Apriete con firmeza para encajar el Electrodo Quick Fit en la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
6. Colocación de la banda de EF de la parte inferior de la pierna
7. Ajuste los parámetros de estimulación para conseguir la respuesta de dorsiflexión deseada.

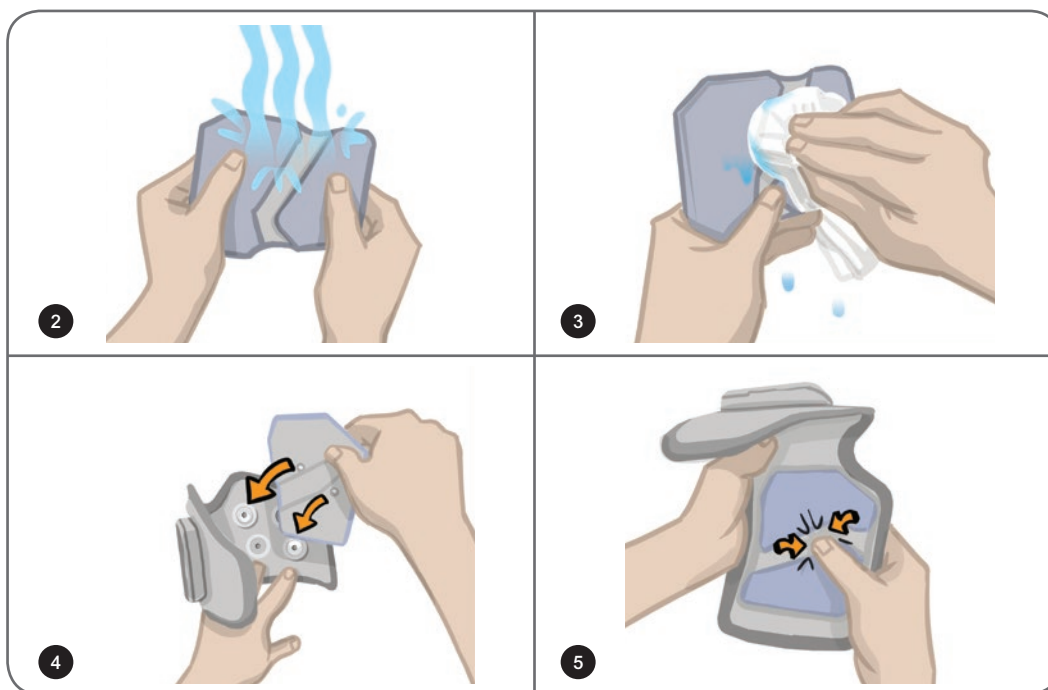


Ilustración 8-12: Ajuste del Electrodo Quick Fit
(se muestran el Electrodo Quick Fit y la banda de EF L300)

Ajuste del Electrodo Steering

El Electrodo Steering se usa con la banda de EF de la parte inferior de la pierna y permite al especialista ajustar la intensidad de la estimulación central y lateral.

Para ajustar el Electrodo Steering: (consulte la ilustración 8-13)

1. Asegúrese de que el EPG está apagado y retire la banda de EF de la pierna normal de la extremidad del paciente.
2. Empape con agua el Electrodo Steering en su totalidad.
3. Escurra el agua sobrante del Electrodo Steering con un trapo.
4. Alinee los broches del Electrodo Steering con los orificios de enganche de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
5. Apriete con firmeza para encajar el Electrodo Steering en la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Asegúrese de presionar los cuatro broches.
6. Colocación de la banda de EF de la parte inferior de la pierna
7. Ajuste los parámetros de estimulación para conseguir la respuesta de dorsiflexión deseada.

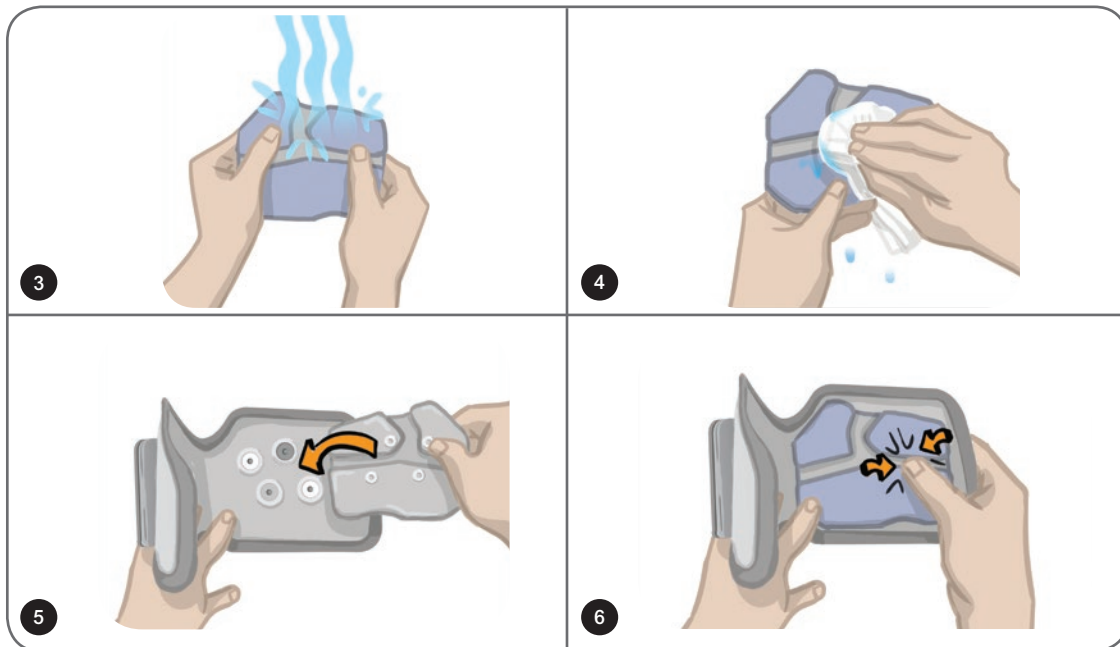


Ilustración 8-13: Ajuste del Electrodo Steering

Ajuste del sensor de pie

El sensor de pie es un componente opcional del sistema L300 Go. El especialista es el encargado de determinar si es necesario un sensor de pie según la presentación del paciente. En el caso de los pacientes que usen el sistema L300 Go Thigh Stand-Alone, el sensor pie es un componente obligatorio.

⚠ Atención: El uso del sensor de pie no ha sido homologado para individuos cuyo peso sea superior a los 136 kilogramos (300 libras).

⚠ Atención: No utilice el sensor de pie con una plantilla rígida, como las órtesis rígidas hechas a medida o las órtesis de tobillo y pie.

La posición del sensor de pie se puede ajustar según el punto de contacto inicial del paciente. En la mayoría de los pacientes, el sensor de pie se debe colocar en el talón. En el caso de los pacientes cuyo punto de contacto inicial con el suelo se produzca cerca de los dedos, el sensor de pie se puede colocar en el antepié.

Nota: La almohadilla del sensor de pie y el sensor de presión del sensor de pie deben colocarse debajo de la plantilla del zapato. Si el calzado no tiene una plantilla extraíble, ubique la almohadilla del sensor de pie y el sensor de presión por encima de la plantilla. Luego, coloque una plantilla genérica suave y delgada (de una sola capa, no de dos capas) encima de los sensores.

Para colocar el sensor de pie en el zapato:

1. En el caso de los pacientes nuevos, el sensor de pie debe emparejarse con su EPG de la parte inferior de la pierna. Para los pacientes que usan el sistema L300 Go Thigh Stand-Alone, el sensor de pie debe emparejarse con su EPG del muslo. Si necesita instrucciones sobre el emparejamiento, consulte la sección “Emparejamiento de un sensor de pie nuevo con el EPG” de esta guía.
2. Determine la posición adecuada (en el talón o en el antepié) del sensor de pie según la presentación del paciente.
3. Levante la plantilla del zapato y adhiera una almohadilla del sensor de pie al talón o al antepié del zapato.
4. Para determinar la posición del talón, dirija el cable del sensor de pie hacia la punta del calzado. Para determinar la posición del antepié, dirija el cable del sensor de pie hacia el talón del calzado. A continuación, sujete el sensor de presión a la almohadilla del sensor de pie. Consulte la ilustración 8-14.

Nota: La imagen del pie situada en el sensor de pie está invertida cuando se encuentra en la posición del antepié.

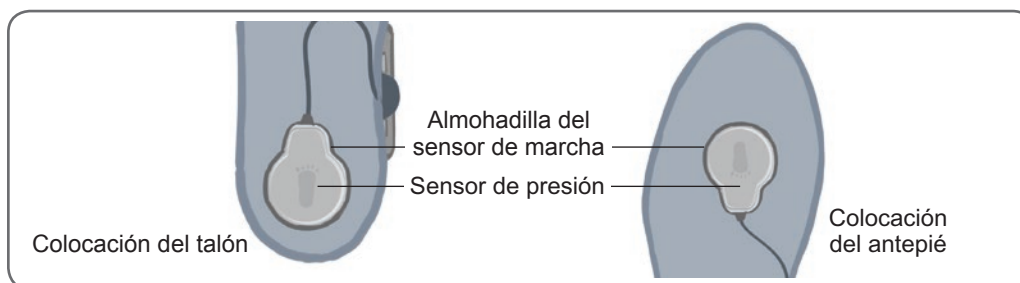


Ilustración 8-14: Colocación del sensor de pie en el calzado

5. Sujete la pinza del transmisor del sensor de pie en el borde interno del calzado. El logotipo de la estrella del transmisor debe quedar mirando en dirección opuesta al tobillo. Consulte la ilustración 8-15.
6. Cubra el sensor de presión con la plantilla. Si sobresale una parte del cable, pliéguelo y métalo debajo de la plantilla. Consulte la ilustración 8-15.

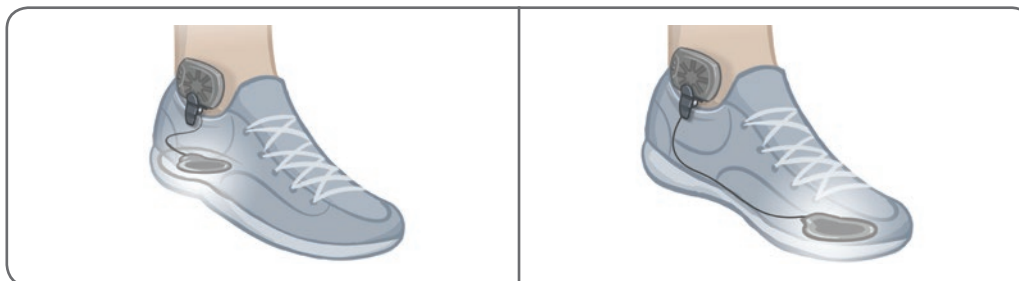


Ilustración 8-15: Posición final del sensor de pie sujeto al calzado

Retirada de la banda de EF de la parte inferior de la pierna

Para retirar la banda de EF de la parte inferior de la pierna:

1. Presione el botón de encendido del EPG para apagar el sistema.
2. Con un rotulador, marque la ubicación del localizador de la banda de EF en la parte inferior de la pierna como referencia.
3. Desenganche la agarradera de la correa de la banda de EF del estuche del EPG y levante lentamente la banda de EF de la parte inferior de la pierna, separándola de la piel.

Nota: En el caso de los pacientes que usen los Electrodo Hydrogel con la banda de EF de la parte inferior de la pierna, despegue con cuidado los electrodos de la piel y vuelva a colocar las cubiertas de los electrodos.

4. Con un rotulador, haga marcas pequeñas equidistantes unas de otras alrededor de las bases de los electrodos en el revestimiento de la banda de EF de la parte inferior de la pierna (o en el panel personal) para usarlas como referencia.
5. Si corresponde, cubra los broches y los cables de las bases de los electrodos con los ocultadores de cables. Asegúrese de que los cables están metidos debajo de los ocultadores de cables.

Nota: Asegúrese de indicar a los pacientes que vayan a utilizar el sistema L300 Go en casa que ventilen la piel retirando la banda de EF de la parte inferior de la pierna al menos durante 15 minutos cada tres o cuatro horas.

Ajuste de los Electrodo Thigh Cloth

Los Electrodo Thigh Cloth se sujetan a los broches de los paneles de la banda de EF del muslo. El Electrodo Thigh Cloth más grande se sujeta al panel proximal de la banda de EF del muslo. El más pequeño se sujeta al panel distal. Consulte la ilustración 8-16.

⚠ Atención: Los Electrodo Thigh Cloth no deben usarse por más de un paciente. Los Electrodo Thigh Cloth solo deben usarse en un paciente para evitar la contaminación cruzada.

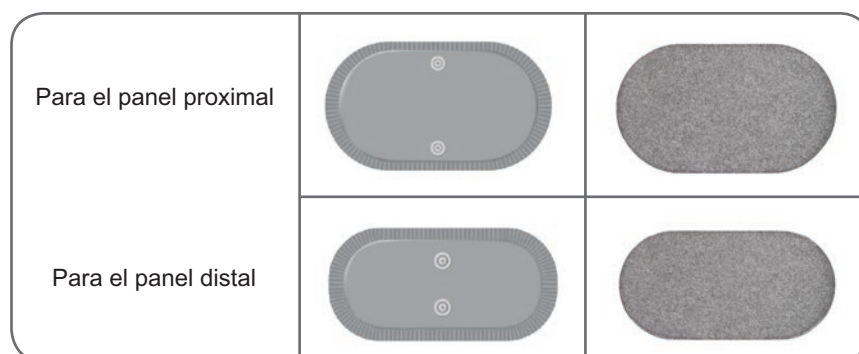


Ilustración 8-16: Electrodo Thigh Cloth

Para ajustar los Electrodo Thigh Cloth: (consulte la ilustración 8-17)

1. Asegúrese de que el EPG del muslo está apagado.
2. Moje los Electrodo Thigh con agua corriente. Junte y presione con cuidado los Electrodo Thigh.
3. Escurra el agua sobrante del lado de enganche de los Electrodo Thigh con un trapo.
4. Alinee los broches de los Electrodo Thigh Cloth con los orificios de enganche de la banda de EF del muslo.
5. Presione con firmeza para abrochar los Electrodo Thigh Cloth a los paneles proximal y distal de la banda de EF del muslo.

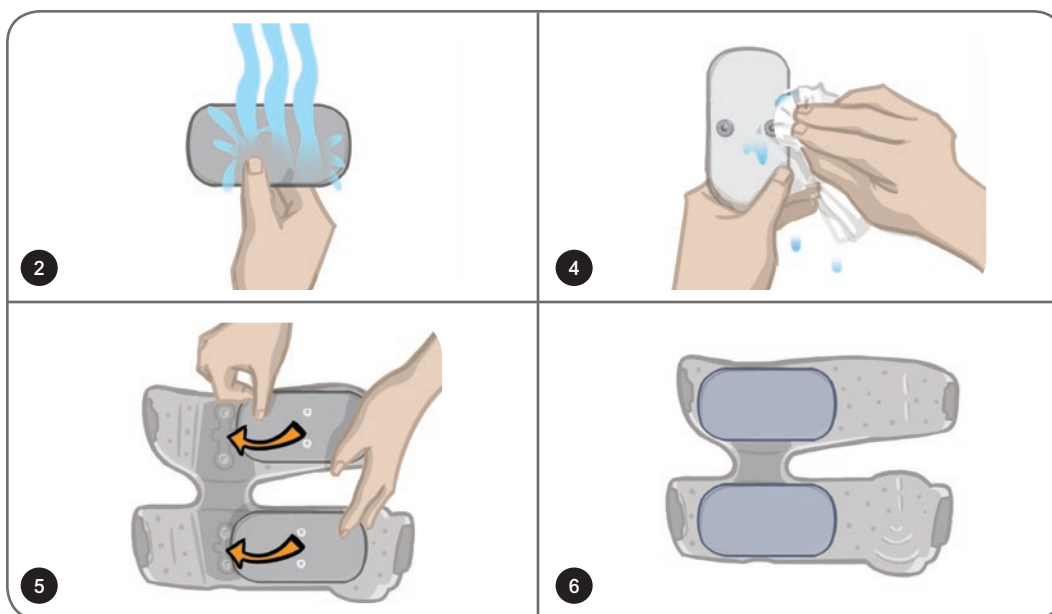


Ilustración 8-17: Ajuste de los Electrodos Thigh Cloth

Colocación de la banda de EF del muslo

Para colocar la banda de EF del muslo:

1. Pida al paciente que se siente en una posición estable en el borde de una silla.
2. Asegúrese de que los Electrodos Thigh Cloth están sujetos de forma segura a los paneles de la banda de EF del muslo.
3. Para los pacientes hospitalizados, sujete una cubierta de correa de la banda de EF a esta.
4. Coloque el localizador de la banda de EF del muslo (una marca para el dedo) en el centro del muslo, a unos tres dedos de la rótula si va a estimular el cuádriceps o a tres dedos del hueco poplíteo si va a estimular los femorales. Consulte la ilustración 8-18.

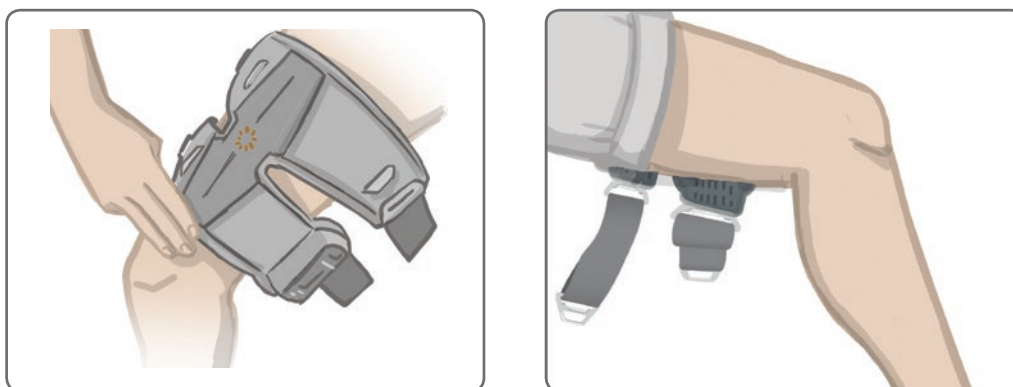


Ilustración 8-18: Posición correcta del localizador de la banda de EF del muslo (izquierda: posición en el cuádriceps; derecha: posición en los femorales)

5. Centre el puente en el muslo. Consulte la ilustración 8-19.
6. Abroche las correas insertando la hebilla en el enganche sujeto a los paneles de la banda de EF del muslo. Consulte la ilustración 8-19. Si fuera necesario, tense la correa ajustando los lazos de la correa.

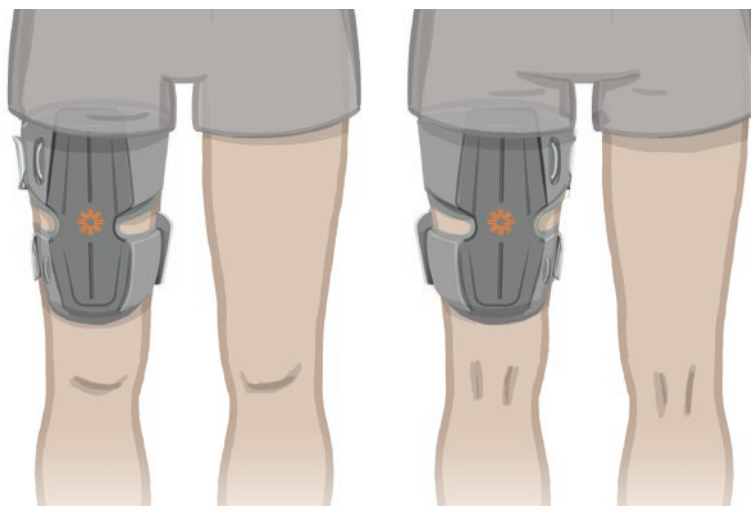


Ilustración 8-19: Posición correcta de la banda de EF del muslo (izquierda) posición de ajuste en el cuádriceps, (derecha) posición de ajuste femoral

Prueba de la posición de la banda de EF del muslo: paciente sentado y de pie

Para comprobar la posición de la banda de EF del muslo:

1. Pídale al paciente que se siente con la parte inferior de la pierna colgada sin obstrucciones.
2. En el caso de los pacientes nuevos, mantenga presionados durante cinco segundos los botones de estimulación y modo del EPG del muslo para activar los parámetros predeterminados.

Nota: Si se desea, estos parámetros predeterminados se pueden usar como ajustes para el sistema L300 Go del paciente. Si se prefieren usar parámetros distintos, el especialista deberá acceder al software de la aplicación del especialista del sistema L300 Go para programarlos.

3. El nivel de intensidad de la estimulación predeterminado es 0. Presione el botón de estimulación del EPG para activar la estimulación.
4. Presione el botón más del EPG para aumentar de forma gradual la intensidad de la estimulación hasta conseguir la extensión o la flexión deseada de la rodilla.
5. Una vez que logre producir una dorsiflexión o una flexión apropiada con el paciente sentado, vuelva a probar con el paciente de pie, con la rodilla en un ángulo ajustable y el pie en el aire.
6. Si fuera necesario, ajuste la intensidad de la estimulación para conseguir la extensión o flexión de la rodilla en esta posición.

Emparejamiento del EPG del muslo

En el caso de los pacientes que usen tanto la banda de EF de la parte inferior de la pierna como la banda de EF del muslo, el EPG del muslo debe emparejarse con el EPG de la parte inferior de la pierna. Si necesita instrucciones sobre el emparejamiento, consulte la sección “Emparejamiento de un EPG de la parte inferior de la pierna con un EPG del muslo” de esta guía.

En el caso de los pacientes que usen el sistema Thigh Stand-Alone, el EPG del muslo debe emparejarse con el sensor de pie. Si necesita instrucciones sobre el emparejamiento, consulte la sección “Emparejamiento de un sensor de pie nuevo con el EPG” de esta guía. Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el sensor de pie, consulte la sección “Ajuste del sensor de pie” de este capítulo.

Retirada de la banda de EF del muslo

1. Presione el botón de encendido del EPG para apagar el sistema.
2. Desabroche ambos juegos de correas.
3. Levante lentamente la banda de EF del muslo separándola de la piel del paciente.
4. Retire los Electrodo Thigh Cloth de la banda de EF del muslo y guárdelos en un lugar donde puedan secarse al aire para evitar la aparición de moho.

Nota: Asegúrese de indicar a los pacientes que vayan a utilizar el sistema L300 Go en casa que ventilen la piel retirando la banda de EF del muslo al menos durante 15 minutos cada tres o cuatro horas.

Programación del paciente


Antes de programar el sistema L300 Go, asegúrese de que los electrodos y la banda de EF se han ajustado correctamente en el paciente y de que este está sentado. Consulte el capítulo “Preparación del paciente” de esta guía para obtener instrucciones.

Emparejamiento de la aplicación del especialista del sistema L300 Go con el sistema L300 Go

Antes de emparejar la aplicación del especialista del sistema L300 Go con el sistema L300 Go, asegúrese de que los componentes del paciente (EPG, sensor de pie y unidad de control) ya se han emparejado entre sí. Consulte el capítulo “Emparejamiento de los componentes de repuesto” de esta guía para obtener instrucciones.

Cuando se empareja un EPG de la parte inferior de la pierna o un EPG Thigh Stand-Alone con la aplicación del especialista del sistema L300 Go, esta reconoce automáticamente los demás componentes emparejados con dicho EPG. Por ejemplo, un sensor de pie o un EPG del muslo (en pacientes que usen la banda de EF del muslo con la banda de EF de la parte inferior de la pierna).

Para emparejar la aplicación del especialista del sistema L300 Go con el sistema L300 Go

1. Encienda el programador médico y abra la aplicación del especialista. Para ello, presione el icono de la aplicación del especialista del sistema L300 Go .
2. Se abre la pantalla Iniciar sesión. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y presione el botón Iniciar sesión.
3. Se abre la pantalla Base de datos de pacientes. En la barra de navegación, presione el icono de Bluetooth®. Consulte la ilustración 9-0.

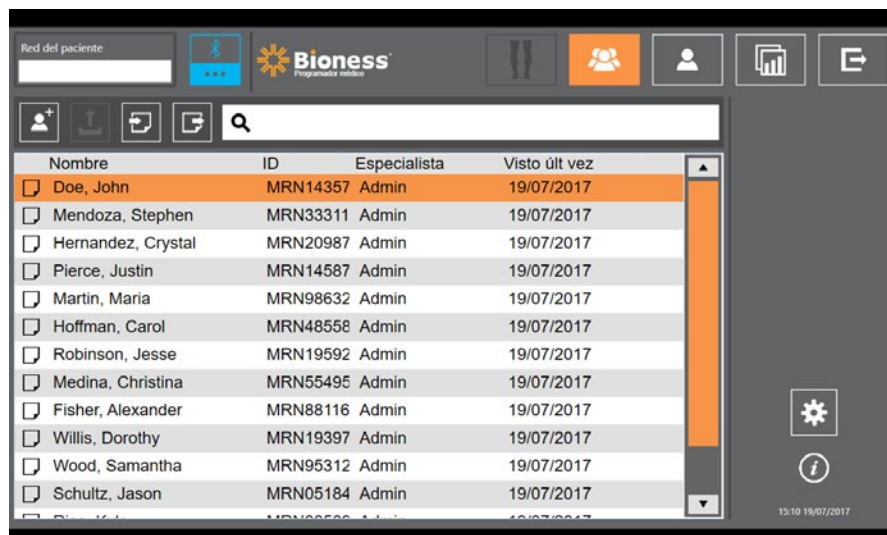



Ilustración 9-0: Icono de Bluetooth®

4. Haga clic en el icono de emparejamiento situado encima de la pierna que desee. Consulte la ilustración 9-1.
5. Presione de forma simultánea los botones más (+) y menos (-) del EPG para acceder al modo de emparejamiento en el EPG deseado.
6. Cuando se produzca el emparejamiento, el icono de emparejamiento se transformará en un icono naranja para cancelar el emparejamiento: .

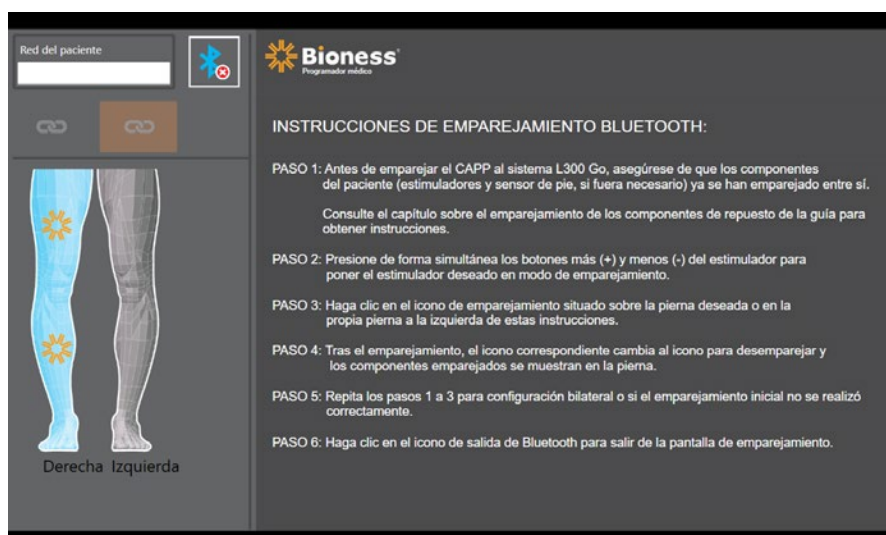


Ilustración 9-1: Pantalla de emparejamiento

7. Haga clic en el icono de salida de Bluetooth para salir de la pantalla de emparejamiento.
8. En el caso de los pacientes ya existentes, el EPG emparejado cargará los datos del paciente en la red del paciente. Cuando termine, se abrirá una ventana emergente donde se le pide que seleccione el paciente que se dispone a emparejar en la red. Carga completa. La aplicación del especialista del sistema L300 Go cargará el paciente actual a la red del paciente. En el caso de pacientes nuevos, habrá que crear un expediente de paciente nuevo.

Creación de un perfil de un paciente nuevo

Para crear un perfil de paciente nuevo:

1. Asegúrese de que hay un sistema L300 Go emparejado con la aplicación del especialista del sistema L300 Go.
2. En la pantalla Base de datos de pacientes, presione el botón para añadir un paciente nuevo. Consulte la ilustración 9-2.

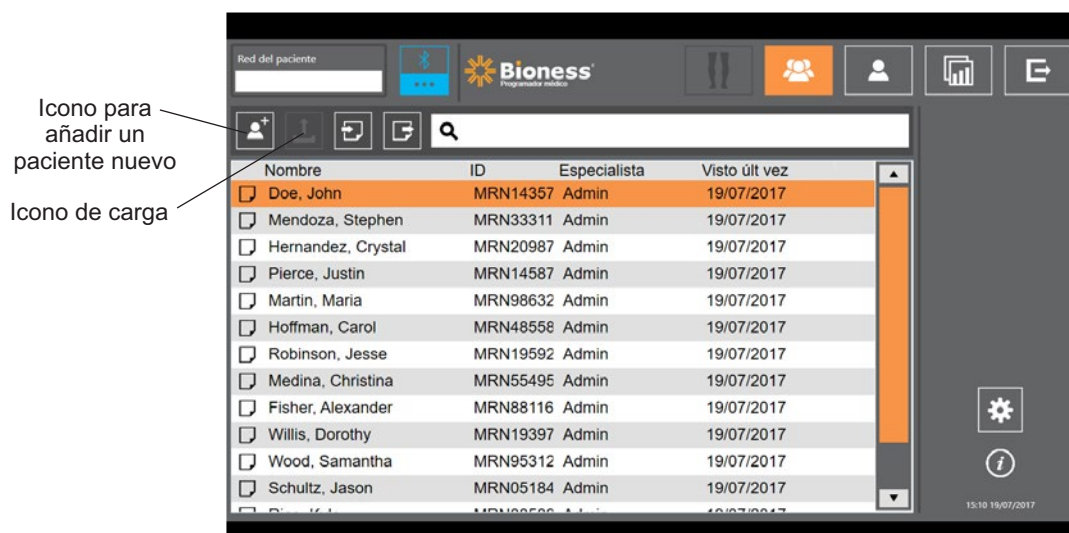


Ilustración 9-2: Icono para añadir un paciente nuevo

3. Introduzca los datos del paciente (ID de paciente, nombre legal, fecha de nacimiento [DD/MM/AAAA] y sexo).
4. Presione el botón de la marca de verificación para guardar el perfil del nuevo paciente.

Carga de un perfil de paciente en el sistema L300 Go

Es posible cargar el perfil de un paciente existente en la red del paciente y en el EPG emparejado.

Para cargar un perfil de paciente existente:

1. Asegúrese de que hay un sistema L300 Go emparejado con la aplicación del especialista del sistema L300 Go.
2. Abra la pantalla Base de datos de pacientes y resalte el paciente en la lista. Consulte la ilustración 9-2.
3. Presione el icono para cargar (consulte la ilustración 9-2). Se abrirá una ventana con el mensaje: "Programar todos los estimuladores con el paciente: X,X". Presione el botón Continuar.
4. La aplicación del especialista del sistema L300 Go cargará los datos del paciente en la red del paciente y en el EPG emparejado.
5. Se abrirá una ventana con el mensaje: "X,X se ha cargado en el programador". Presione el botón OK.

Cómo programar los parámetros de estimulación

Cuando la aplicación del especialista del sistema L300 Go se haya emparejado con un sistema L300 Go y se haya cargado un paciente a la red del paciente, el especialista podrá programar los ajustes de estimulación.

Para programar los parámetros de estimulación:


1. Asegúrese de que el paciente se encuentra sentado.
2. Presione el icono de ajustes del programa  en la barra de navegación para abrir la pantalla Ajustes del programa.
3. En la parte izquierda de la pantalla se muestran los EPG emparejados con un icono verde en las piernas asociadas. Consulte la ilustración 9-3.
4. El EPG seleccionado se indica con un contorno naranja.
5. Use las listas desplegables para ajustar los parámetros Forma de onda, Duración de la fase, Pulso y Electrodo. Consulte la definición de los ajustes de los parámetros en la tabla 9-1.
6. En el caso de los pacientes nuevos, asegúrese de que el valor de la barra de intensidad de estimulación sea 0. Consulte la ilustración 9-3.



Ilustración 9-3: Programación de la estimulación: pantalla de estimulación

7. Presione el botón Prueba para encender la estimulación. Aumente gradualmente la intensidad de la estimulación con las flechas de la barra de intensidad de la estimulación hasta el nivel deseado.

La estimulación comenzará con un tiempo de incremento gradual (el tiempo que tarda la estimulación en aumentar de cero al nivel máximo establecido) de 1,5 segundos.

Nota: Cuando se proporciona estimulación, el botón Prueba se muestra rojo y el icono del EPG se vuelve amarillo con una onda de estimulación.

8. Si el paciente usa más de un EPG, también deberán programarse los ajustes del EPG adicional. Seleccione el icono del EPG que desee en la pantalla de programación de la estimulación y repita los pasos del 5 al 7.

Los cambios que realice en los ajustes de la aplicación del especialista del sistema L300 Go no se implementarán y guardarán hasta que presione el botón Prueba. De esta forma se activan los ajustes y se guarda la información en el EPG emparejado.

Parámetro de estimulación	Definición
Intensidad	Potencia de la estimulación: 0 mA a 100 mA, en incrementos de 1 mA
Forma de onda	Tipo de estimulación: Simétrica o asimétrica
Duración de la fase	Duración del pulso: 100, 200 o 300 μ s
Frecuencia de Pulso	Frecuencia de la estimulación: 20 Hz a 45 Hz, en incrementos de 5 Hz
Electrodo	Tipo de electrodo: Quick Fit (predeterminado), Round Cloth, Hydrogel, Steering

Tabla 9-1: Definición de los ajustes de parámetros de estimulación

Cómo programar los parámetros avanzados de estimulación

1. En la pantalla de programación de la estimulación, presione el icono de configuración avanzada de estimulación (consulte la ilustración 9-3) para abrir la ventana correspondiente. Consulte la ilustración 9-4.
2. Ajuste los valores avanzados Periodo interfase, Dedo fuera y Tiempo máximo de estimulación.

Parámetro de estimulación avanzado	Definición
Periodo interfase	El valor predeterminado de este ajuste es 50 para aumentar la producción de fuerza y proporcionar la máxima contracción con la menor incomodidad. Los intervalos varían entre 20, 50, 100 y 200. El valor por defecto de la onda simétrica es 50 y el de la asimétrica, 20.
Tiempo máximo de estimulación	<p>Para evitar una fatiga excesiva de los músculos que activan la dorsiflexión, el sistema L300 Go está diseñado para detener automáticamente la estimulación después de unos segundos (la duración máxima de la estimulación). Esta función de seguridad resulta útil cuando el paciente se sienta o se tumba y la pierna que lleva el sistema L300 Go está en el aire mientras el sistema está en el modo de marcha. Limita la duración de la estimulación. Para ajustar la duración máxima de la estimulación, utilice el lápiz óptico para cambiar la duración.</p> <p>Para usuarios rápidos y estables: Este parámetro puede ser relativamente bajo (el parámetro predeterminado es 4 segundos). El parámetro más bajo debería ser la cantidad máxima de tiempo que lleva al paciente levantar la pierna para subir un escalón o superar un obstáculo.</p> <p>Para caminantes lentos o pacientes que se encuentran en las etapas iniciales de la rehabilitación: Es posible que este parámetro deba ser superior a 4 segundos para aquellos pacientes que precisen más tiempo para hacer avanzar la pierna durante la fase de balanceo de la marcha.</p>

Parámetro de estimulación avanzado	Definición
Sensor de pie	<p>Si la aplicación del especialista del sistema L300 Go está conectada a un sistema que use un sensor de pie, el ajuste del sensor de pie está activado.</p> <p>Use la lista desplegable para seleccionar una de estas opciones: Contralateral o Mismo lado.</p> <p>Casilla Sensor de pie necesario: si esta casilla no está marcada, se activa la función de copia de seguridad del sensor de movimiento. Si el sensor de pie no se comunica con el EPG, este usará los sensores de movimiento integrados para detectar la marcha.</p>

Tabla 9-2: Definición de los ajustes avanzados de parámetros de estimulación

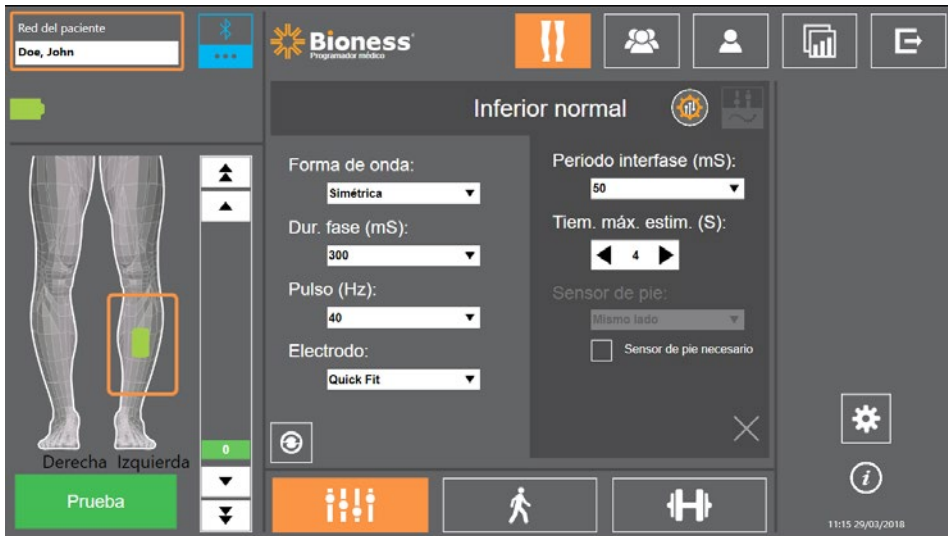


Ilustración 9-4: Programación de la estimulación: pantalla de estimulación con la ventana de configuración avanzada

Programación de los ajustes de la pantalla de parámetros avanzados

Si el paciente usa el Electrodo Steering, asegúrese de que el menú desplegable Electrodo muestra la opción Dirección para activar el icono de parámetros avanzados. Presione el icono de parámetros avanzados (consulte la ilustración 9-3) para abrir la ventana correspondiente. El especialista podrá entonces ajustar la intensidad de la estimulación central y lateral del EPG de la parte inferior de la pierna. Consulte la ilustración 9-5.

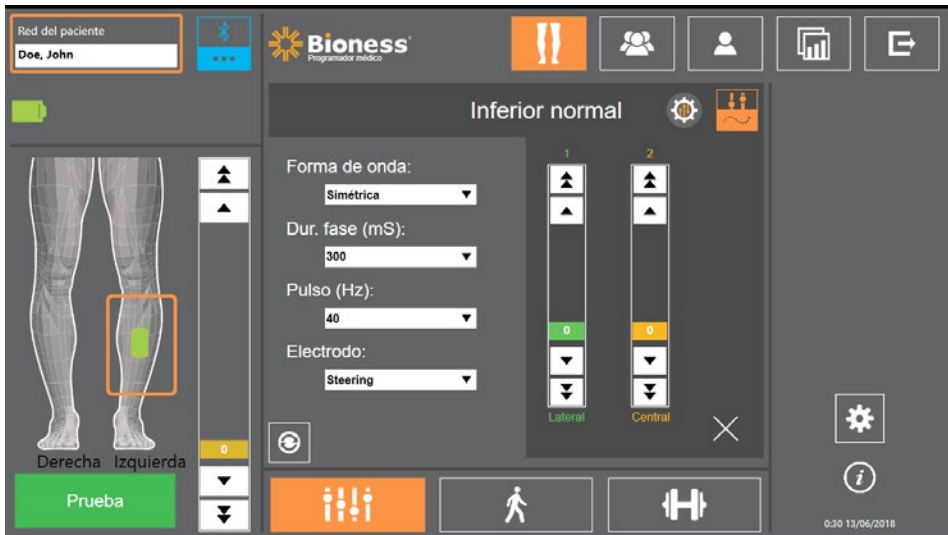


Ilustración 9-5: Programación de la estimulación: pantalla de estimulación con la ventana de parámetros avanzados

Programación de los parámetros de marcha

Para programar los parámetros de marcha:

- 1. Asegúrese de que el paciente se encuentra de pie.
- 2. En la pantalla de programación de la estimulación, presione el icono de la pantalla de marcha:







- 3. Se abrirá la pantalla de configuración de la marcha. Consulte la ilustración 9-6.



Ilustración 9-6: Programación de la estimulación: pantalla de configuración de la marcha

- 4. Ajuste los parámetros arriba, Cuesta abajo, Ampliado e Intensidad. Consulte la tabla 9.3.

Parámetro de marcha	Definición
 Cuesta arriba	El tiempo que la simulación tarda en aumentar de cero al nivel máximo establecido (en segundos). Un incremento gradual de la corriente hace que la estimulación sea más cómoda, ayuda a evitar los reflejos de estiramiento muscular y retrasa el comienzo de la contracción muscular. Los valores van de 0 a 0,5 segundos en incrementos de 0,1 segundo.
 Cuesta abajo	El tiempo que la simulación tarda en disminuir del nivel máximo establecido a cero (en segundos). La disminución de la corriente se realiza lentamente para reducir la contracción muscular de forma gradual. Aumente este parámetro para evitar golpes del pie. Los valores van de 0 a 0,5 segundos en incrementos de 0,1 segundo.
 Extensión	El porcentaje del tiempo total, desde el apoyo del talón hasta la elevación del talón, durante el cual continúa la estimulación después de que el talón haya hecho contacto con el suelo. Este parámetro determina el lapso de tiempo que debe transcurrir antes de que la estimulación comience a disminuir gradualmente. Aumente este parámetro para evitar los problemas de golpes del pie y genu recurvatum (hiperextensión o chasquido de la rodilla) o para aumentar la estabilidad de la rodilla durante la fase de postura.
 Retraso	El porcentaje del tiempo total que la estimulación se retrasa después de que se detecte un evento de marcha. Se usa para evitar una elevación prematura del pie. Determina cuándo comienza a aumentar gradualmente la estimulación. (% de retraso = el tiempo total desde la elevación al apoyo del talón).

Parámetro de marcha	Definición
Intensidad	La potencia de la estimulación eléctrica. Los valores van de 0 a 100 mA. El valor inicial que aparece en la barra de intensidad será el nivel establecido cuando se configuraron los parámetros de estimulación. Mientras esté en el modo de marcha, se pueden realizar cambios en el nivel de intensidad que se mantendrán en el modo de entrenamiento, a menos que haya activado la función “Activar nivel de intensidad específico” para el modo de entrenamiento en la ventana de parámetros avanzados de Configuración de entrenamiento.

Tabla 9-3: Definición de los parámetros de marcha

Nota: A fin de reducir al mínimo los problemas de genu recurvatum (hiperextensión o chasquido de la rodilla) y golpes del pie, utilice la opción Ampliada para crear un contracción excéntrica de los dorsiflexores después de que el talón haga contacto.

- Presione el icono de estimulación para probar y guardar los ajustes. La estimulación responderá a los datos entrantes de actividad de la marcha provenientes del sensor de pie (si fuera aplicable) o del sensor de movimiento integrado en el EPG.
- Ajuste de manera precisa los parámetros mientras el paciente camina.
- Presione el icono de estimulación de nuevo para detener la estimulación.

Programación de los parámetros de entrenamiento

Para programar los parámetros de entrenamiento:


- En la pantalla de programación de la estimulación, presione el icono de la pantalla de entrenamiento:

- Se abrirá la pantalla de configuración del entrenamiento. Consulte la ilustración 9-7.



Ilustración 9-7: Programación de la estimulación: pantalla de configuración del entrenamiento

- Haga clic en la casilla Excluir en el programa de entrenamiento para marcarla.
- Ajuste las variables Tiempo encendido, Tiempo apagado, Cuesta arriba, Cuesta abajo y Tiempo total. Consulte la tabla 9-4.
- Si se desea una intensidad de la estimulación distinta a la establecida para la marcha, marque la casilla situada junto a Habilitar intensidad entrenamiento. A continuación, ajuste el nivel de intensidad de la estimulación.

6. Presione el icono de estimulación de entrenamiento para iniciar la estimulación en el modo de entrenamiento.
7. Presione el icono de estimulación de entrenamiento de nuevo para desactivar la estimulación o para dejar que el programa se ejecute durante todo el tiempo que tiene asignado.










Parámetro de entrenamiento	Definición
 Tiempo encendido	El tiempo que se aplica la estimulación.
 Tiempo apagado	El tiempo de descanso entre las estimulaciones
 Cuesta arriba	El tiempo que la simulación tarda en aumentar de cero al nivel máximo establecido (en segundos). Un incremento gradual de la corriente hace que la estimulación sea más cómoda, ayuda a evitar los reflejos de estiramiento muscular y retrasa el comienzo de la contracción muscular. Los valores van de 0 a 2 segundos en incrementos de 0,5 segundo.
 Cuesta abajo	El tiempo que la simulación tarda en disminuir del nivel máximo establecido a cero (en segundos). La disminución de la corriente se realiza lentamente para reducir la contracción muscular de forma gradual. Aumente este parámetro para evitar golpes del pie. Los valores van de 0 a 2 segundos en incrementos de 0,5 segundo.
 Tiempo total	La cantidad de tiempo total del período de entrenamiento. El período de entrenamiento consiste en una serie de ciclos repetidos de los parámetros de incremento gradual (Cuesta arriba), Tiempo encendido, disminución gradual (Cuesta abajo) y Tiempo apagado hasta que finaliza el tiempo total de la sesión.

Tabla 9-4: Definición de los parámetros de entrenamiento

Configuración de los avisos sonoros y por vibración

Las pantallas de configuración de la marcha y configuración del entrenamiento de la programación de la estimulación presentan un icono de aviso sonoro y otro de aviso por vibración. Estos iconos activan o desactivan los avisos sonoros y por vibración durante la estimulación. Los iconos de la pantalla de configuración de la marcha permiten controlar los avisos sonoros y por vibración cuando el EPG se encuentra en el modo de marcha. Los iconos de la pantalla de configuración del entrenamiento permiten controlar los avisos sonoros y por vibración cuando el EPG se encuentra en el modo de entrenamiento.

Icono	Definición
	Los avisos sonoros están activados.
	Los avisos sonoros están desactivados.
	Los avisos por vibración están activados.
	Los avisos por vibración están desactivados.

Entrenamiento del paciente

Los especialistas y los pacientes deben conocer las limitaciones, las advertencias y las precauciones asociadas con el sistema L300 Go. Los especialistas deben repasar la información de seguridad con los pacientes y entrenarles para configurar, hacer funcionar y realizar el mantenimiento de los componentes. Los pacientes deben comprender las pantallas e indicadores del sistema, así como las soluciones a los problemas. Los especialistas y los pacientes deben saber con quién han de contactar para recibir asistencia médica y técnica.

Un programa de entrenamiento debería cubrir los siguientes asuntos, que se describen en esta guía y en la Guía del usuario del sistema L300 Go:

- Información de seguridad general, incluidas instrucciones para el cuidado de la piel
- Descripción general del sistema L300 Go
- Colocación y retirada de la banda de EF
- Sustitución de los electrodos y las bases de los electrodos
- Colocación del sensor de pie en un zapato (para pacientes que usen esta opción)
- Funcionamiento de la unidad de control
- Botones, pantallas y alertas de sonido de los componentes del sistema: definiciones y funciones
- Uso de los modos de marcha y entrenamiento
- Instrucciones de mantenimiento y limpieza
- Revisión de las soluciones de los problemas básicos
- Cómo ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica

Mantenimiento y limpieza

Carga

Cargue el programador médico a diario. Las baterías de los EPG de la parte inferior de la pierna y del muslo también se deben cargar a diario. Encontrará instrucciones sobre cómo cargar los EPG en la sección “Carga del sistema L300 Go” de esta guía.

Sustitución de la batería del EPG

Los EPG de la parte inferior de la pierna y del muslo tienen una batería recargable que únicamente puede sustituir un representante autorizado de Bioness. Dependiendo del uso, puede que haya que cambiar las baterías aproximadamente cada dos o tres años. Si es necesario cambiar las baterías, póngase en contacto con el Departamento de relaciones con el cliente de Bioness en el teléfono +1 800 211 9136, opción 3.

Sustitución de la batería del sensor de pie

La batería del sensor de pie no es recargable y se debe sustituir aproximadamente cada seis meses. El sensor de pie se alimenta con una sola batería de botón de litio (CR2032).

El indicador luminoso rojo del sensor de pie se iluminará intermitentemente durante cinco segundos cuando detecte que la batería está baja. El icono del indicador del sensor de pie de la unidad de control también se volverá intermitente.

⚠ Advertencia: Para sustituir la batería, utilice solo una batería de botón de litio CR2032. El uso de una batería incorrecta puede dañar el sistema L300 Go.

Para sustituir la batería del sensor de pie:

1. Use la cavidad de la parte trasera del sensor de pie para levantar la tapa de la batería. Consulte la ilustración 11-1.

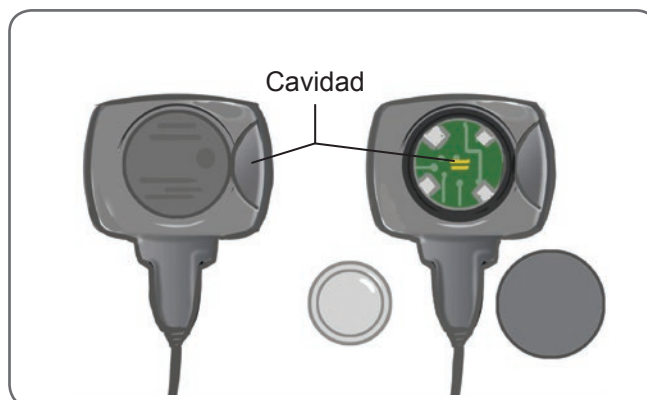


Ilustración 11-1: Sustitución de la batería del sensor de pie

2. Preste atención a la orientación del polo “+” en la batería vieja.
3. Retire la batería vieja.

4. Espere al menos 120 segundos (dos minutos) e inserte la nueva batería. El polo “+” debe estar orientado hacia arriba.
5. Vuelva a cerrar la tapa de la batería de la parte trasera del sensor de pie presionando con firmeza hasta que encaje correctamente.
6. Presione el sensor de presión del sensor de pie para activarlo.
7. Si el sensor de pie no se enciende, cortocircuite el conector de la batería colocando una moneda o la propia batería entre los polos positivo y negativo del sensor de pie. Repita los pasos del 5 al 6.



Quite la batería vieja y deséchela conforme a los reglamentos medioambientales locales.

Sustitución de la batería de la unidad de control

La batería de la unidad de control no es recargable y, dependiendo del uso, se deberá sustituir aproximadamente cada seis meses. La unidad de control se alimenta con una sola batería de botón de litio (CR2032).



El icono del indicador de la batería de la unidad de control se iluminará de forma intermitente durante cinco segundos al arrancar si la batería de la unidad de control está baja.

Advertencia: Para sustituir la batería, utilice solo una batería de botón de litio CR2032. El uso de una batería incorrecta puede dañar el sistema L300 Go.

Para sustituir la batería de la unidad de control:

1. Use la cavidad de la parte trasera de la unidad de control para levantar la tapa de la batería. Si tiene dificultades para retirar la tapa, puede usar una moneda para abrirla. Consulte la ilustración 11-2.



Ilustración 11-2: Sustitución de la batería de la unidad de control

2. Preste atención a la orientación del polo “+” en la batería vieja.
3. Retire la batería vieja.
4. Para colocar la batería nueva, insértela primero en la parte trasera y presiónela con cuidado hacia abajo. El polo “+” debe estar orientado hacia arriba.
5. Vuelva a cerrar la tapa de la batería de la parte trasera de la unidad de control presionando con firmeza hasta que encaje correctamente.



Quite la batería vieja y deséchela conforme a los reglamentos medioambientales locales.

Sustitución de los Electrodo Quick Fit

Debe sustituir los Electrodo Quick Fit al menos cada dos semanas, o antes si se desgastan.

⚠ **Atención:** Utilice únicamente electrodos proporcionados por Bioness.

⚠ **Atención:** No utilice el sistema L300 Go sin los electrodos.

⚠ **Atención:** No doble ni pliegue el Electrodo Quick Fit.

Para sustituir los Electrodo Quick Fit: (consulte la ilustración 11-3)

1. Asegúrese de que el EPG de la parte inferior de la pierna está apagado.
2. Retire con cuidado el Electrodo Quick Fit usado de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
3. Humedezca los Electrodo Quick Fit con agua corriente hasta que estén empapados.
4. Con un paño, escurra o seque el exceso de agua del electrodo.
5. Alinee los broches naranja y azul del Electrodo Quick Fit con los orificios naranja y azul de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
6. Apriete con firmeza para encajar el Electrodo Quick Fit en la banda de EF de la parte inferior de la pierna.



Ilustración 11-3: Sustitución del Electrodo Quick Fit

Indique al paciente que retire y vuelva a mojar el Electrodo Quick Fit cada vez que se quite la banda de EF de la parte inferior de la pierna durante más de una hora y después de cada cuatro horas de uso. Cuando moje el Electrodo Quick Fit, sáquelo siempre de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.

Si el Electrodo Quick Fit se seca, posiblemente la reacción al estímulo cambie. Si el paciente necesita ajustar la intensidad de la estimulación con más frecuencia de lo habitual, pruebe a humedecer de nuevo o a sustituir el electrodo.

Nota: Almacene el Electrodo Quick Fit en un lugar donde se pueda secar al aire cuando no esté en uso.

Sustitución de los Electrodos Steering

Debe sustituir los Electrodos Steering al menos cada dos semanas, o antes si se desgastan.

⚠ Atención: Utilice únicamente electrodos proporcionados por Bioness.

⚠ Atención: No utilice el sistema L300 Go sin los electrodos.

⚠ Atención: No doble ni pliegue el Electrodo Steering.

Para sustituir los Electrodos Steering: (consulte la ilustración 11-4)

1. Asegúrese de que el EPG de la parte inferior de la pierna está apagado.
2. Retire con cuidado el Electrodo Steering usado de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
3. Humedezca el electrodo con agua corriente hasta que esté empapado.
4. Con un paño, escurra o seque el exceso de agua del electrodo.
5. Alinee los cuatro broches del Electrodo Steering con los orificios de enganche de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
6. Apriete con firmeza para encajar el Electrodo Steering en la banda de EF de la parte inferior de la pierna.

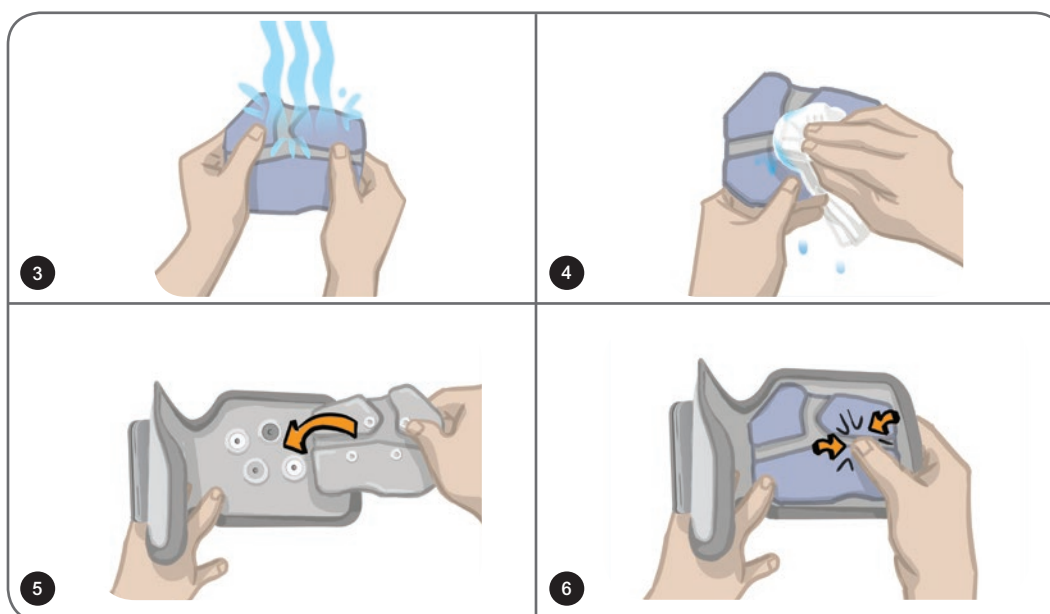


Ilustración 11-4: Sustitución del Electrodo Steering

Indique al paciente que retire y vuelva a mojar el Electrodo Steering cada vez que se quite la banda de EF de la parte inferior de la pierna durante más de una hora y después de cada cuatro horas de uso. Cuando moje el Electrodo Steering, sáquelo siempre de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.


Si el Electrodo Steering se seca, posiblemente la reacción al estímulo cambie. Si el paciente necesita ajustar la intensidad de la estimulación con más frecuencia de lo habitual, pruebe a humedecer de nuevo o a sustituir el electrodo.

Nota: Almacene el Electrodo Steering en un lugar donde se pueda secar al aire cuando no esté en uso.

Sustitución de los Electrodos Round Cloth

Debe sustituir los Electrodos Cloth al menos cada dos semanas, o antes si se desgastan.

 **Atención:** Utilice únicamente Electrodos Cloth proporcionados por Bioness.

 **Atención:** No utilice el sistema L300 Go sin los electrodos.

Para sustituir los Electrodos Round Cloth:

1. Asegúrese de que el EPG de la parte inferior de la pierna está apagado.
2. Extraiga con cuidado los Electrodos Round Cloth usados de sus bases. Tenga cuidado de no desconectar las bases de los electrodos de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
3. Si fuese necesario, limpie las bases de los electrodos con un paño húmedo. Las bases de los electrodos se pueden limpiar y desinfectar superficialmente con alcohol isopropílico al 70 %.
4. Humedezca los Electrodos Round Cloth con agua corriente hasta que estén empapados. Consulte la ilustración 11-5.
5. Utilice un paño y limpie o seque con cuidado el exceso de agua del reverso (lado del broche) de los electrodos. Consulte la ilustración 11-5.

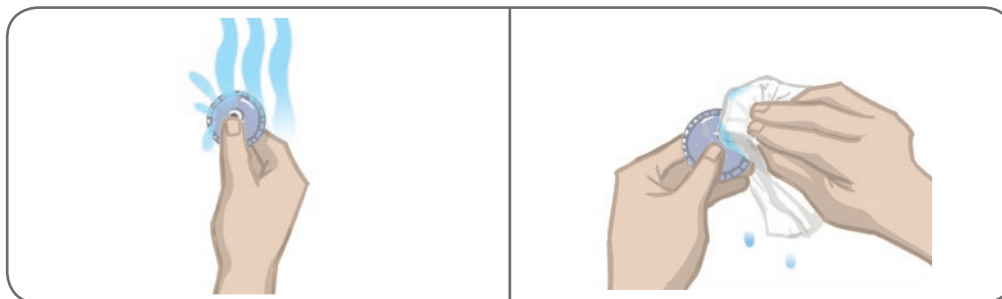


Ilustración 11-5: Cómo humedecer y eliminar el exceso de agua

6. Sujete los Electrodos Round Cloth a sus bases. Consulte la ilustración 11-6.

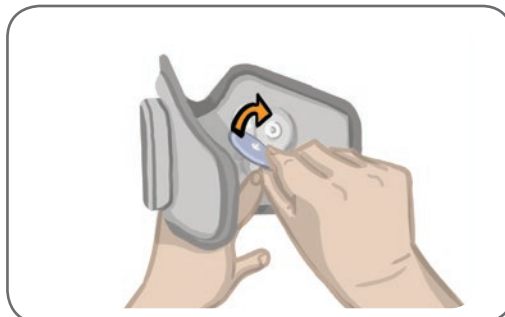


Ilustración 11-6: Sujeción de los Electrodos Round Cloth

Indique al paciente que retire y vuelva a mojar los Electrodo Round Cloth cada vez que se quite la banda de EF de la parte inferior de la pierna durante más de una hora y después de cada cuatro horas de uso. Cuando moje los electrodos, sáquelos siempre de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.

Si los Electrodo Round Cloth se secan, posiblemente su reacción al estímulo cambie. Si el paciente necesita ajustar la intensidad de la estimulación con más frecuencia de lo habitual, pruebe a humedecer de nuevo o a sustituir el electrodo. Almacene los Electrodo Cloth en un lugar donde puedan secarse al aire cuando no estén en uso.

Sustitución de los Electrodo Hydrogel

Los Electrodo Hydrogel deben sustituirse al menos cada dos semanas.

⚠ Atención: Utilice únicamente Electrodo Hydrogel proporcionados por Bioness.

⚠ Atención: No utilice el sistema L300 Go sin los electrodos.

Para sustituir los Electrodo L300 Hydrogel: (consulte la ilustración 11-7)

1. Asegúrese de que el EPG de la parte inferior de la pierna está apagado.
2. Extraiga con cuidado los Electrodo Hydrogel usados de sus bases. Tenga cuidado de no desconectar las bases de los electrodos de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.
3. Si fuese necesario, limpie las bases de los electrodos con un paño húmedo. Las bases de los electrodos se pueden limpiar y desinfectar superficialmente con alcohol isopropílico al 70 %.
4. Separe los dos electrodos nuevos por la línea perforada.
5. Desprenda las cubiertas de dos piezas de cada electrodo nuevo y deséchelas.
6. Adhiera el lado de la rejilla de los electrodos a las bases de los electrodos y luego presione con firmeza.
7. Quite las cubiertas de los electrodos.

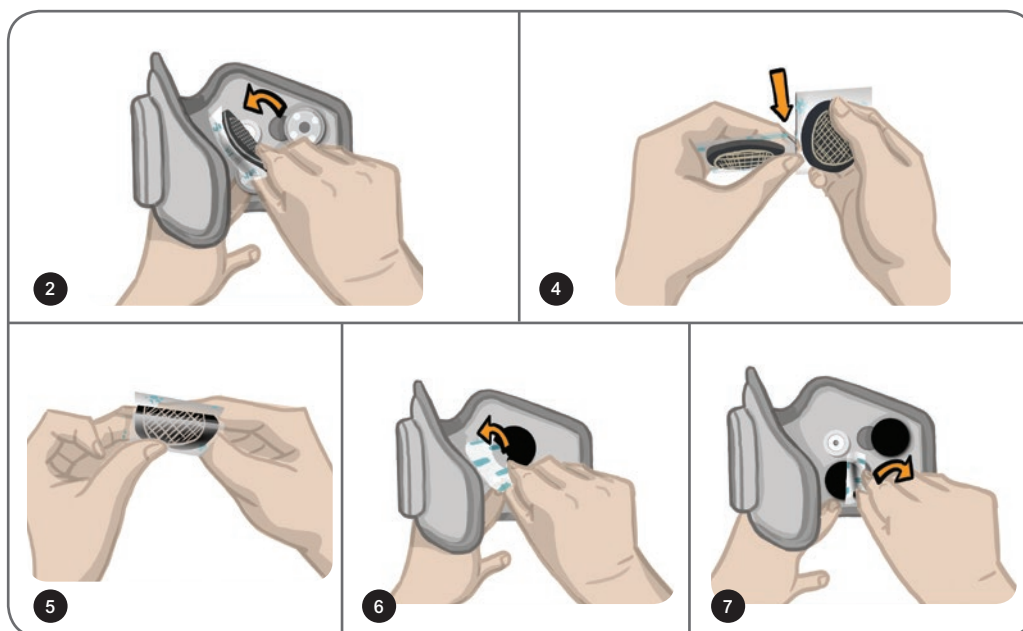


Ilustración 11-7: Sustitución de los Electrodo Hydrogel

Guarde las cubiertas para proteger los electrodos entre un uso y el siguiente. Cuando vuelva a colocar las cubiertas, asegúrese de que el logotipo de Bioness quede hacia arriba. Si el gel del electrodo se seca, sustitúyalo por un nuevo juego de electrodos.

Sustitución de las bases de los electrodos

Dependiendo del uso, puede ser necesario sustituir las bases de los electrodos cada año.

Para sustituir las bases de los electrodos:

1. Retire los ocultadores de cables y marque la posición de las bases de electrodos usadas en el revestimiento de la banda de EF con un marcador indeleble. Consulte la ilustración 11-8.
2. Desconecte los broches de las bases de los electrodos de los orificios de enganche. Consulte la ilustración 11-8.

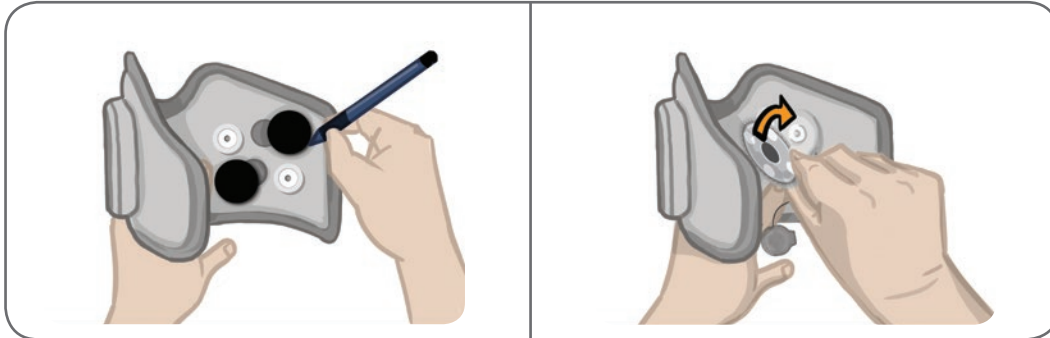


Ilustración 11-8: Marque la posición de la base del electrodo (izquierda)
Desconecte los broches de la base del electrodo (derecha)

3. Retire las bases de electrodos usadas de la banda de EF. Consulte la ilustración 11-9.
4. Coloque las bases nuevas de los electrodos donde estaban ubicadas las bases anteriores. Consulte la ilustración 11-10.
5. Conecte los broches de las bases de los electrodos a los orificios de enganche. Consulte la ilustración 11-10.
6. Si lo desea, recubra los cables y los broches con los ocultadores de cables.

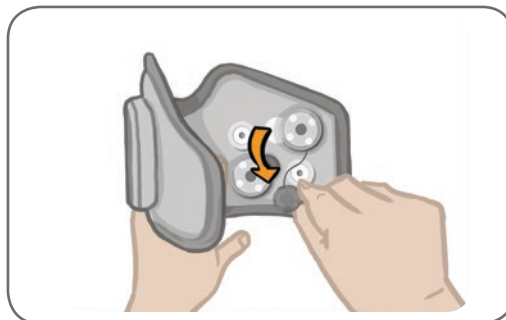


Ilustración 11-9: Retirada de las bases de electrodos usadas

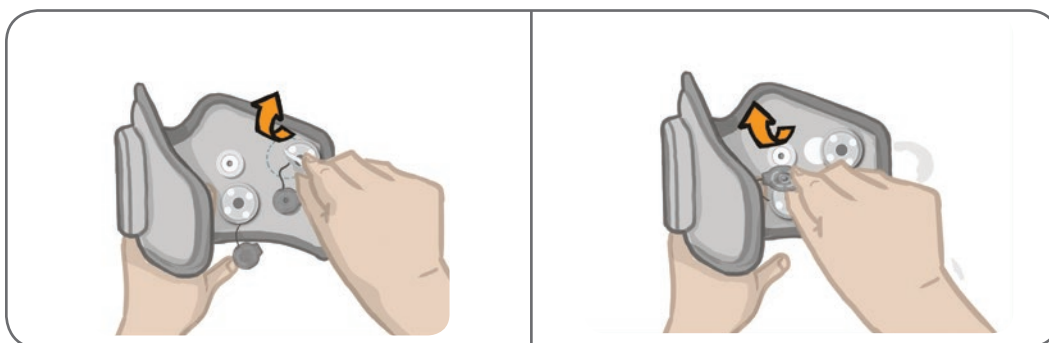


Ilustración 11-10: Sujeción de las nuevas bases de electrodos (izquierda)
Conexión de los broches de las bases de electrodos (derecha)

Sustitución de los Electrodo Thigh Cloth

Debe sustituir los Electrodo Thigh Cloth al menos cada dos semanas, o antes si se dañen.

⚠ Atención: Utilice únicamente electrodos proporcionados por Bioness.

⚠ Atención: No utilice el sistema L300 Go sin los electrodos conectados.

Para sustituir los Electrodo Thigh Cloth: (consulte la ilustración 11-11)

1. Asegúrese de que el EPG del muslo está apagado.
2. Retire con cuidado los Electrodo Thigh de la banda de EF del muslo.
3. Moje los Electrodo Thigh con agua corriente. Junte y presione con cuidado los Electrodo Thigh.
4. Escurra el agua sobrante del lado de enganche de los Electrodo Thigh con un trapo.
5. Alinee los broches de los Electrodo Thigh Cloth con los orificios de enganche de la banda de EF del muslo.
6. Apriete con firmeza para encajar el Electrodo Thigh Cloth pequeño al panel inferior de la banda de EF del muslo. Apriete con firmeza para encajar el Electrodo Thigh Cloth grande al panel superior de la banda de EF del muslo.

Indique a los pacientes que retiren y vuelvan a mojar los Electrodo Thigh Cloth cada vez que se quiten la banda de EF del muslo durante más de una hora y después de cada cuatro horas de uso. Cuando moje los Electrodo Thigh Cloth, sáquelos siempre de la banda de EF del muslo.

Si los Electrodo Thigh Cloth se secan, posiblemente la reacción al estímulo cambie. Si el paciente necesita ajustar la intensidad de la estimulación con más frecuencia de lo habitual, pruebe a humedecer de nuevo o a sustituir el electrodo. Almacene los Electrodo Thigh Cloth en un lugar donde se puedan secar al aire cuando no estén en uso.

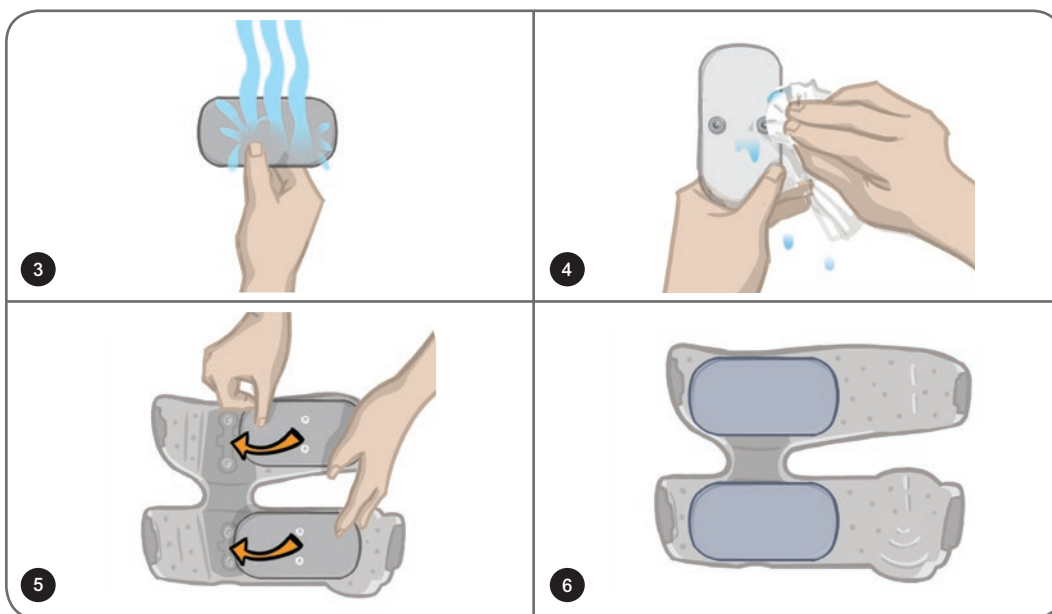


Ilustración 11-11: Sustitución de los Electrodos Thigh Cloth

Retirada del EPG

El EPG de la parte inferior de la pierna y el EPG del muslo solo se deben retirar para el mantenimiento y la limpieza de la banda de EF de la parte inferior de la pierna o la banda de EF del muslo.

Para retirar el EPG:

1. Asegúrese de que el EPG está apagado.
2. Extraiga la parte superior del EPG del estuche.
3. Saque la parte inferior del EPG del estuche.

Para volver a insertar el EPG:

4. Inserte la parte inferior del EPG en el estuche. A continuación, empuje con cuidado la parte superior del EPG hasta que se enganche en el estuche.

Retirada de las correas de la banda de EF del muslo

Las correas para el muslo se pueden retirar de la banda de EF del muslo para la limpieza o para sustituir las correas.

Para retirar las correas para el muslo:

1. Empuje la hebilla colocada en la correa del muslo hacia la banda de EF del muslo con un movimiento en espiral. Consulte la ilustración 11-12.
2. Saque la correa del muslo de la banda de EF del muslo deslizándola hacia afuera.

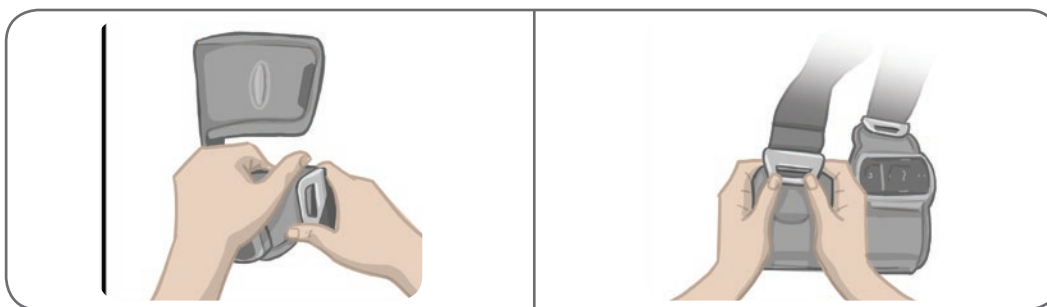


Ilustración 11-12: Retirada de las correas para el muslo

Para volver a sujetar las correas para el muslo:

1. Alinee la hebilla de la correa con el enganche sujeto a los paneles de la banda de EF del muslo.
2. Empuje con el pulgar la hebilla hacia la correa (hacia fuera respecto a la banda de EF del muslo). Consulte la ilustración 11-13. La hebilla de la correa encajará en el enganche del panel de la banda de EF del muslo.

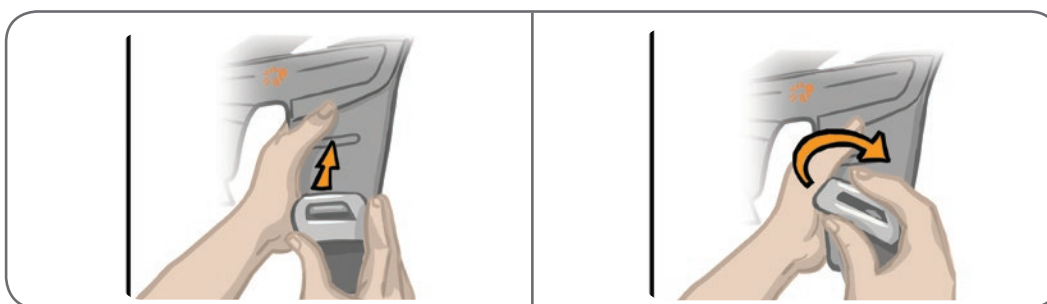


Ilustración 11-13: Cómo volver a sujetar las correas para el muslo

Limpieza de los componentes del sistema L300 Go

Todos los componentes del sistema L300 Go se pueden limpiar pasándoles con cuidado un paño húmedo. Los componentes eléctricos no son a prueba de agua. **No los sumerja en agua.**

Limpieza de la banda de EF de la parte inferior de la pierna

La banda de EF de la parte inferior de la pierna es el único componente que se puede sumergir en agua para su limpieza. Bioness recomienda limpiar la banda de EF de la parte inferior de la pierna cuando se sustituyan los electrodos.

Para limpiar la banda de EF de la parte inferior de la pierna:

1. Saque el EPG de la parte inferior de la pierna del estuche.
2. Saque con cuidado los electrodos de sus bases. Deje las bases de los electrodos y las cubiertas de broche sujetos a la banda de EF de la parte inferior de la pierna. En caso de tratarse de Electrodos Hydrogel, vuelva a colocar las cubiertas de los electrodos.

Nota: Si se usa el Electrodo Steering o el Electrodo Quick Fit, retire el electrodo directamente de los orificios de enganche de la banda de EF de la parte inferior de la pierna.

3. Sumerja la banda de EF de la parte inferior de la pierna durante 30 minutos en agua tibia y detergente suave. No lave a máquina.

4. Enjuague la banda de EF de la parte inferior de la pierna cuidadosamente con agua corriente.
5. Sumerja la banda de EF de la parte inferior de la pierna en agua tibia limpia durante 15 minutos más.
6. Enjuague la banda de EF de la parte inferior de la pierna de nuevo con agua corriente.
7. Seque con cuidado con una toalla el exceso de humedad de la banda de EF de la parte inferior de la pierna. No escurra la banda de EF. Déjela reposar en plano a la sombra hasta que se seque al aire. (No la cuelgue para que se seque). Dependiendo del clima y la humedad, puede tardar en secarse entre 4 y 12 horas. Para lograr un secado rápido, coloque la banda de EF delante de un ventilador de recirculación de aire frío. No utilice un secador de aire caliente ni otra fuente de calor.
8. Cuando la banda de EF de la parte inferior de la pierna esté completamente seca, coloque el EPG correspondiente en su estuche y ajuste los electrodos.

Limpieza de las correas para el muslo

1. Asegúrese de que las correas para el muslo se han retirado de la banda de EF del muslo.
2. Sumerja las correas del muslo durante 30 minutos en agua tibia y detergente suave. No lave a máquina.
3. Enjuague las correas cuidadosamente con agua corriente.
4. Sumerja las correas unos 15 minutos más en agua limpia y tibia.
5. Vuelva a enjuagar las correas con agua corriente.
6. Déjelas reposar a la sombra hasta que se sequen. Si lo desea, coloque los elementos delante de un ventilador de recirculación de aire frío. No utilice un secador de aire caliente ni otra fuente de calor.

Desinfección de los componentes del sistema L300 Go

Desinfección de la banda de EF del muslo

Las piezas de plástico de la banda de EF del muslo se pueden desinfectar con una combinación de toallitas CaviWipes™, según las instrucciones del fabricante, y toallitas empapadas en una solución de etanol al 70 %.

Para desinfectar la banda de EF del muslo:

1. Saque el EPG del muslo del estuche del EPG.
2. Limpie la superficie de plástico de la banda de EF del muslo (la parte orientada a la piel) con toallitas húmedas desinfectantes CaviWipes. Asegúrese de usar toallitas CaviWipes nuevas para cada panel de la banda de EF del muslo.

Nota: Lea las instrucciones de uso del fabricante y siga las medidas de precaución habituales para la protección personal.

3. Vuelva a limpiar toda la superficie durante un minuto con una o varias toallitas CaviWipes nuevas. La superficie debe quedar visiblemente húmeda. Repita este proceso de nuevo tres veces con una toallita nueva cada vez.
4. Coloque una toallita empapada en una solución de etanol al 70 % sobre cada panel de la banda de EF del muslo (en la superficie orientada a la piel). Cubra toda la superficie y deje las toallitas empapadas en la banda de EF del muslo al menos durante cinco minutos.

5. Tras cinco minutos, limpie los paneles de la banda de EF del muslo con las toallitas empapadas en etanol al 70 % y retírelas para dejar que la superficie de plástico se seque.

Desinfección de la unidad de control y el EPG

La unidad de control, el EPG de la parte inferior de la pierna y el EPG del muslo se pueden limpiar y desinfectar superficialmente mediante toallitas o trapos empapados (que no goteen) en alcohol isopropílico al 70 % siguiendo las instrucciones siguientes:

1. Use una toallita o trapo empapados en desinfectante para humedecer de forma uniforme la superficie del componente.
2. Use una segunda toallita o trapo empapados en desinfectante para limpiar la suciedad de la superficie. La suciedad, si no se elimina, impide que el desinfectante sea efectivo.
3. Si lo necesita, use toallitas o trapos empapados en desinfectante adicionales para mantener las superficies de los componentes húmedas durante tres minutos.

Nota: Siga las instrucciones de Bioness sobre el tiempo de contacto especificado para garantizar una eliminación efectiva de las bacterias.

Desinfección de los maletines de transporte del kit del sistema y del kit del especialista

Los maletines de transporte del kit del sistema L300 Go y del kit del especialista se pueden limpiar y desinfectar superficialmente con alcohol isopropílico al 70 % siguiendo estas instrucciones:

1. Limpie toda la superficie del maletín de transporte del kit con un trapo o una toallita empapados en alcohol isopropílico al 70 %.
2. Use un trapo o una toallita nuevos empapados en alcohol isopropílico al 70 % para eliminar cualquier resto de suciedad de la superficie. La suciedad, si no se elimina, impide que el desinfectante sea efectivo.
3. Vuelva a limpiar toda la superficie del maletín con un trapo o una toallita empapados en alcohol isopropílico al 70 %.
4. Use los trapos o toallitas adicionales empapados en alcohol isopropílico al 70 % que necesite para mantener la superficie del maletín húmeda durante 10 minutos.

Nota: Siga las instrucciones de Bioness sobre el tiempo de contacto especificado para garantizar una eliminación efectiva de las bacterias.

No use otros productos de limpieza o desinfectantes, como mezclas de lejía diluida u otras toallitas desinfectantes. Bioness no ha probado la efectividad de estos productos en los componentes del sistema L300 Go.

Emparejamiento de los componentes de repuesto

Los componentes del sistema L300 Go deben emparejarse entre sí para poder comunicarse de forma inalámbrica. El EPG y la unidad de control del kit del sistema ya están emparejados. En el caso de los pacientes que usen el sensor de pie opcional, será preciso emparejar este pie con los demás componentes durante una sesión de ajuste. Cuando se sustituye una unidad de control, un EPG o un sensor de pie, la nueva pieza de repuesto debe emparejarse con los componentes existentes.

Nota: Durante el emparejamiento, asegúrese de que los componentes solo están separados unos centímetros.

Configuración del emparejamiento

1. Si el componente de repuesto es un EPG, asegúrese de que el nuevo EPG esté completamente cargado. Consulte la sección “Carga del sistema L300 Go” de esta guía para obtener más información.
2. Asegúrese de que el EPG esté sujeto al estuche del EPG en la banda de EF.
3. Para encender el EPG, presione el botón de encendido del EPG.

Emparejamiento de un EPG de la parte inferior de la pierna con un EPG del muslo

1. Asegúrese de que ambos EPG están encendidos.
2. Coloque la banda de EF de la parte inferior de la pierna y la banda de EF del muslo, con los EPG sujetos, a unos centímetros de distancia.
3. Presione y sostenga durante tres segundos simultáneamente los botones de los signos más y menos del EPG de la parte inferior de la pierna. El EPG pasa a modo de emparejamiento y la luz indicadora del estado del EPG va alternando entre el color verde, el amarillo y el rojo.
4. De inmediato, presione y sostenga durante tres segundos simultáneamente los botones de los signos más y menos del EPG del muslo. El EPG pasa a modo de emparejamiento y la luz indicadora del estado del EPG va alternando entre el color verde, el amarillo y el rojo.
5. Una vez emparejados, el indicador luminoso de estado del EPG emitirá una luz verde intermitente en ambos EPG.

Emparejamiento de una unidad de control nueva con el EPG

1. Si se usa la banda de EF de la parte inferior de la pierna, debe asegurarse de que el EPG correspondiente esté encendido. Si se usa la banda de EF Thigh Stand-Alone, debe asegurarse de que el EPG correspondiente esté encendido.
2. Coloque la banda de EF, con el EPG sujeto, y la unidad de control a unos centímetros de distancia entre sí.
3. Para encender la unidad de control, presione cualquier botón. En la pantalla aparecerá una letra “P” intermitente. Si no es así, presione simultáneamente los botones de los signos más y menos hasta que aparezca una letra “P” intermitente.
4. Si se usa la banda de EF de la parte inferior de la pierna, debe mantener presionado durante tres segundos y simultáneamente los botones más y menos del EPG correspondiente. El EPG pasa a modo de emparejamiento y la luz indicadora del estado del EPG va alternando entre el color verde, el amarillo y el rojo.

5. Si se usa la banda de EF Thigh Stand-Alone, debe mantener presionados durante tres segundos simultáneamente los botones más y menos del EPG correspondiente. El EPG pasa a modo de emparejamiento y la luz indicadora del estado del EPG va alternando entre el color verde, el amarillo y el rojo.
6. Una vez emparejados, el indicador luminoso de estado del EPG emitirá luz verde intermitente. Los EPG conectados aparecerán en la pantalla de la unidad de control.

Emparejamiento de una unidad de control existente con un EPG distinto

Nota: Si el emparejamiento se va a realizar con un EPG en el que los parámetros del paciente sean distintos, asegúrese de desvincular primero la unidad de control, ya que si no lo hace, la información anterior del paciente se guardará en el nuevo EPG.

1. Si se usa la banda de EF de la parte inferior de la pierna, debe asegurarse de que el EPG correspondiente esté encendido. Si se usa la banda de EF Thigh Stand-Alone, debe asegurarse de que el EPG correspondiente esté encendido.
2. Coloque la banda de EF, con el EPG sujeto, y la unidad de control a unos centímetros de distancia entre sí.
3. Para encender la unidad de control, presione cualquier botón. Mantenga presionados los botones más y menos simultáneamente en la unidad de control.
4. De inmediato, mantenga presionados simultáneamente durante tres segundos los botones más y menos del EPG de la parte inferior de la pierna o el EPG Thigh Stand-Alone. El EPG pasa a modo de emparejamiento y la luz indicadora del estado del EPG va alternando entre el color verde, el amarillo y el rojo.
5. Una vez emparejados, el indicador luminoso de estado del EPG emitirá luz verde intermitente. El EPG conectado aparecerá en la pantalla de la unidad de control.
6. Los parámetros del paciente almacenados en la unidad de control se transferirán al EPG nuevo, a no ser que la unidad de control se haya desvinculado.

Emparejamiento de un sensor de pie nuevo con el EPG

1. Si se usa la banda de EF de la parte inferior de la pierna, debe asegurarse de que el EPG correspondiente esté encendido. Si se usa la banda de EF Thigh Stand-Alone, debe asegurarse de que el EPG correspondiente esté encendido.
2. Coloque la banda de EF, con el EPG sujeto, y el sensor de pie a unos centímetros de distancia entre sí.
3. Retire la batería del sensor de pie, espere 120 segundos e inserte la batería de nuevo en el sensor de pie. Asegúrese de presionar firmemente la cubierta de la batería para volver a encajarla en su lugar.
4. Presione el sensor de presión del sensor de pie para activarlo.
5. Si se usa la banda de EF de la parte inferior de la pierna, debe mantener presionado durante tres segundos y simultáneamente los botones más y menos del EPG correspondiente. El EPG pasa a modo de emparejamiento y la luz indicadora del estado del EPG va alternando entre el color verde, el amarillo y el rojo.
6. Si se usa la banda de EF Thigh Stand-Alone, debe mantener presionados durante tres segundos simultáneamente los botones más y menos del EPG correspondiente. El EPG pasa a modo de emparejamiento y la luz indicadora del estado del EPG va alternando entre el color verde, el amarillo y el rojo.
7. Una vez emparejados, el indicador luminoso de estado del EPG y el indicador luminoso del sensor de pie emitirán luz verde intermitente.

Nota: Cuando el nuevo sensor de pie se haya emparejado con el EPG existente, la unidad de control reconocerá automáticamente el sensor de pie emparejado.

Solución de problemas

Uso del dispositivo de prueba

El dispositivo de prueba se utiliza para solucionar problemas en caso de desconexión de las bandas de EF de la parte inferior de la pierna o del muslo o del EPG. El dispositivo de prueba proporciona avisos de audio si está conectado a la banda de EF de la parte inferior de la pierna, la banda de EF del muslo o el EPG y se aplica estimulación.

Prueba de la banda de EF de la parte inferior de la pierna

1. Conecte el dispositivo de prueba a los orificios de enganche azul y naranja de la banda de EF de la parte inferior de la pierna. Consulte la ilustración 13-1.



Ilustración 13-1: Dispositivo de prueba conectado a la banda de EF de la parte inferior de la pierna

2. Para encender el EPG de la parte inferior de la pierna, presione el botón de encendido del EPG.
3. Para encender la unidad de control, presione cualquier botón.
4. Para seleccionar el modo de entrenamiento, presione el botón de modo en la unidad de control hasta que aparezca el icono indicador de entrenamiento en la esquina inferior derecha de la pantalla.
5. Presione el botón de estimulación de la unidad de control. Si la estimulación está encendida, se debería escuchar un zumbido, pero no si la estimulación está apagada.
6. Para seleccionar el modo de marcha, presione el botón de modo en la unidad de control hasta que aparezca el icono indicador de marcha en la esquina inferior derecha de la pantalla.
7. Presione el botón de estimulación de la unidad de control.
8. Si el sensor de movimiento del EPG está activado, mueva la banda de EF de la parte inferior de la pierna de lado a lado. Si la estimulación está encendida, se debería escuchar un zumbido, pero no si la estimulación está apagada.
9. Si el sensor de movimiento del EPG no está activado, presione y suelte sensor de presión del sensor de pie. Cuando se deja de presionar el sensor de presión, se debe escuchar un zumbido, pero no cuando se presiona el sensor.

Si cualquiera de los pasos anteriores genera una indicación de error, intente los procedimientos de pruebas avanzadas.

Prueba de la banda de EF del muslo

1. Conecte el dispositivo de prueba al enganche distal del panel proximal y al enganche proximal del panel distal de la banda de EF del muslo. Consulte la ilustración 13-2.

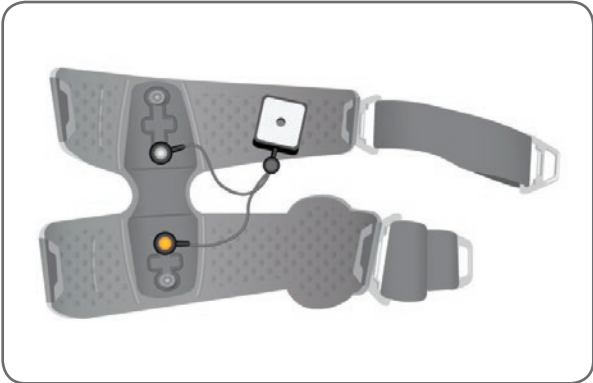


Ilustración 13-2: Dispositivo de prueba conectado a la banda del muslo

2. Para encender el EPG del muslo, presione el botón de encendido del EPG.
3. Para encender la unidad de control, presione cualquier botón.
4. Para seleccionar el modo de entrenamiento, presione el botón de modo en la unidad de control hasta que aparezca el icono indicador de entrenamiento en la esquina inferior derecha de la pantalla.
5. Presione el botón de estimulación de la unidad de control. Si la estimulación está encendida, se debería escuchar un zumbido, pero no si la estimulación está apagada.
6. Para seleccionar el modo de marcha, presione el botón de modo en la unidad de control hasta que aparezca el icono indicador de marcha en la esquina inferior derecha de la pantalla.
7. Presione el botón de estimulación de la unidad de control.
8. Presione y suelte el sensor de presión del sensor de pie. Cuando se deja de presionar el sensor de presión, se debe escuchar un zumbido, pero no cuando se presiona el sensor.

Si alguno de los pasos anteriores genera una indicación de error, consulte los procedimientos de pruebas avanzadas.

Descripción de los códigos de error

Si se produce un error en el sistema L300 Go, el EPG emitirá un aviso sonoro y el indicador luminoso de estado del EPG emitirá una luz roja intermitente. La pantalla LCD de la unidad de control muestra un icono de indicador de error intermitente y un indicador numérico intermitente con el código de error. En el software de la aplicación del especialista del sistema L300 Go también se muestra información sobre códigos de error. Consulte en la tabla 11-1 la descripción de los códigos de error y sus soluciones.

Códigos de error de la unidad de control y la aplicación del especialista del sistema L300 Go		
Código de error	Descripción del error	Solución
E1	Fallo de sobreestimulación	Se está proporcionando más estimulación de la esperada o no se está proporcionando correctamente. Posible problema de hardware. Deje de usar el sistema L300 Go y póngase en contacto con Bioness.

Códigos de error de la unidad de control y la aplicación del especialista del sistema L300 Go		
Código de error	Descripción del error	Solución
E2	Fallo de subestimulación	Se está proporcionando menos estimulación de la esperada. Posible problema de hardware. Deje de usar el sistema L300 Go y póngase en contacto con Bioness.
E3	Fallo de comunicación	El sensor de pie y el EPG de la parte inferior de la pierna no se comunican entre sí. Presione el sensor de presión del sensor de pie para activarlo.
E4	Parámetro corrupto	El especialista debe reprogramar el sistema L300 Go para el paciente. Deje de usar el sistema L300 Go y póngase en contacto con Bioness.
E5	Fallo de electrodo cortocircuitado	Los electrodos o la banda han sufrido un cortocircuito, o bien el hardware no funciona correctamente. Deje de usar el sistema L300 Go y póngase en contacto con Bioness.
E6	Error de electrodo dañado	Los electrodos están gastados o dañados. Cambie todos los electrodos o las bases dañadas o desgastadas. Consulte el capítulo “Mantenimiento y limpieza” de esta guía para obtener instrucciones.
E7	Fallo de electrodo abierto	Para apagar el EPG, presione el botón de encendido del EPG. Asegúrese de que los electrodos y sus bases estén encajados en los orificios de enganche de la banda de EF.
E8	Fallo de manguito incorrecto	Asegúrese de que el EPG esté correctamente insertado en el estuche del EPG en la banda de EF. En el caso de los pacientes que usen tanto la banda de EF de la parte inferior de la pierna como la banda del muslo, asegúrese de que se ha insertado el EPG correcto en el estuche del EPG. Para que el sistema funcione, el EPG de la parte inferior de la pierna debe encontrarse en la banda de EF de la parte inferior de la pierna y el EPG del muslo en la banda de EF del muslo.
E9	Batería de EPG vacía	Cargue el EPG. Consulte la sección “Carga del sistema L300 Go” de esta guía.
E10	Fallo de temperatura de la batería de EPG	La temperatura de la batería es demasiado alta. Desconecte el cargador del EPG. Coloque el EPG en una habitación en el intervalo de temperaturas en condiciones de funcionamiento (entre 5 °C y 40 °C) durante 30 minutos. Tras los 30 minutos, vuelva a conectar el EPG al cargador para continuar con la carga.
E12	Error general de emparejamiento (el tiempo límite de emparejamiento se ha agotado)	Repita el proceso de emparejamiento. Consulte el capítulo “Emparejamiento de los componentes de repuesto” de esta guía.
E21	Batería del sensor de pie baja	Sustituya la batería del sensor de pie. Consulte el capítulo “Mantenimiento y limpieza” de esta guía.

Tabla 13-1: Códigos de error de la unidad de control y la aplicación del especialista del sistema L300 Go

Preguntas frecuentes

Si tiene alguna duda o preocupación, póngase en contacto con el Departamento de relaciones con los clientes de Bioness en el teléfono +1 800 211 9136, opción 3 (EE. UU.) o visite: www.bioness.com.

Al cargar el EPG, ¿cómo sabré en qué momento están completamente cargadas las baterías?

El indicador luminoso de la batería del EPG emite una luz verde fija, brevemente, al arrancar si la batería está completamente cargada. La carga lleva cerca de tres horas. Si el EPG está completamente descargado, la batería puede tardar hasta seis horas en cargarse.

¿Daño las baterías si cargo el EPG todos los días?

No. La carga diaria no afecta la vida útil ni las funciones de la batería del EPG. Se recomienda cargar el EPG diariamente.

¿Cómo sabré cuándo está bajo el nivel de carga de la batería del EPG?

El indicador luminoso de la batería del EPG emitirá una luz amarilla fija y el indicador luminoso de estado, una luz roja intermitente. Cuando la batería esté casi vacía, el EPG emitirá una alarma sonora, además de mostrar el indicador luminoso correspondiente, hasta que esté completamente descargada o se conecte a una fuente de alimentación.

¿Qué debo hacer si los electrodos o las bases de los electrodos están deshilachados, pelados, dañados o cuelgan de la banda de EF?

Cambie todos los electrodos o las bases dañadas o desgastadas. Consulte el capítulo “Mantenimiento y limpieza” de esta guía.

¿Qué hago si el tobillo del paciente no se mueve (o el pie no se eleva satisfactoriamente) y el sistema L300 Go no indica ningún error?

- Asegúrese de que los EPG están apagados.
- Recoloque la banda de EF L300.
- Asegúrese de que la correa esté ajustada y que la banda de EF de la parte inferior de la pierna esté bien sujeta.
- Para encender el EPG de la parte inferior de la pierna, presione el botón de encendido del EPG.
- Para probar si la banda de EF de la parte inferior de la pierna está bien colocada, mantenga presionado el botón de estimulación del EPG al menos durante cinco segundos. El EPG proporciona estimulación hasta que se suelta el botón de estimulación.

¿Por qué no se mueve correctamente la rodilla del paciente si el sistema L300 Go no indica ningún error?

- Asegúrese de que los EPG están apagados.
- Recoloque la banda de EF del muslo.
- Asegúrese de que las correas están ajustadas.
- Para encender el EPG del muslo, presione el botón de encendido del EPG.
- Para probar si la banda de EF del muslo está bien colocada, mantenga presionado el botón de estimulación del EPG al menos durante cinco segundos. El EPG proporciona estimulación hasta que se suelta el botón de estimulación.

¿Por qué es desigual la estimulación cuando el paciente camina, pero el sistema L300 Go no indica ningún error?

Haga que el paciente se detenga y cambie el peso de lado a lado.

En el caso de los pacientes que usen el sensor de pie:

- Compruebe que el sensor de presión esté bien colocado, ajuste la posición del sensor de presión levemente hacia adelante en su zapato o afloje el cordón del zapato.
- Compruebe que el cable del sensor de pie no esté desgastado y que el transmisor y el sensor de presión no estén dañados.
- Si está dañado, póngase en contacto con Bioness para obtener uno de repuesto.

¿Qué debo hacer si la piel del paciente está irritada o presenta una reacción cutánea en la zona de adhesión de los electrodos o la banda de EF?

Pida al paciente que deje de usar el sistema L300 Go y se ponga en contacto de inmediato con Bioness. El paciente solo deberá volver a usar el sistema cuando la piel esté completamente recuperada. Proporcione a sus pacientes la guía para el cuidado de la piel del sistema L300 Go y el protocolo de acondicionamiento de la piel.

¿Cómo puedo comprobar si el L300 Go está recibiendo corriente eléctrica?

Conecte el dispositivo de prueba a la banda de EF. Cuando la intensidad de la estimulación es de 10 mA como mínimo, el dispositivo de prueba comienza a emitir un zumbido.

¿Para qué más puedo utilizar el dispositivo de prueba?

El dispositivo de prueba puede utilizarse como una herramienta educativa, para demostrar cuándo está encendida o apagada la estimulación en los diferentes modos de estimulación.

Especificaciones técnicas

Especificaciones de la unidad de control	
Clasificación	Alimentación interna, funcionamiento continuo con piezas aplicadas de tipo BF
Modos de funcionamiento	Marcha, Entrenamiento y Especialista
Tipo de batería	Batería de botón de litio, CR2032, 3 V, 240 mAh
Controles	<ul style="list-style-type: none"> • Botón de selección: para seleccionar un EPG • Botón de modo: para seleccionar un modo de funcionamiento • Botón de estimulación: para activar o desactivar la estimulación • Botones más y menos: para aumentar o disminuir el nivel de intensidad de la estimulación • Botón de volumen: para activar y desactivar los avisos sonoros del EPG
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • Icono de EPG (Preparado, Estimulación y Error), icono de sensor de pie, icono de modo de funcionamiento, icono de nivel de la batería, icono de error e icono de volumen (silencio) • Indicación numérica de la intensidad de la estimulación y presentación de código de error
Opciones de transporte	En el bolsillo o con correa para el cuello
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 75 mm (2,9 pulg.) • Anchura: 40 mm (1,6 pulg.) • Altura: 17 mm (0,7 pulg.)
Peso	60 gramos
Parámetros ambientales	<p>Temperatura de transporte y almacenamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: de -25 °C a +55 °C • Humedad relativa: del 5 % al 90 % • Presión: de 20 kPa a 106 kPa <p>Condiciones de funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: de 5 °C a 40 °C • Humedad relativa: del 5 % al 75 % • Presión de funcionamiento: de 80 kPa a 106 kPa
Clasificación IP (protección de ingreso)	<p>IP22</p> <p>Protección contra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetos > 12,5 mm • Goteo de agua con una inclinación de hasta 15° <p>Eficaz contra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dedos u objetos similares • El goteo vertical de agua no debería tener un efecto pernicioso si la carcasa está inclinada a un ángulo de hasta 15° respecto a la posición normal.
Número de ID de FCC	RYYEYSGJN

Especificaciones del EPG	
Clasificación	Alimentación interna, funcionamiento continuo con piezas aplicadas de tipo BF
Tipo de batería	Batería de ion-litio recargable, 3,7 V, 1000 mAh
Controles	<ul style="list-style-type: none"> • Botón de alimentación: para encender y apagar el sistema • Botón de estimulación: para activar o desactivar la estimulación • Botones más y menos: para aumentar o disminuir el nivel de intensidad de la estimulación
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores luminosos de estado y de batería • Avisos sonoros y por vibración • “Pitidos” para sonidos de alerta
Dimensiones	Longitud: 82 mm; anchura: 47 mm; altura: 15 mm
Peso	60 gramos
Parámetros ambientales	Temperatura de transporte y almacenamiento: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: de -25 °C a +55 °C • Humedad relativa: del 5 % al 90 % • Presión: de 20 kPa a 106 kPa Condiciones de funcionamiento: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: de 5 °C a 40 °C • Humedad relativa: del 5 % al 75 % • Presión de funcionamiento: de 80 kPa a 106 kPa
Clasificación IP (protección de ingreso)	IP42 Protección contra: <ul style="list-style-type: none"> • Ingreso de sólidos de más de 1 mm • Goteo de agua con una inclinación de hasta 15° Eficaz contra: <ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de los cables, tornillos, etc. • El goteo vertical de agua no debería tener un efecto pernicioso si la carcasa está inclinada a un ángulo de hasta 15° respecto a la posición normal.
Número de ID de FCC	RYYEYSGJN
Parámetros de pulso	
Pulso	Bifásico equilibrado
Forma de onda	Simétrica o asimétrica
Intensidad (pico)	De 0 a 100 mA, 1 mA de resolución (fase positiva)
Intensidad máxima (media cuadrática)	16,5 mA (media cuadrática)
Voltaje máximo	130 V

	Simétrica				
Duración de pulso positivo (μs)	100	150	200	250	300
Duración de pulso negativo (μs)	100	150	200	250	300
Intervalo de interfase (μs)	50, 100, 200				
Duración total del pulso en el intervalo de interfase de 50 μs	250	350	450	550	650
	Asimétrica				
Duración de pulso positivo (μs)	100	150	200	250	300
Duración de pulso negativo (μs)	300	450	600	750	900
Intervalo de interfase (μs)	20, 50, 100, 200				
Duración total del pulso en el intervalo de interfase de 50 μs	450	650	850	1050	1250
Carga máxima	80 000 ohm (sujeto a la limitación de voltaje máximo)				
Carga mínima	100 ohm				
Velocidad de repetición del pulso	De 10 a 45 Hz (5 Hz de resolución)				

Parámetros de marcha	
Demora de control de balanceo (%)	0 a 100 % de tiempo de fase*, 10 % de resolución
Fin de control de balanceo (%)	0 a 100 % de tiempo de fase*, 10 % de resolución
Demora de control de postura (%)	0 a 100 % de tiempo de fase*, 10 % de resolución
Fin de control de postura (%)	0 a 100 % de tiempo de fase*, 10 % de resolución
Incremento gradual (Cuesta arriba)	0 a 0,5 segundos, 0,1 segundo de resolución
Disminución gradual (Cuesta abajo)	0 a 0,5 segundos, 0,1 segundo de resolución
Extensión (%)	0 a 100 % de tiempo de postura, 10 % de resolución
Duración máxima de la estimulación	1 a 10 segundos, 1 segundo de resolución
* La ráfaga de estimulación se puede iniciar en la fase de balanceo o de apoyo.	

Tiempo de inicio de la alerta del EPG	
Estimulación incorrecta	Demora de la alerta < 5 s
Fallo de comunicación	Demora de la alerta < 1 s
Memoria dañada	Demora de la alerta < 100 ms
EPG en la banda incorrecta	Demora de la alerta (tras activar la estimulación) < 100 ms
Alerta de condición del electrodo (cortocircuito, mal contacto o abierto)	Demora de la alerta < 2,5 s
Batería vacía	Demora de la alerta < 1 s

Nota: El rango de la señal de alerta es de 39 a 51 dBA.

Todos los registros se almacenan en la memoria EEPROM cuando se genera la alerta y se conservan siempre que el EPG tenga potencia al menos unos segundos después de que se active una alerta. Cuando se alcance la capacidad de almacenamiento máxima, los registros van reciclándose y las entradas más antiguas se sobrescriben.

Especificaciones del sensor de pie	
Clasificación	Alimentación interna, funcionamiento continuo con piezas aplicadas de tipo BF
Tipo de batería	Batería de botón de litio, CR2032, 3 V, 240 mAh
Dimensiones del transmisor	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 65 mm (2,6 pulg.) • Anchura: 50 mm (2 pulg.) • Altura: 10 mm (0,4 pulg.)
Peso	25 gramos
Parámetros ambientales	Temperatura de transporte y almacenamiento: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: de -25 °C a +55 °C • Humedad relativa: del 5 % al 90 % • Presión: de 20 kPa a 106 kPa Condiciones de funcionamiento: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: de 5 °C a 40 °C • Humedad relativa: del 5 % al 75 % • Presión de funcionamiento: de 80 kPa a 106 kPa
Clasificación IP (protección de ingreso)	IP52 Protección contra: <ul style="list-style-type: none"> • Polvo • Goteo de agua con una inclinación de hasta 15° Eficaz contra: <ul style="list-style-type: none"> • El ingreso de polvo no se evita por completo, pero no debería entrar la cantidad suficiente como para interferir con el funcionamiento correcto del equipo. • El goteo vertical de agua no debería tener un efecto pernicioso si la carcasa está inclinada a un ángulo de hasta 15° respecto a la posición normal.
Número de ID de FCC	RYYEYSGJN

Especificaciones de la banda de EF de la parte inferior de la pierna		
	Banda de EF L300 normal	Banda de EF L300 pequeña
Material	Tela de polímero	Tela de polímero
Circunferencia de ajuste de la extremidad	29 a 51 cm (11 a 20 pulg.)	22 a 31 cm (8 a 12,2 pulg.)
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> •Altura: 160 mm (6,3 pulg.) •Anchura: 100 mm (3,9 pulg.) •Profundidad: 125 mm (4,9 pulg.) 	<ul style="list-style-type: none"> •Altura: 110,5 mm (4,5 pulg.) •Anchura: 80 mm (3 pulg.) •Profundidad: 100 mm (4 pulg.)
Peso	Aproximadamente 150 gramos (4,8 oz.)	Aproximadamente 104 gramos (3,6 oz.)

Especificaciones de la banda de EF del muslo	
Material	Tela de polímero
Circunferencia de ajuste de la extremidad	<ul style="list-style-type: none"> •Circunferencia de parte superior del muslo: 53 cm a 85 cm •Circunferencia de la parte inferior del muslo: 33 cm a 50 cm •Longitud del muslo: 24 cm a 35 cm
Dimensiones	Longitud: 200 mm Circunferencia (mínima): <ul style="list-style-type: none"> •Panel proximal: 270 mm •Panel distal, normal: 310 mm •Panel distal, grande: 510 mm
Peso	300 gramos, aprox.

Especificaciones del cargador del sistema	
Utilice un suministro de energía de seguridad aprobado para uso médico Clase II proporcionado o aprobado por Bioness con los siguientes índices:	
Entrada	
Voltaje	100–240 V
Corriente	0,5 A
Frecuencia	50 a 60 Hz
Salida	
Voltaje	5,0 V
Corriente	<ul style="list-style-type: none"> •USB 1: 2,1 A •USB 2: 1,0 A

Nota: No utilice el sistema L300 Go mientras se carga. No lleve puestas las bandas de EF de la parte inferior de la pierna ni del muslo mientras se carga.

Especificaciones del electrodo y la base del electrodo: banda de EF de la parte inferior de la pierna	
Electrodos Hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> • Dos Electrodos Hydrogel de 45 mm de diámetro (1,77 pulg.) con una superficie de 15,8 cm² • Temperatura de transporte y almacenamiento: de 5 °C a 27 °C (41 °F a 80,6 °F) • Humedad relativa: del 35 % al 50 % <p>Nota: Utilice únicamente los electrodos suministrados por Bioness Inc.</p>
Bases de electrodos de hidrogel, 45 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Dos bases de electrodos de 45 mm (1,77 pulg.) de diámetro de polímero reubicables para ajuste individual
Bases de electrodos de tela, 45 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Dos bases de electrodos de elastómero termoplástico reubicable (TPE) de 45 mm de diámetro (1,77 pulg.)
Electrodo Round Cloth, 45 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Dos telas de polímero no tejidas reubicables de 45 mm (1,77 pulg.) de diámetro (80 % viscosa, 20 % polipropileno); capa conductora, acero inoxidable • Broche de enganche macho • Polietileno de baja densidad (LDPE) al 10 % + etilvinilacetato (EVA) • Área de superficie: 15,8 cm²
Electrodo Quick Fit (derecha - A e izquierda - A)	<ul style="list-style-type: none"> • Tela de polímero no tejida (80 % viscosa, 20 % polipropileno); capa conductora, acero inoxidable • Broche de enganche macho • Polietileno de baja densidad (LDPE) al 10 % + etilvinilacetato (EVA) • Área de superficie: 43,2 cm² \ 55,3 cm²
Electrodo Steering (derecha e izquierda)	<ul style="list-style-type: none"> • Tela de polímero no tejida (80 % viscosa, 20 % polipropileno); capa conductora, acero inoxidable • Broche de enganche macho • Polietileno de baja densidad (LDPE) al 10 % + etilvinilacetato (EVA) • Área de superficie: 21,2 cm² (cátodo proximal) \ 19,5 cm² (cátodo distal) \ 56,9 cm² (ánodo)
Electrodos Small Round Cloth, 36 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Dos telas de polímero no tejidas reubicables de 36 mm (1,41 pulg.) de diámetro (80 % viscosa, 20 % polipropileno); capa conductora, acero inoxidable • Broche de enganche macho • Polietileno de baja densidad (LDPE) al 10 % + etilvinilacetato (EVA) • Área de superficie: 10,1 cm²
Bases de electrodos de tela pequeñas, 36mm	<ul style="list-style-type: none"> • Dos bases de electrodos de elastómero termoplástico reubicable (TPE) de 36mm de diámetro (1,41 pulg.)
Electrodo Small L300 Quick Fit (A)	<ul style="list-style-type: none"> • Tela de polímero no tejida (80 % viscosa, 20 % polipropileno); capa conductora, acero inoxidable • Broche de enganche macho • Polietileno de baja densidad (LDPE) al 10 % + etilvinilacetato (EVA) • Área de superficie: 31,1 cm² \ 20,6 cm²
Electrodo Small L300 Quick Fit (B)	<ul style="list-style-type: none"> • Tela de polímero no tejida (80 % viscosa, 20 % polipropileno); capa conductora, acero inoxidable • Broche de enganche macho • Polietileno de baja densidad (LDPE) al 10 % + etilvinilacetato (EVA) • Área de superficie: 19,9 cm² \ 28,2 cm²

Especificaciones del Electrodo Cloth de la banda de EF del muslo	
Material	Tela sin costuras Nota: Solo utilice electrodos provistos por Bioness Inc.
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> •Oval proximal: 130 mm x 75 mm •Oval distal: 120 mm x 63 mm

Información de conexión inalámbrica


Características del sistema


El sistema L300 Go establece una comunicación inalámbrica entre los componentes.

Descripción	Protocolo de comunicación Bluetooth® de baja energía (BLE) 4.1 estándar del sector
Banda de frecuencia de funcionamiento	Banda ISM de 2,4 Ghz (2401-2482 MHz)
Tipo de modulación	MDF
Tipo de señal de modulación	Mensaje de datos binario
Velocidad de transmisión de datos (frecuencia de señal de modulación)	250 Kb/s
Potencia radiada efectiva	<10 dBm
Ancho de banda del receptor	812 kHz en torno a una frecuencia seleccionada
Pruebas de EMC	Cumple con la normativa FCC 15.2473 (EE. UU.) Cumple con la normativa IEC 60601-1-2 Cumple con la normativa IEC 60601-2-10

- **Calidad del servicio (QOS):** El sistema L300 Go se ha diseñado y probado para que tenga una tasa de respuesta de entre 10 y 100 ms de latencia, según la configuración del sistema, tras la detección del evento de talón.
- **Interferencia de comunicación inalámbrica:** El sistema L300 Go se ha diseñado y probado para que no reciba interferencias de otros dispositivos de RF (incluidos otros sistemas L300 Go, redes Wi-Fi, dispositivos móviles, microondas y otros dispositivos Bluetooth®).

El sistema L300 Go no es susceptible a la amplia gama de emisores EMI esperados, como sistemas de vigilancia electrónica (EAS), sistemas de identificación de radiofrecuencias (RFID), desactivadores de etiquetas y detectores de metales. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no vayan a producirse interferencias en alguna situación concreta.

 **Atención:** Si el rendimiento del sistema L300 Go se ve afectado por otro equipo, el usuario deberá apagar el sistema L300 Go y alejarse del equipo que provoca la interferencia.

 **Atención:** Cuando controle el sistema L300 Go en un paciente mediante la aplicación del especialista del sistema L300 Go, asegúrese de que la aplicación y el paciente permanezcan siempre a la vista entre sí. En caso de que se produzca un fallo de comunicación entre la aplicación del especialista del sistema L300 Go y el sistema L300 Go del paciente, acerque la aplicación al sistema del paciente.

Información sobre compatibilidad electromagnética (EMC)

Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas		
El sistema L300 Go está pensado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. Los clientes o usuarios del sistema L300 Go deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.		
Prueba de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético: instrucciones
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El sistema L300 Go usa energía de radiofrecuencia únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones de radiofrecuencias son muy bajas y no es probable que causen interferencias con los equipos electrónicos cercanos. El sistema L300 Go es apto para su uso en todo tipo de establecimientos, incluidas instalaciones domésticas o cualquier establecimiento conectado directamente a la red de suministro de energía público de bajo voltaje que suministre energía a edificios con uso doméstico.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión/emisiones fluctuantes IEC 61000-3-3	Conforme	

Instrucciones y declaración del fabricante: aislamiento electromagnético de todos los equipos y sistemas			
El sistema L300 Go está pensado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. Los clientes o usuarios del sistema L300 Go deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.			
Prueba de aislamiento	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: instrucciones
Descarga electrostática IEC 61000-4-2	+/-8 kV al contacto +/-15 kV al aire	+/-8 kV al contacto +/-15 kV al aire	Los suelos deben ser de madera, cemento o cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.
Ráfaga/corriente transitoria rápida eléctrica IEC 61000-4-4	+/-2 kV para alimentación líneas de suministro +/-1 kV para líneas de entrada/salida	+/-2 kV para alimentación líneas de suministro	La calidad del suministro eléctrico debe ser la habitual de un entorno comercial u hospitalario.
Impulso IEC 61000-4-5	+/-1 kV línea a línea +/-2 kV línea a masa	+/-1 kV línea a línea +/-2 kV línea a masa	La calidad del suministro eléctrico debe ser la habitual de un entorno comercial u hospitalario.

**Instrucciones y declaración del fabricante:
aislamiento electromagnético de todos los equipos y sistemas**

El sistema L300 Go está pensado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. Los clientes o usuarios del sistema L300 Go deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.

Prueba de aislamiento	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: instrucciones
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada del suministro de energía IEC 61000-4-11	<p><5 % U_T (>95 % caída en U_T) cada 0,5 ciclos</p> <p>40 % U_T (60 % caída en U_T) cada 5 ciclos</p> <p>70 % U_T (30 % caída en U_T) cada 25 ciclos</p> <p><5 % U_T (>95 % caída en U_T) cada 5 s</p>	<p><5 % U_T (>95 % caída en U_T) cada 0,5 ciclos</p> <p>40 % U_T (60 % caída en U_T) cada 5 ciclos</p> <p>70 % U_T (30 % caída en U_T) cada 25 ciclos</p> <p><5 % U_T (>95 % caída en U_T) cada 5 s</p>	La calidad del suministro eléctrico debe ser la habitual de un entorno comercial u hospitalario. Si el usuario necesita utilizar el sistema L300 Go de forma continua durante las interrupciones de corriente eléctrica, se recomienda que el equipo reciba la energía de un sistema de suministro de alimentación ininterrumpida (SAI) o de una batería.
Campo magnético de frecuencia de red (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de red deben tener los niveles de las instalaciones habituales de entornos comerciales u hospitalarios.

Nota: U_T es la tensión eléctrica de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.

Instrucciones y declaración del fabricante: aislamiento electromagnético

El sistema L300 Go está pensado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. Los clientes o usuarios del sistema L300 Go deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.

Prueba de aislamiento	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: instrucciones
			Los equipos de comunicaciones por RF portátiles o móviles, incluidos los cables, no se deben usar más cerca de la distancia de separación recomendada para el sistema L300 Go. Esta distancia se calcula con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.

Instrucciones y declaración del fabricante: aislamiento electromagnético			
El sistema L300 Go está pensado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. Los clientes o usuarios del sistema L300 Go deben asegurarse de que se emplea en dicho entorno.			
Prueba de aislamiento	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: instrucciones
RF por conducción IEC 61000-4-6	3 V media cuadrática de 150 kHz a 80 MHz 6 V media cuadrática Bandas de radio ISM y de radioaficionados	3 V media cuadrática de 150 kHz a 80 MHz 6 V media cuadrática Bandas de radio ISM y de radioaficionados	Distancia de separación recomendada: $d = 1,2\sqrt{P}$
RF radiada IEC 61000-4-3	10 V/m de 80 MHz a 2,7 GHz Campos de proximidad según 60601-1-2 4.ª edición	$[E_1] = 10 \text{ V/m}$ en 26 MHz a 2,7 GHz Campos de proximidad según 60601-1-2 4.ª edición	Distancia de separación recomendada: $d = 0,4\sqrt{P}$, intervalo 80 a 800 MHz $d = 0,7\sqrt{P}$, intervalo 800 a 2700 MHz

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alto.

NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión por parte de estructuras, objetos y personas.

NOTA 3: P es la velocidad máxima de la energía de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d la distancia de separación recomendada en metros (m).

NOTA 4: La fuerza de los campos de los transmisores de RF fijos, según determina una peritación electromagnética de las instalaciones,^a debe ser menor que el nivel de conformidad en cada intervalo de frecuencia.^b

NOTA 5: Se pueden producir interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo: 

^a La fuerza de los campos de transmisores fijos, como estaciones de radio de telefonía (móvil o fija) y las estaciones de radioaficionados, las emisoras AM y FM y las señales de televisión no se pueden predecir de forma teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético producido por los transmisores de radiofrecuencias fijos, se debería realizar un peritaje electromagnético de la instalación. Si la fuerza del campo medida en la ubicación en la que se usa el sistema L300 Go supera el nivel de conformidad de radiofrecuencia aplicable expuesto anteriormente, se debe comprobar que el sistema L300 Go funciona con normalidad. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como el cambio de orientación o la reubicación del sistema L300 Go.

^b En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la fuerza de los campos debe ser de menos de 3 V/m.